



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 8949

BUENOS AIRES, 09 AGO. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-11461-15-2 del registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por dichas actuaciones la firma DENTSPLY ARGENTINA S.A.C.I. solicita la corrección de la Disposición ANMAT N° 7831/2011, por la cual se aprobó la Autorización del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1093-116, denominado: MOTOR PARA ENDODONCIA, marca: WAVEONE.

Que por error se consignó en el Artículo 4°, en el Anexo III Certificado de Autorización e Inscripción y en Rótulos e Instrucciones aprobados en el Anexo II, el Número de PM 1093-112 cuando debía ser PM 1093-116.

Que dicho error material se considera subsanable en los términos de lo normado por el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Rectifícase el Número de PM en el Artículo 4° y en el Anexo III Certificado de Autorización e Inscripción, de la Disposición ANMAT 7831/2011,



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 8949

los cuales quedarán redactados de la siguiente manera: donde dice "PM 1093-112" corresponde "PM 1093-116".

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los nuevos proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 40 a 41 y 42 a 63 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- Practíquese la atestación correspondiente en el certificado PM-1093-116 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.


ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Rótulos e Instrucciones de uso; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-11461-15-2

DISPOSICION N° 8949

gsch

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

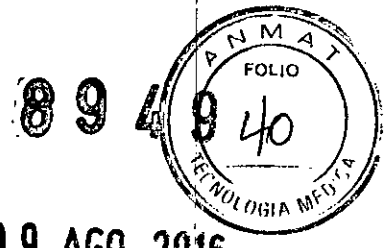

09 AGO. 2016

PROYECTO DE RÓTULO

WaveOne™ Endomotor
Motor para Endodoncia

Razón Social y dirección del Fabricante y del importador

➤ **Fabricante y responsable legal**

Maillefer Instruments Trading S.a.r.l.
Chemin Du Verger 3
CH – 1338 Ballaigues. Suiza

➤ **Fabricante subcontratados:** (bajo licencia y responsabilidad de Maillefer Instruments)

Nombre: VDW GmbH
Dirección: Bayerwaldstrasse 15 - 81737 München - Germany (Alemania)

Nombre: Advanced Technology Research ATR Srl
Dirección: Via San Donato,1 Pistoia Italia.

➤ **Importado y distribuido por:**

Dentsply Argentina S.A.C.I
General Enrique Martínez 657/661
BBI1426 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Identificación del Producto Médico y contenido:

Motor para Endodoncia

Cajas conteniendo:

1. Unidad central
 2. Micromotor con cable y conector (pieza de mano)
 3. Contraángulo reductor WaveOne™ (MAILLEFER 6:1)
 4. Pedal con cable
 5. Cargador externo de batería, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM120 con Enchufes intercambiables EU, UK, USA, AUS
- Manual del usuario

Accesorios (vienen con la unidad y pueden adquirirse por separado)

8949



Micromotor (pieza de mano)

Contraángulo reductor WaveOne™ (MAILLEFER 6:1)

Pedal con cable

Cargador externo de batería, modelo Cincon Electronics Co. Ltd, TR30RAM120 con

Enchufes intercambiables EU, UK, USA, AUS

LOTE N°: Número de Serie: XXX-XXX

Almacenamiento, Conservación y manipulación: condiciones recomendadas

- Temperatura: - 10 a 60°C (14 a 140°F)
- Humedad: 10 a 85% HR
- Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
- El sistema no debe estar expuesto a aire con polvo, sulfuros o salinidad.

Composición, Modo de Uso, Ver Instrucciones de uso y Manual del usuario

Precauciones y Advertencias: Ver Manual del usuario

Condiciones de venta:

Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias


Director Técnico: Nora Canoura Bioquímica-Farmacéutica

Autorizado por la ANMAT PM 1093 - 116

C

(Handwritten signature)

8949



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

WaveOne™ Endomotor Motor para Endodoncia

1) Razón Social y dirección del Fabricante y del importador

➤ Fabricante y responsable legal

Maillefer Instruments Trading S.a.r.l.
Chemin Du Verger 3
CH – 1338 Ballaigues. Suiza

➤ Fabricante subcontratado:(bajo licencia y responsabilidad de Maillefer Instruments)

Nombre: VDW GmbH

Dirección: Bayerwaldstrasse 15 - 81737 München - Germany (Alemania)

Nombre: Advanced Technology Research ATR Srl

Dirección: Via San Donato,1 Pistoia Italia.

➤ Importado y distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I
General Enrique Martínez 657/661
BBI1426 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2) Identificación del Producto Médico y contenido:

Motor para Endodoncia

Cajas conteniendo:

1. Unidad central WaveOne™
2. Micromotor o pieza de mano
3. Contraángulo WaveOne™
4. Un manual del usuario

E.

Accesorios (vienen con la unidad y pueden adquirirse por separado)

1. Una pieza de mano (micromotor)
2. Un cargador de la batería con cable de CA y enchufes intercambiables
3. Un contra ángulo WaveOne™
4. Una conexión con pinza (desmontable del contra ángulo)
5. Un pedal con cable
6. Batería Recargable

3) Almacenamiento, Conservación, Manipulación y Transporte

- Temperatura: - 10 a 60°C (14 a 140°F)
- Humedad: 10 a 85% HR
- Presión atmosférica: 500 a 1060 hPa
- El sistema no debe estar expuesto a aire con polvo, sulfuros o salinidad.

4) Instrucciones de uso

Antes del uso comprobar que se encuentren todos los componentes del equipo:

Preparación

Con cuidado sacar el aparato y los accesorios de su paquete y colocarlos en una superficie plana.

Comprobar que están todos los componentes enumerados en el capítulo 6.1 COMPONENTES ESTÁNDAR del Manual del Usuario.

Comprobar que el número de serie del aparato, es el mismo que figura en la etiqueta de la parte inferior de la unidad central, en el cartón de la caja y en los documentos de envío.

C

am

⚠ ADVERTENCIA


Si saliera algún tipo de líquido del aparato, no continuar con la instalación y consultar con su distribuidor.

Instalación

Suministro Eléctrico

1. Seleccionar el adaptador de enchufe que se ajuste a la clavija de su proveedor, según el país.

Fig. 1 Adaptadores para el suministro eléctrico

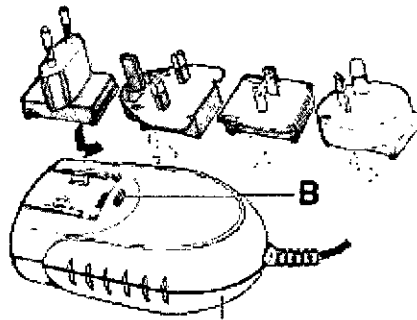

Colocar el adaptador de enchufe requerido en la zona donde están los dos contactos y presionar hacia el botón de bloqueo (B) hasta que encaje en su sitio. Debe presionar el botón de bloqueo (B) para cambiar el adaptador (Fig. 1).

NOTA

Los conectores están codificados, por tanto, asegurarse que los conectores estén correctamente orientados cuando se enchufen juntos.

El motor de endodoncia WaveOne™ viene con un conector USB para uso exclusivo del servicio técnico autorizado para mantenimiento y actualizaciones de software.

Este conector USB está tapado con una etiqueta que pone "SOLO PARA SERVICIO TECNICO NO QUITAR".


2. Cargar la batería totalmente antes del primer uso

a. Conectar el cargador de batería a la red.

E



- b. Insertar el conector del cargador de la batería a la conexión (A – ver Fig. 2) en la parte trasera del aparato (para detalles ver capítulo 6.3.3).
- c. Cargar completamente la batería antes del primer uso.
- d. Conectar el pedal en la conexión localizada en la parte trasera del aparato (C – ver Fig.2).

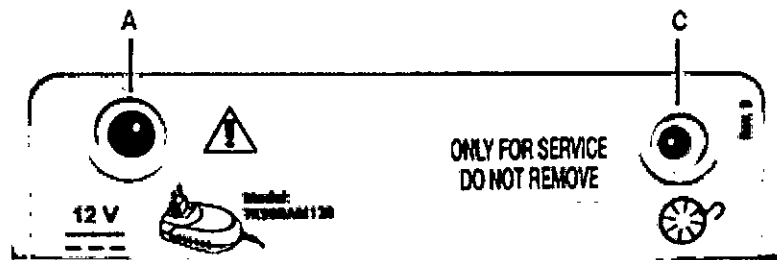


ADVERTENCIA

Para desconectar los cables, siempre sujetar de la parte central del enchufe y tirar. No tirar del cable.

Micromotor


1. Insertar el conector del micromotor en la conexión metálica de 9-pin (B – ver Fig. 3) en la parte frontal del aparato



La conexión B es una conexión de tirar y apretar. Alinear el punto rojo de la parte superior del macho hacia arriba para ajustar con la parte hembra del conector. No

E.

[Handwritten signature]



atornillar dentro de la conexión. Para desconectarlo, tirar de la parte final metálica del cable. No girar en ninguna dirección.

2. Colocar el contraángulo WaveOne™ (MAILLEFER 6:1) en el micromotor (ver instrucciones de uso del contraángulo).

3. Desinfectar el teclado y micromotor antes del primer uso y antes de cada nuevo paciente (para detalles ver capítulo 6.9).

Batería

El motor de endodoncia WaveOne™ se suministra con una batería de Níquel Metal Hidruro (NiMH).

ADVERTENCIAS

No abrir el aparato para cambiar la batería bajo ninguna razón, ya que hay riesgo de cortocircuito. Al abrir el aparato se invalida la garantía.

La batería solo puede ser reemplazada por un servicio técnico autorizado.

NOTA

Antes del primer uso cargar totalmente la batería.

Al conectar para cargar, siempre comprobar que el LED verde del cargador de la batería esta encendido (ON) lo que muestra que el cargador de la batería está conectado correctamente al suministro eléctrico

El LED de la batería aparece en 3 colores indicando el estado actual de la batería:

Verde: Indica una capacidad de la batería del 20% - 100%

Rojo parpadeante: la batería necesita cargarse. La batería se acabará en unos pocos minutos. Antes de que el motor se apague, se escucha una alarma y en el display aparece:

BATTERY !

E

CS

Si el LED de la BATERÍA empieza a parpadear en rojo durante el uso, conectar el aparato inmediatamente al cargador de batería, ya que el aparato se puede apagar.

Es posible usar el motor de endodoncia WaveOne™ mientras se está cargando.

Si la batería está baja y el aparato se apaga, se puede conectar al suministro eléctrico para continuar trabajando.

Naranja parpadeante: El cargador de la batería está conectado correctamente a la conexión A (ver Fig. 2) en la parte trasera del aparato y la batería se está cargando.

Si el aparato se apaga y el cargador de la batería está conectado, la unidad se volvería a encender y aparecerá en el display lo siguiente:



WAVEONE
BATTERY CHARGING

Cuando la carga esté completa, el LED de la batería cambia a verde.

ADVERTENCIAS

Si algún líquido que pudiese ser de la batería, saliera del aparato, detener su uso de inmediato y enviarlo a un servicio técnico autorizado para cambiar la batería.

Es peligroso abrir el aparato para cambiar la batería. Abrir el aparato invalidará la garantía.


NOTAS

- Para asegurar una buena vida de la batería, se recomienda siempre trabajar con la batería y recargarla cuando esté totalmente descargada
- Si la batería se carga correctamente, el tiempo de funcionamiento entre dos cargas es de 2 horas aproximadamente
- Cargar la batería completamente puede requerir hasta 3 horas.

- Para un funcionamiento óptimo de la batería, debería reemplazarse cada 2 años por un servicio técnico autorizado.
- Durante la carga, se puede usar el aparato normalmente y sin aumento apreciable del tiempo de carga ya que el cargador de batería del motor de endodoncia WaveOne™ tiene la potencia necesaria para hacer funcionar el micromotor mientras se carga la batería.

Descripción del Interfaz del Usuario

Teclado

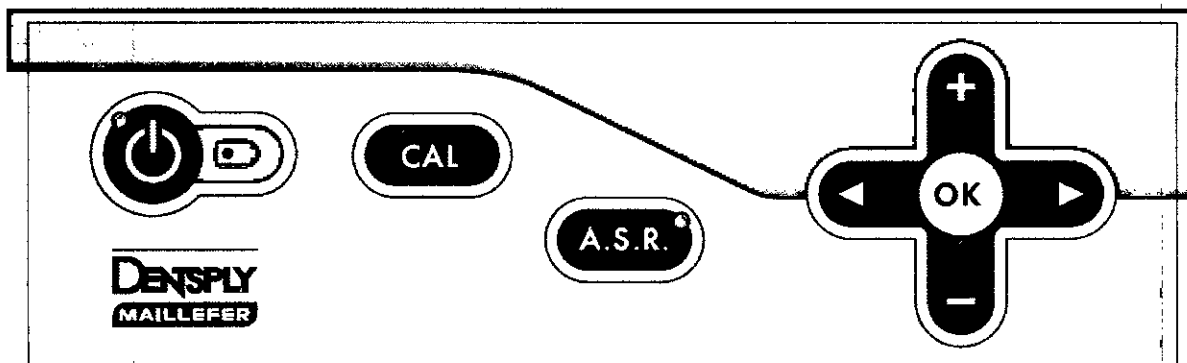

- 1 POWER:** Enciende y apaga el aparato (LED encendido y LED apagado).
- 2 LED BATTERY:** Muestra el estado de la batería; indica si la batería necesita cargarse (para detalles ver capítulo 6.3.3).
- 3+4 </>** : Mueve a derecha/izquierda la fila inferior del display a los campos de sistema de limas, lima, torque y velocidad. El campo activo se indica con una flecha (solo con los sistemas de rotación continua).
- 5+6 +/-** : Las teclas + y - permiten moverse a través de los sistemas de limas y cambiar individualmente los valores de torque o velocidad en todos los sistemas de rotación continua.

E

8949



7 OK: Confirma las modificaciones en los ajustes de torque y velocidad en cada sistema donde las modificaciones sean posible. También vuelve a cargar los parámetros por defecto cuando se usa a la vez que la tecla "power". La tecla **OK** puede también usarse para iniciar el micromotor sin el pedal.

8 CAL: Calibra el contraángulo para asegurar un torque exacto cada vez que el contraángulo se quita o se lubrica.

9 A.S.R.:

Rotación continúa:

LED verde: Movimiento "Auto-stop-reverse" (parada y reversa automática) seguido de rotación normal cuando se alcanza el torque preajustado

LED rojo: Rotación reversa sin limitación del torque, controlado con el pedal

LED apagado: Cuando se alcanza el torque preajustado, el micromotor se parará

Rotación recíproca:

A.S.R. está deshabilitado (LED apagado).

Pantalla:

Después de encenderlo, todos los LEDS se iluminarán y aparecerá una pantalla de bienvenida. En los siguientes usos, aparecerá la primera lima del último sistema usado antes de apagar el aparato o la última lima usada antes de poner el aparato en modo de "standby".

Fila superior: muestra qué sistema de limas de rotación continua está en uso, o que el modo recíproco está seleccionado, ej. PROTAPER UNIVERSAL o RECIPROCATING.

E.

Fila inferior:

Para los sistemas de rotación continua, se muestran 4 columnas:

Sistema
Lima
Torque preajustado
Velocidad

Para los sistemas recíprocos, el display mostrará el sistema recíproco en uso.

System Muestra el sistema de limas seleccionado (e.g. WAVEONE para WaveOne™, PTU para Protaper® Universal, etc.)

File Muestra la lima seleccionada. ALL indica que todas las limas del sistema se usarán con los mismos ajustes.

Ncm Muestra el límite de torque preajustado. (Deshabilitado en los sistemas recíprocos).

Rpm Muestra la velocidad del instrumento rotatorio en rpm (revoluciones por minuto) (deshabilitado en los sistemas recíprocos).

- 98 /141 -

- Las teclas ◀ y ▶ permiten moverse a la derecha e izquierda (solo con los sistemas de rotación continua).
- Las teclas + y – permiten moverse a través de los sistemas de limas y cambiar individualmente los valores de torque y velocidad en todos los sistemas de limas de rotación continua.
- Los ajustes del motor no se pueden cambiar en los sistemas recíprocos.
- Cuando se modifiquen los valores de torque o velocidad ajustados por defecto, el display mostrará una ' enfrente del valor de torque o velocidad.

Pedal

El micromotor puede iniciarse de 2 formas alternativas:

E



Se puede presionar el pedal y el micromotor funciona mientras se pise el pedal o también el micromotor se puede manejar manteniendo apretada la tecla **OK (7)** durante 1.5 segundos. El micromotor se puede parar presionando cualquier tecla o el pedal. Cuando el motor se haya encendido con la tecla **OK**, el micromotor se parará automáticamente después de 5 minutos sin uso, para preservar la carga de la batería.

Señales Acústicas

Al presionar las teclas del teclado, se escuchan diferentes tonos y señales acústicas que nos avisan que el aparato esta en uso. Todas las señales acústicas están activadas (a menos que se modifique manualmente).

Todas las señales acústicas están activadas de fábrica.

- Señal de alarma cuando se excede aproximadamente el 75% del valor preajustado de torque en rotación continua.
- Señal de alarma cuando se excede un valor crítico de torque en movimiento recíproco.
- Señal intermitente cuando la rotación es contraria a la agujas del reloj.
- Señal de alarma antes que se apague el aparato cuando la batería está vacía.

Desactivar y activar las señales acústicas

Para desactivar las señales acústicas presionar simultáneamente las teclas y : sonará un pitido y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

SOUND
OFF

Para reactivar las señales acústicas, presionar simultáneamente las teclas y : sonará un pitido y aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla:

E

Cur

8949



SOUND
ON

Biblioteca de Limas

El aparato contiene una biblioteca de limas con los siguientes sistemas NiTi preajustados:

A) Sistemas recíprocos

- WaveOne™
- RECIPROC®

B) Sistemas de rotación continua

- Gates
- PathFile™
- Protaper® Universal
- ProFile®
- GT® Series X
- My Program (programas individuales)


El fabricante se reserva el derecho a actualizar la biblioteca de limas y los sistemas presentes.

ADVERTENCIAS

- Seguir las instrucciones de uso del fabricante para las limas endodóncicas.
- El sistema de limas que se muestra en el display siempre debe ser el de la lima en uso. Esto es de vital importancia para evitar un mal uso de las limas recíprocas o de las limas de rotación continua.
- Los valores de torque y velocidad están sujetos a cambios por los fabricantes de limas sin previo aviso. Por tanto, los valores preajustados en la biblioteca deben de

E

Rus



ser comprobados antes de su uso. Los valores de torque que se muestran en el display son exactos y seguros solo con los contraángulos WaveOne™ (MAILLEFER 6:1) con un correcto mantenimiento y lubricación

Encendido

Presionar la tecla **POWER**. Todos los LEDs se encenderán. Una pantalla de bienvenida aparece mostrando la versión de software actual. - 100 /141 -

En los siguientes usos, aparecerá la primera lima del último sistema usado antes de apagar el aparato o la última lima usada antes de poner el aparato en modo de "standby".

Modo Standby

Transcurridos 10 minutos sin usarlo, el aparato se pondrá en modo standby para no gastar batería. La pantalla se apagará y el LED verde de la tecla power parpadeará. Para salir del modo standby, presionar cualquier tecla o el pedal: el aparato se encenderá y volverá a la última pantalla en la que estaba antes de entrar en modo standby. Después de 30 minutos en modo standby, el aparato se apagará para no gastar batería. Se puede encender de Nuevo apretando la tecla **POWER**.

Apagado

Presionar la tecla **POWER** para apagar el aparato. El LED de la batería LED (2) (ver Fig. 4) no se encenderá a menos que la batería se esté cargando.

Calibrado

El calibrado **CAL (8)** (ver Fig. 4) automático del micromotor ajusta la medida del torque para asegurar la exactitud del torque cada vez que el micromotor se cambie, el contraángulo sea reemplazado, autoclavado y/o lubricado.

Conectar el contraángulo WaveOne™ (MAILLEFER 6:1) al micromotor (sin lima).

8949



- Mantener apretada la tecla **CAL (8)** (ver Fig. 4).
- El micromotor girará desde la mínima a la máxima velocidad para medir automáticamente la inercia del contraángulo.

ADVERTENCIAS

- Nunca presionar la tecla de calibrado durante el tratamiento.
- Durante el calibrado, el micromotor variará la velocidad desde su valor mínimo hasta alcanzar el máximo. No insertar ninguna lima. El proceso de calibrado se puede detener pulsando cualquier tecla o mediante el pedal.
- Se recomienda su calibrado cada vez que el contraángulo se lubrique o se quite para esterilizarlo, o, al menos, una vez a la semana.
- No usar otro contraángulo ni otro índice de reducción que el original.
- Consultar las instrucciones de uso del contraángulo WaveOne™(MAILLEFER 6:1) antes de lubricarlo.

NOTA

El contraángulo WaveOne™ (MAILLEFER 6:1) reduce la velocidad y por tanto el instrument girará a la velocidad que aparezca en el display.

Durante el calibrado se puede leer en la pantalla:



El proceso se detiene automáticamente cuando se haya completado el calibrado, mostrando todas las barras negras en la pantalla.

NOTA

E

200

8949



Si se quisiera detener el proceso de calibrado en cualquier momento, pulsar cualquier tecla o el pedal. La pantalla mostrará:

CALIBRATION
ABORTED

Error 1: El micromotor no está conectado correctamente al aparato o está dañado. Comprobar la conexión.

Error 2: El contraángulo ofrece una alta resistencia durante la rotación. Comprobar el contraángulo. Lubricarlo si fuera necesario.

A.S.R.: Automatic Stop Reverse (Parada y reversa automática)

NOTA

ASR solo funciona en el modo de rotación continua. En el modo recíproco, el ASR está deshabilitado (el LED está apagado).

La función ASR se puede cambiar apretando la tecla **A.S.R. (9)** :

(Ver Fig. 4) y cambiará el color del LED de acuerdo con la función seleccionada:

Verde: En rotación continua, cuando se alcanza el torque preajustado, el micromotor girará en contramarcha (sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que la lima no encuentre resistencia, entonces volverá a girar en rotación normal (sentido de las agujas del reloj).

Rojo: En rotación continua, el micromotor girará en contramarcha (sentido contrario a las agujas del reloj) sin control de torque.

OFF: En rotación continua, cuando se alcanza el torque preajustado, el micromotor se parará automáticamente. Al apretar el pedal otra vez, el motor empezará a girar

E

20

en contramarcha (sentido contrario a las agujas del reloj) hasta que la lima ya no encuentre resistencia, entonces volverá a la rotación normal (sentido de las agujas del reloj).

Las alarmas acústicas se producen cuando:

- Se excede el 75% aproximadamente el valor del torque preajustado.
- Cuando el motor gire en contramarcha

La función ASR puede modificarse para cada lima, pero se volverá a los ajustes por defecto cuando la lima usada se cambie.

Cambio de Torque y Velocidad

NOTA

La velocidad y el torque no se pueden cambiar en los sistemas recíprocos.

Cuando se seleccione la lima de rotación continua deseada (indicado por una flecha), presionar la tecla para moverse al campo del torque, indicado por una flecha. Use las teclas + y – para seleccionar el ajuste de torque deseado. Cuando se cambie el valor de torque, parpadeará. El rango de torque disponible es 0.2 a 4.0 Ncm en intervalos de 0.1 Ncm.

Después de seleccionar el torque deseado, guardar el ajuste presionando una vez la tecla **OK**

El campo torque dejará de parpadear y quedará marcado con el símbolo ' '. Si no se presiona la tecla **OK** para guardar el ajuste, el ajuste no se puede usar y se borrará una vez se cambia la lima.

Presionar la tecla para cambiar al campo velocidad, indicado por una flecha. Use las teclas + y – para seleccionar el ajuste de velocidad deseado. Cuando se cambie el valor de la velocidad, parpadeará.

El rango de velocidad disponible es 250 a 1000 rpm en intervalos de 10 rpm (solo con el contraángulo WaveOne™(MAILLEFER 6:1) suministrado).

E

as



Los valores de torque y velocidad preajustados de todos los sistemas de limas de rotación continua pueden ser variados individualmente.

ADVERTENCIA

Antes de usar el micromotor, comprobar que los parámetros cambiados sean los correctos.

Parámetros por defecto de Fábrica

Para volver a los parámetros fijados por defecto, seguir las instrucciones generales de reiniciado:

- Asegurarse que el cargador de la batería esté desconectado.
- Apagar el aparato.
- Mantener apretadas simultáneamente las teclas **OK** y **POWER**. El aparato se encenderá y aparece en la pantalla

DEFAULT PARAMETERS
LOADING

Precauciones, Restricciones, Advertencias, Cuidados especiales, contraindicaciones del producto, Reacciones adversas:

Precauciones

Leer estas normas de seguridad antes de usarlo. Estas precauciones le permiten usar el producto de manera segura, previniendo posibles daños a uno mismo o a los demás.

Es muy importante que se guarde este manual para futuras consultas. El manual debe acompañar al sistema en todos los casos de venta u otro cambio, para que el Nuevo propietario pueda consultarlos capítulos de precauciones y advertencias.

Se recomienda el uso del motor de endodoncia WaveOne™ con guantes quirúrgicos, así como aislación completa con dique de goma.

Referirse al capítulo de ADVERTENCIAS (ver capítulo 3) para verificar cualquier cuidado especial que hubiera que realizar antes de usar el aparato.

El fabricante rechaza cualquier responsabilidad en el caso de:

- Utilización del aparato para usos no especificados en estas instrucciones de uso y mantenimiento.
- Modificaciones o reparaciones realizadas por personas no autorizadas por el fabricante.
- Conexión del motor a un suministro eléctrico que no cumpla con las disposiciones estándar IEC 364.

Uso de componentes no originales o componentes no especificados en el capítulo de COMPONENTES ESTÁNDAR .


- Rotura de la lima por mal uso.
- La rotura de accesorios o del aparato debido a la esterilización: ningún componente del motor de endodoncia WaveOne™ es esterilizable (excepto el contraángulo, ver instrucciones de uso del contraángulo).

Advertencias

- El aparato puede solo usarse en lugares apropiados y solo por dentistas. NO SE PUEDE USAR EN PRESENCIA DE MEZCLAS ANESTÉSICAS INFLAMABLES U OXÍGENO
- Si cualquier líquido atribuible a la batería se saliera del aparato, dejar de usarlo inmediatamente y mandarlo a un servicio técnico autorizado para el recambio de la batería.

E





- No exponer el aparato a fuentes de calor directas o indirectas. Usar y guardar el aparato en lugar seguro.
- No alterar ni modificar el aparato; Dentsply Maillefer declina cualquier responsabilidad en caso de cualquier alteración o modificación del aparato.
- El motor de endodoncia WaveOne™ requiere precauciones especiales en lo que concierne a compatibilidad electromagnética (EMC) y debe ser instalado y vigilado conforme a la información de compatibilidad electromagnética (EMC) proporcionada en este manual. Específicamente, no usar el aparato cerca de lámparas fluorescentes, transmisores de radio y mandos a distancia.
- Para evitar posibles riesgos debidos a interferencias electromagnéticas, no usar ningún aparato eléctrico, médico o no, cerca del motor de endodoncia WaveOne™. La radiación electromagnética emitida por este aparato es por debajo de los límites recomendados según las regulaciones pertinentes (EN 60601-1-2:2007).
- No usar el aparato en presencia de oxígeno libre, sustancias anestésicas o productos inflamables. Usar y guardar el aparato en ambiente seguro.
- ¡Ninguno de los componentes del motor de endodoncia WaveOne™ se suministran desinfectados o esterilizados: los componentes tales como la unidad central, el micromotor y el cable del micromotor necesitan desinfectarse; el contraángulo necesita esterilizarse antes del primer uso y entre cada paciente!
- Nunca colocar el micromotor o cualquiera de los accesorios del aparato en el autoclave o baño ultrasónico. Ninguno de los componentes del motor de endodoncia WaveOne™ puede esterilizarse (excepto el contraángulo, ver instrucciones de funcionamiento del contraángulo).
- No sumergir el aparato en cubas de ultrasonidos.
- El plástico del envoltorio no está sellado, no usar ningún líquido o spray directamente en la consola, especialmente en el monitor o cerca de los enchufes eléctricos.


C.



- No retorcer los cables que salen del micromotor o del pedal cargador de la batería.
- No abrir el aparato para cambiar la batería por ningún motivo, ya que existe riesgo de cortocircuito. La apertura del aparato invalida la garantía. La batería solo se puede cambiar en un servicio técnico autorizado.
- Seguir las instrucciones de uso del fabricante de las limas endodónticas.
- El sistema de limas que se muestra en el display debe coincidir siempre con la lima que se use. Esto es muy importante para evitar un mal uso de las limas recíprocas y las de rotación continua.
- No usar limas diseñadas para rotación continua en movimiento recíproco.
- No usar limas diseñadas para movimiento recíproco en rotación continua.
- Los valores de torque y velocidad pueden ser modificados por el fabricante de las limas sin previo aviso. Por lo tanto, los valores preajustados en la biblioteca de limas se deben comprobar antes de su uso. Los valores de torque que aparecen en la pantalla son exactos y fiables solo con los contraángulos WaveOne™(MAILLEFER 6:1) perfectamente mantenidos y lubricados.
- La exactitud del movimiento proporcionado por el motor solo se garantiza si se usa el contraángulo WaveOne™ (MAILLEFER 6:1), perfectamente mantenido y lubricado (para más detalles ver las instrucciones de uso del contraángulo).
- No usar ningún otro contraángulo ni otro valor de reducción que el recomendado.
- Durante el calibrado, el micromotor variará su velocidad desde el valor mínimo (1500 rpm en el eje del micromotor) al valor máximo (6000 rpm en el eje del micromotor). No insertar ninguna lima durante el calibrado.
- Calibrar cada vez que se lubrique o se esterilice el contraángulo, o al menos una vez por semana (ver las instrucciones de uso del contraángulo).

E


AS



- Antes de proceder a lubricar el contraángulo, consultar las instrucciones de uso del contraángulo WaveOne™ (MAILLEFER 6:1) y al capítulo 6.8 de MANTENIMIENTO que aparece en este manual.
 - Al lubricar el contraángulo, comprobar con cuidado que no entra lubricante en el micromotor.
 - No lubricar el micromotor por ninguna razón, ya que puede dañarlo o producir un efecto negativo importante en su funcionamiento.
 - Nunca introducir ningún objeto extraño en el eje del micromotor.
 - El micromotor se puede calentar en exceso, si se aplica demasiada presión. Si el micromotor se sobrecalienta demasiado a menudo o persiste el sobrecalentamiento, contactar con su distribuidor.
 - Antes de poner en marcha el micromotor, verificar que los ajustes del motor son los correctos.
 - El cargador de la batería debe suministrar un rango de voltaje entre: 100 – 240 V (+/- 10%), 47-63 Hz. Usar solo piezas originales.
 - Si el LED DE LA BATERÍA empieza a parpadear en rojo durante el uso, conectar el aparato inmediatamente al cargador de la batería, ya que el aparato podría apagarse.
 - Para asegurar una larga vida de la batería, se recomienda siempre trabajar con la batería y solo recargarla cuando se haya descargado totalmente.
 - Si apareciesen anomalías durante el uso, detener el tratamiento y contactar con su distribuidor.
 - No conectar una unidad de almacenamiento externa de PC (disco duro) al conector USB del motor de endodoncia WaveOne™. Nunca usar un cable USB macho-macho para conectar el motor de endodoncia WaveOne™ al PC.
- El equipo sólo debe ser usado con accesorios originales del fabricante.
- Si el motor se detiene o va muy rápido, dejar de utilizarlo y llamar al servicio

E

C



técnico.

- No introducir ningún tipo de aceite dentro del micromotor.
- El sistema funciona normalmente en ambientes donde la temperatura está entre 10-40 °C (50-104 °F), la humedad entre 10-85% RH, la presión atmosférica en 500-1060hPa, y no exista condensación por humedad en la unidad de control. Cualquier uso fuera de estos límites puede causar un funcionamiento anómalo.
- Se recomienda usar la aislación con dique de goma cuando se realice un tratamiento endodóntico .

Para obtener una medición exacta del conducto radicular, se recomienda el secado de la cámara pulpar. Las restauraciones o coronas metálicas, así como un exceso de fluidos, pueden generar un puente conductor que dará falsas medidas dentro del conducto radicular.

Contraindicaciones

En caso de que el paciente sea portador de marcapasos (u otro equipamiento eléctrico) y haya sido advertido de no usar pequeños aparatos eléctricos (como máquinas de afeitar, secadores de pelo, etc.), se recomienda no usar el aparato. No utilizar el aparato para la colocación de implantes o cualquier otro procedimiento dental que no sea endodóntico.

Limpieza, Desinfección, Esterilización

- ¡Los componentes necesitan desinfectarse y/o esterilizarse (solo para el contraángulo) antes del primer uso y entre cada paciente!
- No colocar el micromotor ni cualquier otro accesorio en el autoclave o cuba de ultrasonidos. Solo el contraángulo puede esterilizarse (ver instrucciones de

E

894



funcionamiento del contraángulo).

- No sumergir el aparato en limpiadores ultrasónicos.
- El envoltorio de plástico no está sellado, no usar ningún líquido o spray directamente sobre la consola, especialmente en el monitor o cerca de las conexiones.

Superficies Exteriores

Limpiar la superficie del aparato (panel de control y carcasa), el micromotor y su cable con un trapo limpio ligeramente humedecido con un desinfectante no agresivo.

Solo usar desinfectantes con poder antibacteriano, fungicida y virucida y que cumplan los requerimientos del órgano nacional regulador.

Se recomienda usar desinfectantes libres de aldehído.

Reacciones adversas:

No se describen.

Condiciones de venta:

Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias.

Director Técnico: Nora Canoura: Bioquímica - Farmacéutica

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1093 – 116