República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número: DI-2020-6193-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Agosto de 2020

Referencia: 1-47-3110-3853-20-0

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-3853-20-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SWISS PROTECH S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca LINK, nombre descriptivo Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® y su instrumental asociado y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Rodilla, Total, de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2020-49277066-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1020-48”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® y su instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-096 Prótesis, de Articulación, para Rodilla, Total

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINK

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® está indicado en casos de enfermedades articulares severas

con limitación de movilidad debido a artrosis o artritis degenerativa, reumatoide o postraumática, fracturas articulares que no permiten una reconstrucción osteosintética.

También se indica para pacientes con las siguientes afecciones:

- Necrosis ósea

- Artrosis bicondilar por ligamentos intactos, incluido el ligamento posterior

- Artrosis bicondilar por ligamentos colaterales intactos y ausencia de función del ligamento cruzado

- Artrosis de rótula

- Deformidades de valgo (<10 ° y 10 -15°)

Modelos:

318-102/01 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-102/02 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-102/03 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-102/04 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-102/05 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-102/16 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-102/25 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-102/26 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-103/01 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-103/02 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-103/03 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-103/04 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-103/05 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-103/16 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-103/25 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-103/26 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-112/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-112/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-112/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-112/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-112/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-112/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-112/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-112/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-113/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-113/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-113/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-113/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-113/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-113/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-113/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-113/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-190/07 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 70 mm

318-190/10 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 100 mm

318-190/14 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 140 mm

318-191/07 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 70 mm

318-191/10 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 100 mm

318-191/14 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 140 mm

318-204/01 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-204/02 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-204/03 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-204/04 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-204/05 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-204/16 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-204/25 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-204/26 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-205/01 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-205/02 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-205/03 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-205/04 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-205/05 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-205/16 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-205/25 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, izquierdo

318-205/26 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-206/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-206/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-206/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-206/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-206/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-206/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-206/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-206/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-207/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-207/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-207/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-207/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-207/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-207/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-207/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-207/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-208/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-208/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-208/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-208/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-208/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-208/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-208/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-208/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-209/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-209/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-209/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-209/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-209/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-209/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-209/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, izquierdo

318-209/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-212/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-212/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-212/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-212/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-212/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-212/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-212/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-212/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-213/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla

GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-213/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-213/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-213/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-213/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-213/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-213/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-213/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-214/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-214/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-214/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-214/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-214/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-214/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-214/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-214/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-215/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-215/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-215/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-215/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-215/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-215/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-215/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-215/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-216/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-216/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-216/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-216/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-216/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-216/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-216/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-216/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-217/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-217/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No

cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-217/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-217/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-217/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-217/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-217/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-217/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-231/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-232/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-233/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-234/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-235/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-237/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-238/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-241/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-242/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-243/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-244/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-245/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-247/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-248/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-251/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-252/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-253/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-254/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-255/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI®

SL® extra-grande; derecho

318-255/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-256/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-258/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-261/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-262/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-263/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-264/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-265/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-266/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-268/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-312/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla

GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-312/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-312/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-312/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-312/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-313/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-313/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-313/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-313/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-313/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-314 LINK® Tapa para cono de componente tibial- Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm; cementado

318-314/01 LINK® Tapa para cono de componente tibial- No cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm; no cementado

318-315 LINK® Tapa para cono de componente tibial- No cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm;

318-316/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-316/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-316/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-316/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-316/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-317/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-317/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-317/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-317/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-317/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-324/01 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-324/02 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-324/03 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-324/04 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-324/05 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-325/01 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-325/02 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-325/03 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-325/04 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-325/05 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -

Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-326/01 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-326/02 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-326/03 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-326/04 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-326/05 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-327/01 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-327/02 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-327/03 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-327/04 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-327/05 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-328/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-328/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-328/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-328/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-328/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-329/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-329/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo

total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-329/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-329/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-329/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-336/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-336/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-336/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-336/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-336/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-337/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-337/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-337/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-337/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-337/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-372/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-372/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-372/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-372/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-372/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-373/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-373/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-373/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-373/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-373/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-376/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-376/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-376/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-376/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-376/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-377/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-377/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-377/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-377/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-377/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-401/25 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 1, Ø 25 mm

318-401/28 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 2, Ø 28 mm

318-401/31 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 3, Ø 31 mm

318-401/34 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 4, Ø 34 mm

318-402/01 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-402/02 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-402/03 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-402/04 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-402/05 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-402/16 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-402/25 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-402/26 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-403/01 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-403/02 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-403/03 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-403/04 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI®

SL® grande; izquierdo

318-403/05 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-403/16 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-403/25 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-403/26 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-412/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-412/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-412/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-412/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-412/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-412/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-412/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-412/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-413/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-413/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-413/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-413/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-413/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-413/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-smal plusl; izquierdo

318-413/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-413/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-431/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-432/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-433/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-434/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-435/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-435/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-435/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-435/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-437/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-438/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-441/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-442/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-443/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-444/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-445/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-445/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-445/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande;

izquierdo

318-445/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-447/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-448/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-452/01 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-452/02 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-452/03 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-452/04 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-452/05 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-453/01 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-453/02 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-453/03 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-453/04 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-453/05 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-482/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-482/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-482/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-482/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-482/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-483/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-483/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-483/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-483/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-483/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

Instrumental asociado.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Implantes: unidad estéril / Instrumentales: unidad no estéril

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Lugar de elaboración:

Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania.

Expediente Nº 1-47-3110-3853-20-0

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.08.21 21:52:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.21 21:52:35 -03:00

ANEXO III. B

2- Proyecto de Rótulos

LINK	
Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® Modelos: Implantes xxx-xxx/xx Contenido: 1 unidad REF LOT SN	
	No reutilizar/dispositivo de un solo uso
	Sólo con prescripción
	No utilizar si el envase está dañado
	Mantener seco
	Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de vencimiento
STERILE R	Esterilizado mediante radiación gamma
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	Consultar las instrucciones de uso
CE	Producto con marcado CE
	Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Uso exclusivo de profesionales e instituciones sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM-1020-48	

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.

LINK	
Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® Modelos: Instrumental NO ESTÉRIL xxxx Contenido: 1 unidad REF LOT	
⚠	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	No Estéril
Método de esterilización recomendado	Se recomienda la esterilización mediante autoclave
CE	Producto con marcado CE
	Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Uso exclusivo de profesionales e instituciones sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM 1020-48	

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

ANEXO III. B

3 Instrucciones de Uso

3.1- Indicaciones contempladas en el rótulo.

2.1- Fabricante: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
Importador: SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A.
2.2- Información para identificar el producto: Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL®.
Marca: Link
Modelos: declarados en formulario.
2.3- Producto estéril. (Instrumental no estéril)
2.6- Producto de un solo uso.
2.7- Mantener seco. Mantener alejado de la luz solar.
2.8- Instrucciones especiales: Consultar Instrucciones de uso.
2.9- Advertencias y precauciones: Consultar las instrucciones de uso.
2.10- Esterilizado por radiación Gamma.
2.11- Responsable Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
2.12- Autorizado por la ANMAT PM 1020-48
Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.

3.2- Prestaciones y posibles efectos secundarios no deseados

Prestaciones:

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL®, es un sistema para la implantación primaria o revisión, cementada o no cementada.
Consiste en componentes definidos que se pueden combinar entre sí de acuerdo con sus usos aprobados.
La selección y aplicación de los dispositivos presupone una capacitación estándar para especialistas en ortopedia y cirugía y una experiencia adecuada con procedimientos ortopédicos y quirúrgicos.
La estabilidad está garantizada a través del ajuste preciso de los componentes femorales y tibiales en el hueso preparado, y debido a la elección adecuada de una amplia selección de tamaños.
El diseño femoral especial permite libertad de movimiento óptima con alta flexión.
Ofrece una alta precisión del ajuste tibial a través de mesetas tibiales de forma anatómica
Proporciona un anclaje tibial seguro.
Los vástagos tibiales aseguran una mayor estabilidad cuando las estructuras óseas son insuficientes.
La alineación óptima y el ajuste de los tejidos blandos son fáciles de lograr debido a un conjunto de instrumentos simple.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® está indicado en casos de enfermedades articulares severas con limitación de movilidad debido a artrosis o artritis degenerativa, reumatoide o postraumática, fracturas articulares que no permiten una reconstrucción osteosintética.

También se indica para pacientes con las siguientes afecciones:

- Necrosis ósea
- Artrosis bicondilar por ligamentos intactos, incluido el ligamento posterior
- Artrosis bicondilar por ligamentos colaterales intactos y ausencia de función del ligamento cruzado
- Artrosis de rótula
- Deformidades de valgo (<10 ° y 10 -15°)

Ante la sensibilización contra uno o más componentes de los materiales de los implantes usados, se encuentran también disponibles las versiones de superficie modificada PorEx® (TiNbN). Cabe destacar que el material base es el CoCrMo.

Y se encuentra contraindicado por:

- Infecciones agudas y crónicas, locales y sistémicas.
- Alergias a los materiales del implante
- Enfermedades musculares, nerviosas, vasculares u otras que ponen en riesgo la extremidad afectada
- Masa o calidad ósea insuficiente / inadecuada que impide un anclaje estable de la prótesis.

Está contraindicado relativamente frente a:

- Adiposidad
- Ligamentos colaterales insuficientes
- Musculatura insuficiente
- Falta de cumplimiento previsible o no asegurado.
- Sobrecarga previsible de prótesis articular

<u>Efectos Secundarios:</u>

Posibles riesgos y efectos adversos:

Riesgos operatorios y efectos adversos:

- Pérdida de sangre, transfusión de sangre autóloga o de donante
- Hinchazones / hematomas
- Trombosis / embolias / infarto de miocardio
- Trastornos de la cicatrización
- Infecciones
- Lesiones musculares y nerviosas
- Lesiones de vasos sanguíneos
- Dolores traumáticos postoperatorios
- Complicaciones de la anestesia utilizada
- Calcificaciones postoperatorias

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Riesgos y efectos adversos asociados al implante:

- Fracturas intraoperatorias
- Infección periprotésica
- Reacciones alérgicas a los componentes del implante y a partículas de desgaste
- Hipotensión brusca tras el uso de cemento óseo
- Roturas de implantes
- Aflojamiento o hundimiento de los implantes
- Mala posición u orientación de los implantes
- Reducción de la amplitud del movimiento
- Luxación de los componentes de articulación
- Diferencias de longitud de las extremidades
- Abrasión prematura: reoperación
- Dolor postoperatorio

3.3- Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberá utilizarse a fin de tener una combinación segura.

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® incluye los siguientes:

- Componentes femorales
- Componentes tibiales
- Componentes rotulianos
- Superficie de polietileno articulada (insertos)
- Tapa para cono de componente tibial
- Vástagos tibiales

3.4- Información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad.

Plan pre-operatorio:

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	Los puntos de referencia anatómicos en la articulación de la rodilla se definen preoperatoriamente al obtener imágenes de toda la pierna en el lado sano y el lado afectado, de pie. El ángulo entre el eje anatómico (centro de la articulación de la rodilla - canal intramedular) y el eje mecánico (centro de la cabeza femoral - centro de la articulación de la rodilla - centro del tobillo al segundo dedo del pie) determina el ángulo del valgo. Estos ángulos deben determinarse para ambas rodillas. El ángulo valgo de una articulación de rodilla sana es de 5° a 7°. En comparación con el lado sano, y con el fin de reconstruir el ángulo valgo correspondiente en la articulación de la rodilla afectada, este ángulo debe determinarse antes de realizar la resección femoral distal. El tamaño de implante apropiado se puede seleccionar preoperatoriamente con plantillas de rayos X. Las resecciones necesarias están determinadas por el tamaño del implante.

	⇦ Con la rodilla en ligera flexión, se realiza una incisión recta sobre la rótula, hasta la tuberosidad tibial. ⇨ Se realiza una incisión parapatelar medial a través del retináculo patelar, la cápsula y la membrana sinovial. Al hacer la incisión parapatelar, la rótula se empuja hacia un lado para visualizar la articulación femoropatelar. La eliminación de la membrana sinovial hipertrófica y partes de grasa permiten el acceso a las partes medial, lateral e intracondilar de la articulación. El exceso de sinovia debe eliminarse para evitar pinchazos y adherencias postoperatorias. Algunos cirujanos prefieren sinovectomía total.	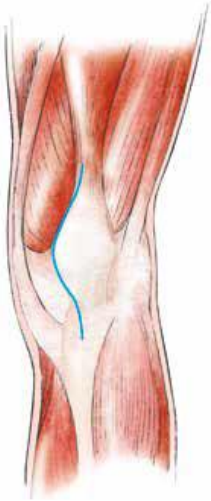

Resección de la meseta tibial:

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

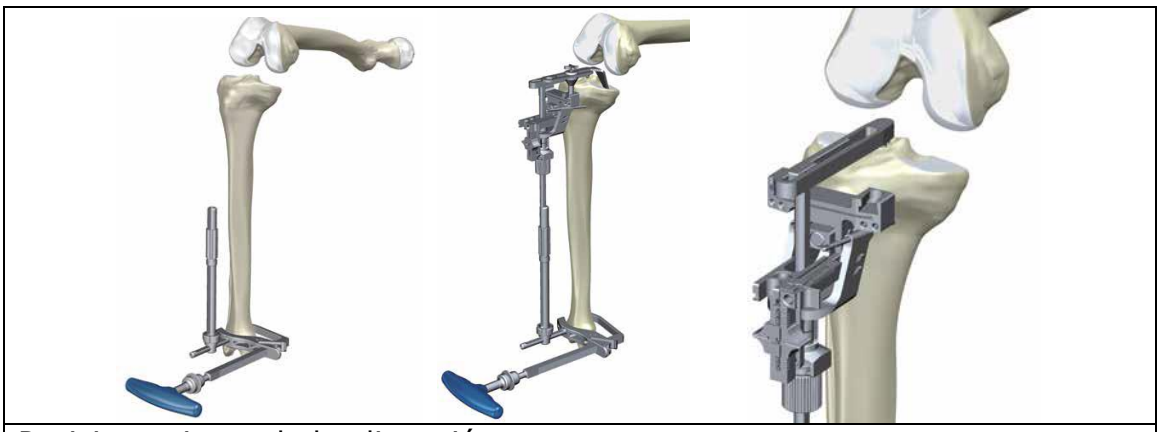

Posicionamiento de la alineación.
• Ajuste de posición de varo / valgo en neutro "0"
• Ajuste de la pendiente dorsal a 5 °.
La abrazadera del pie se une al tobillo y se aprieta con el mango.
La varilla de orientación EM se inserta con el brazo de fijación a través de la guía de la base tibial y dentro del tubo de guía distal, y se asegura con el mango de conexión.
En la región proximal, la punta del brazo de fijación descansa inicialmente en el área del punto de unión del ligamento cruzado anterior, aproximadamente en el centro de la región intercondilar en la meseta tibial. Luego se golpea la punta con un martillo. El instrumento de alineación se puede girar.

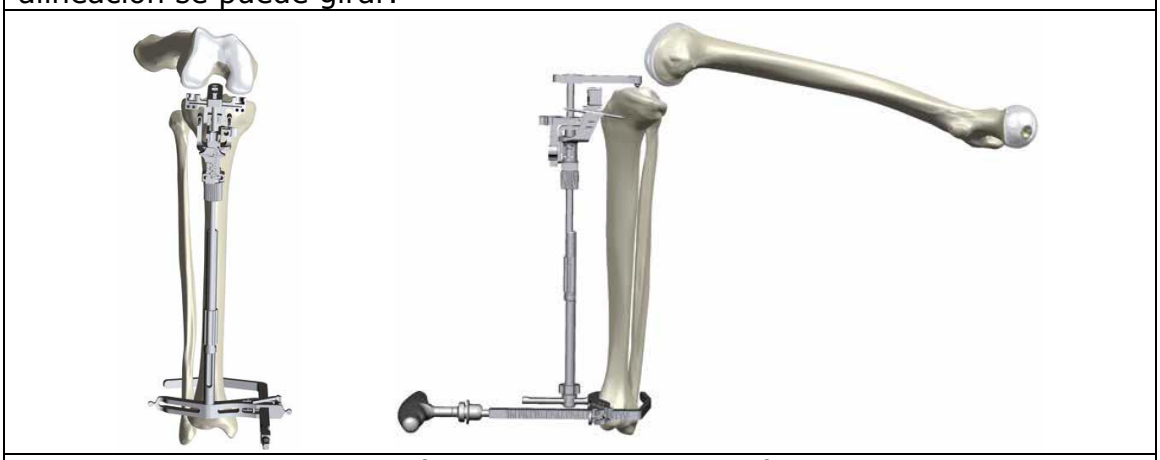

Para determinar la alineación correcta de la rotación, el instrumento de alineación se alinea centralmente a lo largo del eje tibial y en la extensión de una línea sobre el segundo dedo del pie.
Para asegurar la rotación, el instrumento de alineación se puede fijar en la meseta tibial por medio de un pin de fijación. El centro de la tibia, la tuberosidad tibial y el segundo dedo del pie pueden marcarse con un rotulador estéril.
Cuando el instrumento de alineación, visto desde un lado, es paralelo a la tibia ventral, esto significa que la guía de la sierra se encuentra en la

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

pendiente dorsal seleccionada previamente. El ajuste fino es posible después de la alineación.

La guía de sierra tibial se empuja contra el hueso cortical tibial ventral hasta el tope. La alineación correcta se puede verificar colocando una varilla de verificación.
La pendiente dorsal recomendada es de 5°. Se puede ajustar de a 1° con el ajuste fino.
El ajuste fino permite la corrección precisa de la alineación en varo o valgo.
Después de pre ajustar la altura de resección con la versión del lápiz óptico seleccionada, el cirujano puede realizar un ajuste fino de la altura de resección con el tornillo.

La plantilla de corte se puede utilizar para verificar la alineación de la resección tibial. Cualquier corrección necesaria a la posición puede llevarse a cabo en este punto.
Luego, el bloque de corte tibial se fija con un pin de fijación y se realiza la resección.

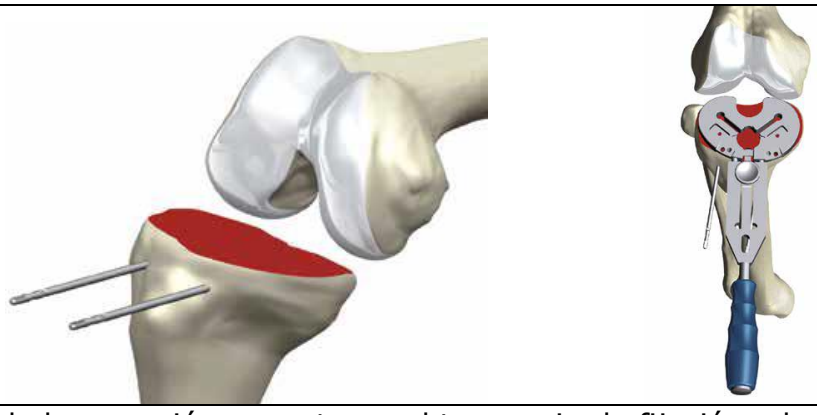

Después de la resección, se extraen el tercer pin de fijación y la guía de la sierra tibial. Los pines de fijación anteriores permanecen en posición.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

El tamaño del implante tibial se puede determinar aplicando el medidor tibial apropiado. El instrumento debe cubrir el hueso cortical de manera óptima, sin proyectar más allá de él. El tamaño del implante tibial puede servir como un indicador del tamaño del implante femoral si la medición femoral está entre dos tamaños.

Resección femoral - Resección distal (espacio de extensión)

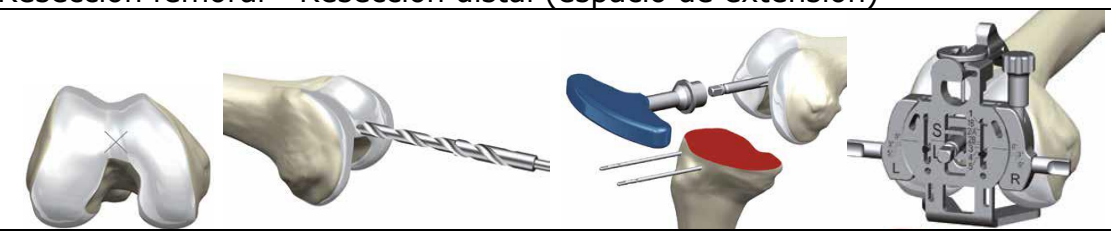

La rodilla se flexiona a 90 ° para resecar el fémur. Para determinar el punto de entrada (intersección de las líneas Whiteside e Insall) para abrir el fémur, esto se puede marcar con el electrocauterio. Por lo general, se encuentra aprox. 3–5 mm medialmente por encima de la fosa intercondilar. El espacio medular se abre con el taladro escalonado.
Se inserta la varilla de guía intramedular y se retira el mango en T.
El instrumento de medición del fémur está conectado, alineando el lápiz lateralmente sobre el hueso cortical ventral. La placa dorsal debe descansar contra los cóndilos dorsales.
Se realiza una primera predeterminación del tamaño femoral para seleccionar la guía de resección femoral distal apropiada. Los implantes se dividen en grupos pequeños (S) y grandes (L).
Pequeño (S): tamaños 1, 1B, 2, 2A y 2B
Grande (L): tamaños 3, 4 y 5
Esta predeterminación del tamaño de la prótesis articular se lee en la escala del instrumento.

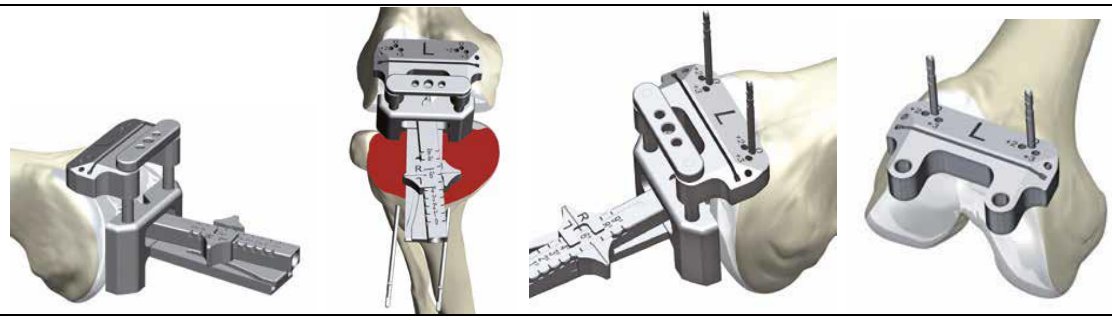

Según el tamaño femoral previamente seleccionado (pequeña "S" o grande "L"), el bloque de corte distal está conectado al instrumento de alineación para el ángulo valgo. Luego, se establece el ángulo de valgo determinado preoperatoriamente, y el instrumento se une a la barra de guía intramedular.
Antes de fijar el bloque de corte distal con dos pines de fijación, debe asegurarse de que al menos un cóndilo esté en contacto con el instrumento

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

de alineación y que se haya establecido el ángulo valgo del lado correcto. Los dos pines de fijación se insertan a través de los agujeros "0". Luego, el instrumento de alineación para el ángulo valgus se separa del bloque de corte distal y se retira. La barra de guía intramedular se retira.			
			
La plantilla de corte se puede usar para verificar la alineación de la resección distal.	Para hacer que el instrumento sea más estable, se fija un 3er pin de fijación en el orificio diagonal exterior. Existe la opción de insertar un 4to pin de fijación.	El corte de sierra distal se realiza a 90 ° de flexión. Luego se quita el bloque de corte.	Los pines de fijación paralelos permanecen en posición. Es posible establecer el espacio de extensión por medio de la resección posterior.

Comprobación del espacio de extensión y los ejes

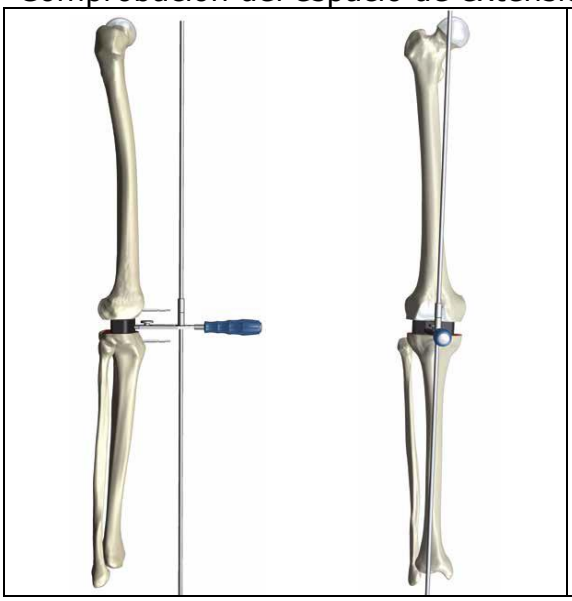	Después de una limpieza cuidadosa de los tejidos blandos, se inserta el espaciador, de acuerdo con el tamaño femoral, y se verifica tanto la alineación axial como la estabilidad de la articulación en extensión. Si no se requieren resecciones adicionales, los pines de fijación femoral y tibial se pueden quitar.

Resección femoral final

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

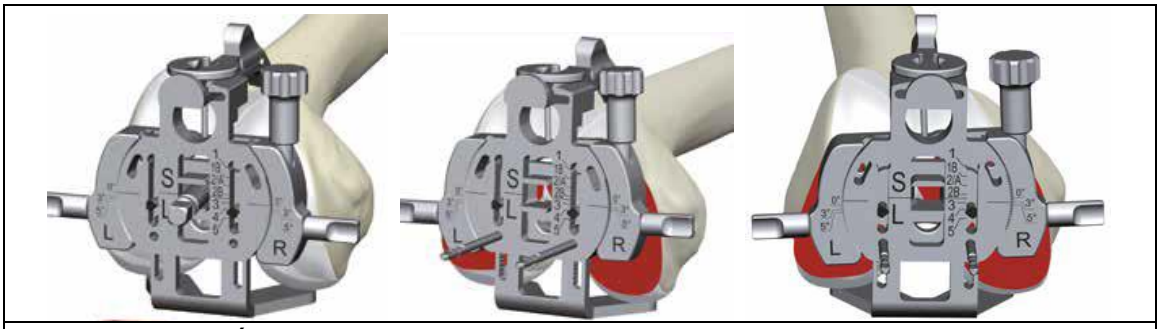

Para la resección femoral final, el siguiente paso es determinar el tamaño femoral definitivo. El instrumento de medición del fémur se aplica a la superficie de resección femoral distal.
El instrumento de medición del fémur se puede aplicar sobre la varilla de guía intramedular para garantizar un posicionamiento estable. Esta medida determina la adaptación del tamaño del implante femoral a A / P. Para verificar la dimensión M / L del tamaño seleccionado, se puede realizar la prueba de fémur adecuada. El tamaño femoral se lee desde el lado derecho.
Se utilizan dos pines de fijación para fijar el tamaño y, al mismo tiempo, para fijar el marco del instrumento de medición a la superficie de resección distal.
El instrumento de alineación permite un ajuste continuo de 0° a 5° de rotación externa en referencia a la tangente dorsal del cóndilo.
Alternativamente, la rotación externa se puede alinear utilizando la línea Whiteside, con la varilla de alineación en el centro del instrumento.
Los pines de alineación se proporcionan medial y lateralmente para alinearse en la línea epicondilar (línea Insall).

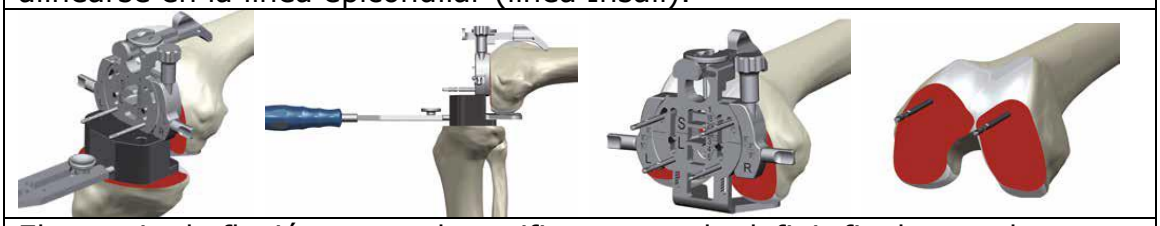

El espacio de flexión se puede verificar antes de definir finalmente la rotación y la resección femoral.
Flexione la articulación de la rodilla 90°. El extremo escalonado del espaciador para el tamaño seleccionado se desliza debajo del bloque de control para que el extremo superior descanse contra el bloque de control.
El diseño escalonado significa que los cóndilos están expuestos.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

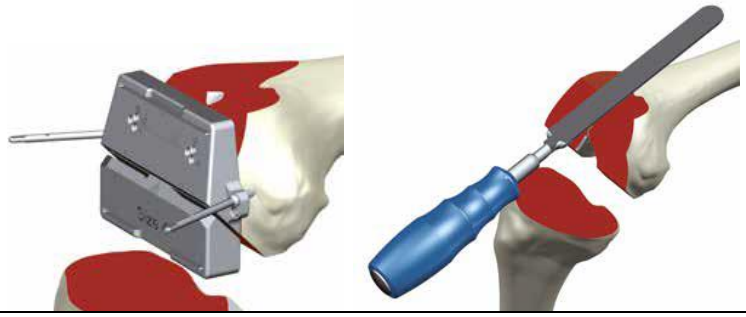

El bloque de corte femoral se une sobre los pines de fijación y se fija con pines de tornillo.
Es posible utilizar pines de fijación (Ø 3,5 mm) con tope para la fijación del bloque de corte femoral.
El espacio de flexión se puede verificar o corregir usando el espaciador en combinación con el bloque de corte femoral. El espaciador se empuja con el lado escalonado hasta debajo del bloque, hasta el punto más alto debajo del bloque de corte femoral. El espacio de flexión se puede ajustar mediante la reacción del bloque de corte femoral antes de la resección final.
La plantilla de corte se puede utilizar para verificar la alineación de las resecciones individuales, especialmente el corte ventral.
Primero se realiza el corte ventral, seguido del corte dorsal y luego de la faceta anterior y posterior.
Después de eso, la tróclea se prepara con la raspa.

Soporte fijo PS

La guía de la caja se selecciona de acuerdo con el tamaño del fémur y se coloca en el extremo resecado del fémur. La alineación se realiza en la ranura y la dimensión m / l.
La guía de la caja está diseñada simétricamente para permitir el uso universal.
Las líneas de guía de marcado permiten la orientación y la alineación.
La guía de la caja se fija con al menos dos pines de fijación, o con tres si se prefiere.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

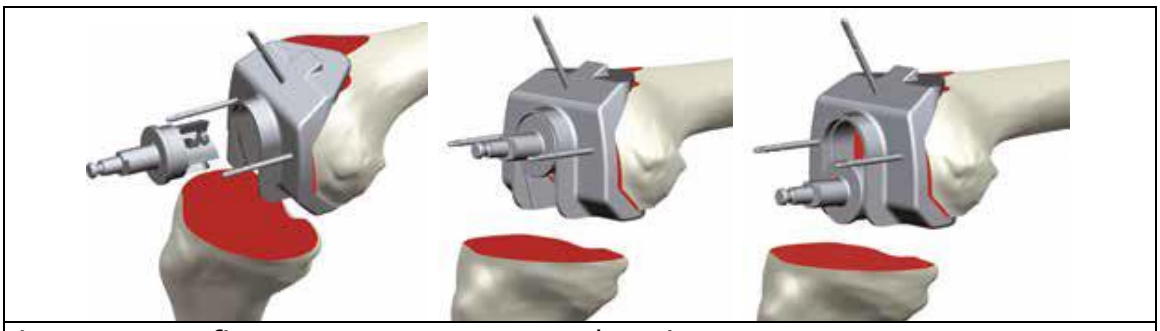

La ranura trefina se usa para preparar la caja:
1 taladro en la posición 1
2 Taladro en la posición 2
3 Alise la resección pasando la ranura trefina de la posición 1 a la 2

Preparación tibial

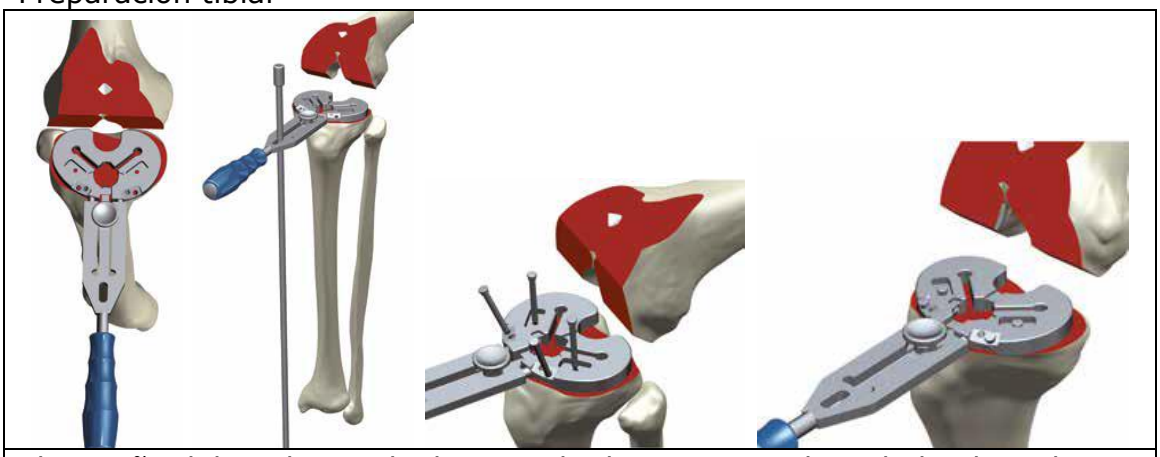

El tamaño del implante tibial se puede determinar aplicando la placa de resección tibial adecuada. El instrumento debe cubrir el hueso cortical de manera óptima, sin proyectar más allá de él.
Después de usar el medidor tibial apropiado y alinear la rotación con la ayuda de la varilla de alineación extramedular, el último paso es fijar la placa de resección tibial con 4 pines con cabeza.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

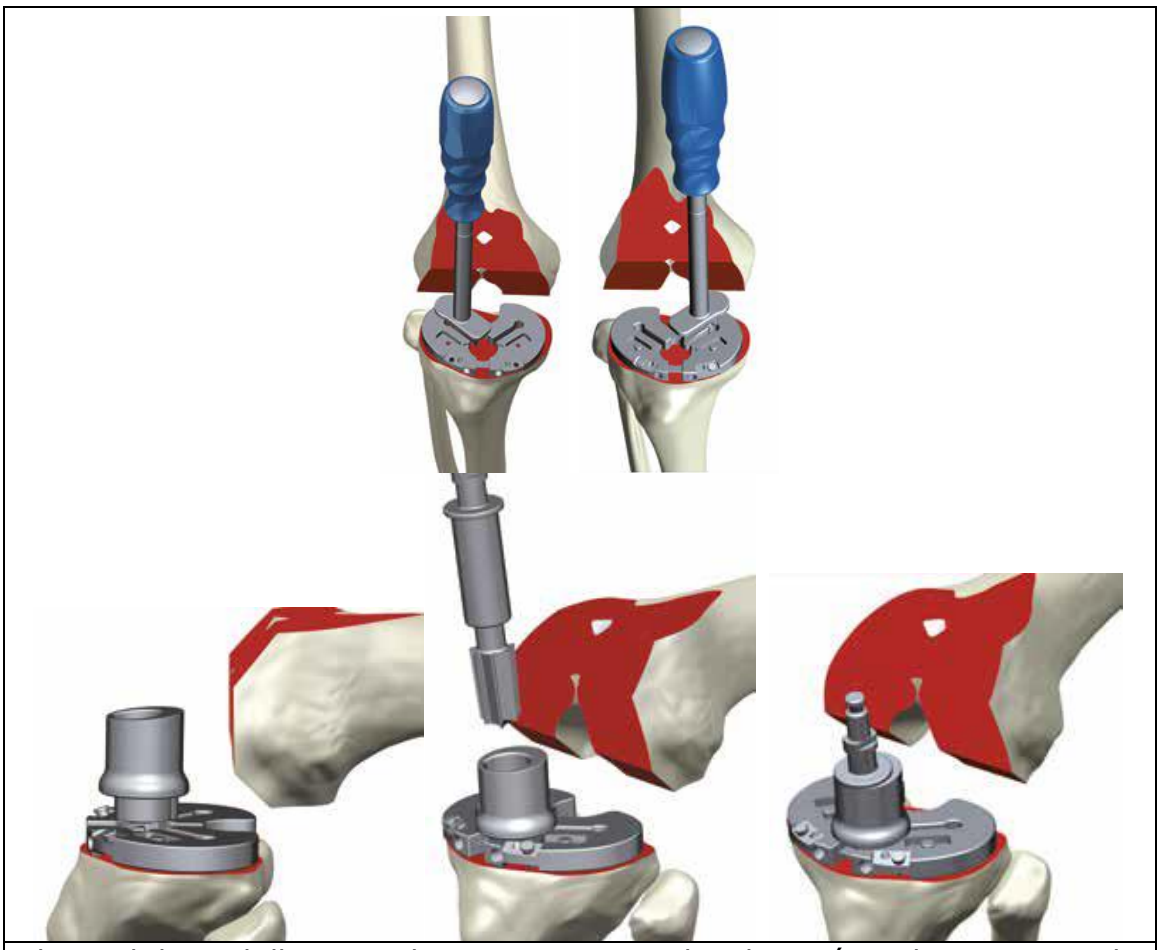

El cincel de cuchillas se utiliza para preparar las dos guías y los agujeros de anclaje para los pines de fijación de la placa base tibial.
Luego se inserta el manguito guía y se reseca la guía cónica.
La elección de la fresa depende de la opción de tratamiento que se seleccione: tapa cónica tibial o extensión del vástago.

Reducción de prueba y prueba funcional

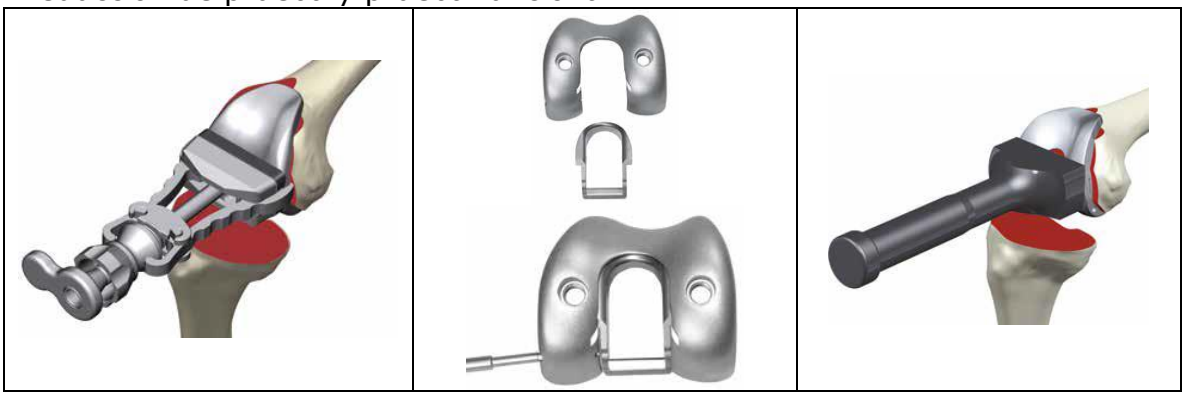

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

		
La prueba de fémur se selecciona de acuerdo con el tamaño femoral resecado y se coloca con el mango y el impactor acoplables	Procedimiento para GEMINI® PS La caja de prueba de fémur PS se inserta en la prueba de fémur y se fija con el tornillo de fijación. Luego, la prueba se coloca con el mango desmontable y el impactor.	Además, la prueba se puede insertar en su posición final utilizando el controlador. Luego se taladran los agujeros de fijación con la broca helicoidal de 5,5 mm. Se aplica una guía para guiar la broca helicoidal.

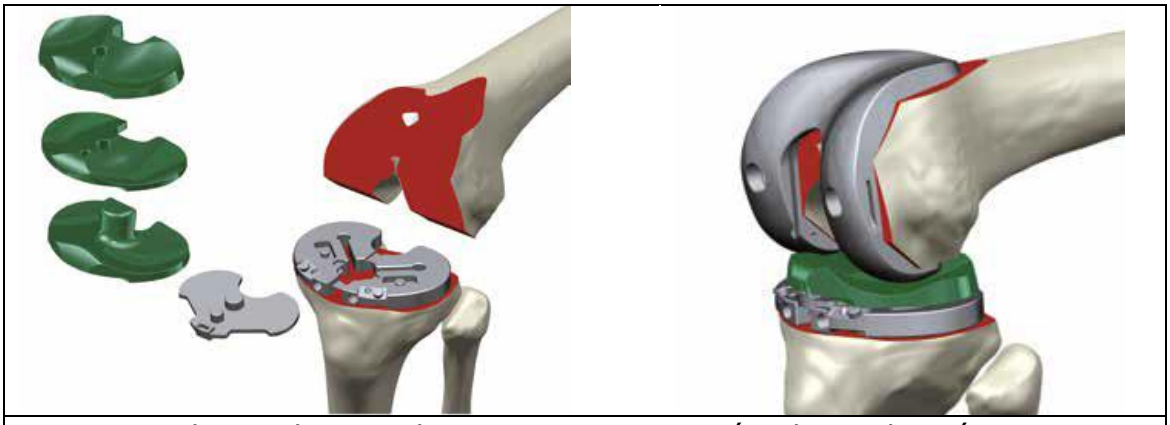
La meseta de prueba se selecciona y se usa según el tipo de prótesis elegida (soporte fijo, soporte fijo PS o soporte móvil). Las diferentes alturas se establecen mediante la cuña.
Soporte fijo / Soporte fijo PS 1. La cuña ensamblada con la meseta de prueba se inserta en la placa de preparación de tibia. 2. Se coloca la prótesis de prueba femoral.
Soporte móvil 1. Se coloca la prótesis de prueba femoral. 2. Se inserta una cuña ensamblada con meseta de prueba en la placa de preparación de tibia. Luego se realiza la reducción de prueba con la articulación de la rodilla en extensión y flexión, y se comprueba la tensión del ligamento.
Corrección de altura:

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Soporte fijo / Soporte fijo PS Para ajustar la altura se elimina la meseta de prueba con cuña. Entonces la cuña se cambia en consecuencia. Soporte móvil: Para la corrección de la altura de la meseta en la prótesis de prueba femoral, la meseta de prueba debe usarse para el soporte fijo.
Asegúrese de que ninguna estructura ósea (p. Ej., Osteofitos) o partes de tejido interfieran con el movimiento. Si es necesario, vuelva a trabajar el hueso en el área de la ranura, pero especialmente en los cóndilos dorsales, usando un cincel curvo pequeño. Los implantes de prueba se retiran.

Implantación

Componente femoral →		1	1B	2	2A	2B	3	4	5
Superficie de polietileno articulada →		1	1B	2	2A/B		3	4	5
Componente tibial	1	✓	☑	☑	×	×	×	×	×
	2	✓	✓	✓	☑	☑	☑	×	×
	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☑	×
	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☑
	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Compatibilidad sin restricciones
☑	Compatibilidad restringida, dependiendo de la situación del tejido blando del paciente en relación con la superficie articulada
×	Combinación prohibida

Secuencia de implantación

- Soporte móvil

1.1 Implantación del componente tibial
1.2 Implantación del componente femoral
1.3 Inserción de la superficie articulada de acuerdo a la tabla de compatibilidad.
2.1 Ensamblaje de la superficie articulada con el componente tibial de acuerdo a la tabla de compatibilidad.
2.2 Implantación del componente tibial completo con la superficie articulada de acuerdo a la tabla de compatibilidad.
2.3 Implantación del componente femoral.

- Soporte fijo/Soporte fijo PS

1.1 Implantación del componente tibial fijo
1.2 Implantación del componente femoral
1.3 Inserción de la superficie articulada fija o fija PS de acuerdo a la tabla de compatibilidad.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Descripción general del implante de tibia:

Opcionalmente, se puede colocar una tapa para cono o extensiones de vástago en el cono y fijarlo con un tornillo. Éstos están disponibles en versiones cementadas y no cementadas.
Si se utiliza el componente tibial con vástago, asegúrese de que el canal medular tibial se reseque adecuadamente antes de la colocación.
La tapa para cono o el del vástago se fijan principalmente mediante sujeción cónica y se asegura doblemente con un segundo tornillo de fijación.

Un primer tornillo de fijación (sin cabeza con punta) ya está en su lugar en el agujero cónico.
El segundo tornillo de fijación se suministra, en un embalaje estéril, junto con el componente tibial.
Atornille el primer tornillo de fijación (sin cabeza con punta) (56-a –1) y apriételo fuertemente con la mano.
Luego atornille el segundo tornillo de fijación (56-a –2) con punta plana para doble fijación.

	Después de la resección de la tibia, la tapa para cono o el vástago se seleccionan de acuerdo con el tipo de tratamiento planificado y se colocan en el cono del componente tibial. Al hacer esto, alinee la marca en la tapa para cono o el vástago con la marca en el cono del componente tibial. Luego arreglar con un golpe de martillo. Coloque una gasa sobre la superficie para protegerla del golpe de

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	martillo.
	Atornille el primer tornillo de fijación (sin cabeza con punta) (1) y apriételo fuertemente con la mano. Luego atornille el segundo tornillo de fijación (2) con punta plana para doble fijación.

- Soporte móvil

Componente tibial cementado. El cemento óseo se prepara siguiendo las instrucciones específicas del fabricante y se aplica a la superficie inferior del componente tibial. El componente tibial se inserta luego en la tibia resecada y se conduce a la superficie de resección de la cabeza tibial con el destornillador (57). Asegúrese de eliminar completamente el exceso de cemento óseo y de que no queden partículas sueltas de cemento óseo, especialmente en la región dorsal de la articulación.	
Componente tibial sin cemento. El componente tibial no cementado se introduce directamente en la tibia resecada y se conduce a la superficie de resección de la cabeza tibial con el impactor.	
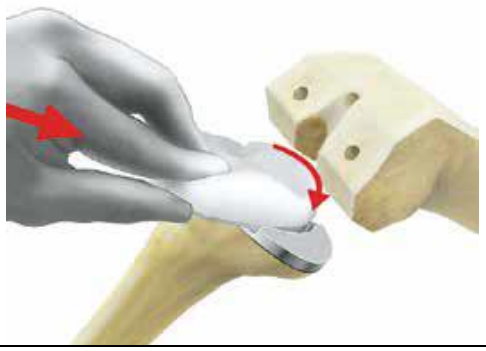	
Para cada tipo de fijación (cementada / no cementada), utilice solo los implantes marcados correspondientemente. Inserte la superficie articulada de PE (soporte móvil) de lado en dirección longitudinal y gire 90 ° en sentido horario para ubicarla en su posición final.	

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

	Opcionalmente, el componente tibial puede accionarse junto con la superficie de articulación de PE previamente montada. El instrumento utilizado para este propósito es el impactor adaptado para la superficie de articulación plástica.
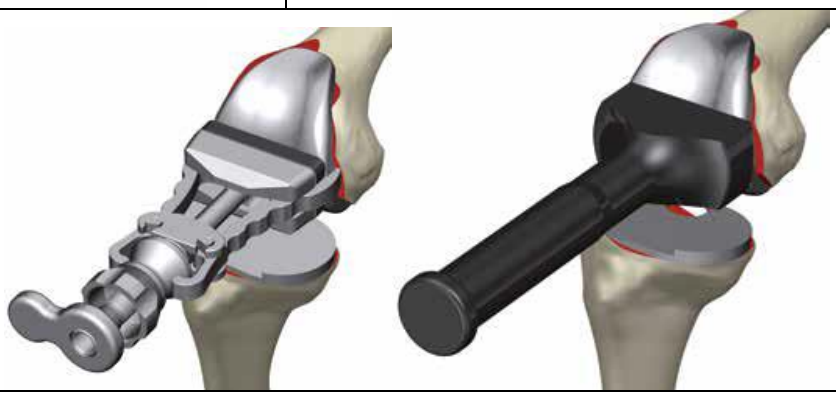	
Componente femoral cementado. El componente femoral está acoplado con el mango y el impactor acoplables. Después de aplicar el cemento óseo, preparado de acuerdo con las instrucciones específicas del fabricante, se implanta el componente femoral. Se acciona con el mango acoplable y el impactor. Para finalizar, el componente femoral se puede volver a accionar con el impactor de plástico. Asegúrese de eliminar completamente el exceso de cemento óseo y de que no queden partículas sueltas de cemento óseo, especialmente en la sección dorsal de la articulación.	
Componente femoral no cementado. El componente femoral no cementado se acopla de la misma manera que se describe anteriormente para la versión cementada, utilizando el mango y el impactor acoplables. El posicionamiento del componente femoral y la implantación se realizan con varios golpes de martillo medidos pero contundentes.	

- Soporte fijo/Soporte fijo PS

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

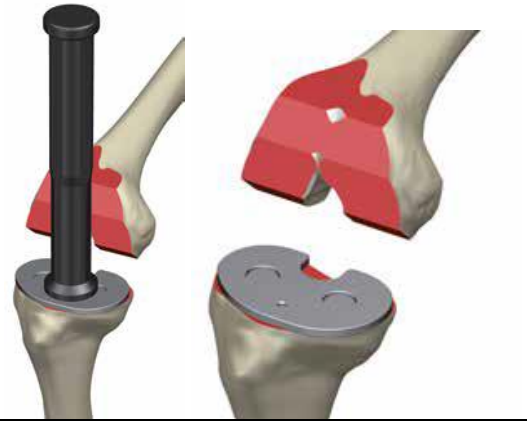
Componente tibial cementado. El tornillo para fijar la superficie de articulación de UHMWPE se atornilla en el componente tibial. No debe retirarse para cementar. El cemento óseo se prepara siguiendo las instrucciones específicas del fabricante y se aplica a la superficie inferior del componente tibial. Luego se inserta el componente tibial en la tibia resecada y se golpea en la superficie de resección. Asegúrese de eliminar completamente el exceso de cemento óseo y de que no queden partículas sueltas de cemento óseo, especialmente en la sección dorsal de la articulación.
Componente tibial sin cemento El componente tibial no cementado se introduce directamente en la tibia resecada.
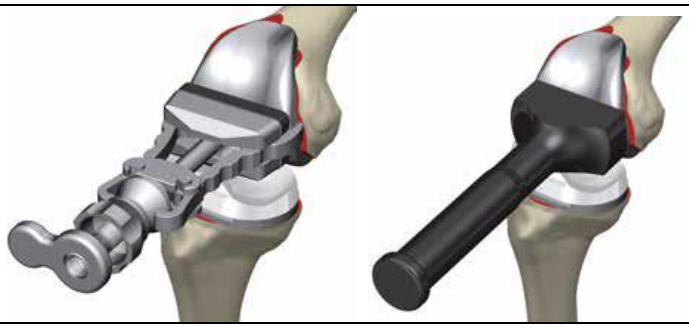
Componente femoral cementado. El componente femoral está acoplado con el mango y el impactor acoplables. Después de aplicar el cemento óseo, preparado de acuerdo con las instrucciones específicas del fabricante, se implanta el componente femoral. Se acciona con el mango y el impactador acoplables. Para finalizar, el componente femoral se puede volver a accionar con el impactor de plástico. Asegúrese de eliminar completamente el exceso de cemento óseo y de que no queden partículas sueltas de cemento óseo, especialmente en la sección dorsal de la articulación.
Componente femoral no cementado.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

El componente femoral no cementado se acopla de la misma manera que se describe anteriormente para la versión cementada, utilizando el mango y el impactor acoplables. El posicionamiento del componente femoral y la implantación se realizan con varios golpes de martillo medidos pero contundentes.
Superficie articulada de PE. Se selecciona e inserta la superficie articulada de PE (fija o fija PS) correspondiente al componente femoral. Asegúrese de que los dos pines de fijación en la superficie inferior de la superficie articulada estén colocados en los huecos del componente. Para finalizar, la superficie articulada de PE se fija al componente utilizando el tornillo de fijación suministrado junto con el componente.

Prueba funcional

Componentes femorales y tibiales implantados. La prueba funcional final está diseñada para verificar que los componentes estén correctamente posicionados en extensión y flexión de la articulación de la rodilla, y también para verificar la tensión correcta del ligamento.

3.5- Advertencias

- Elegir el implante correcto es muy importante. El tamaño y la forma del hueso humano determinan el tamaño y la forma del implante y también limitan la carga capacidad. Los implantes no están diseñados para resistir el estrés físico ilimitado. Las demandas no deben exceder cargas funcionales normales.
- El manejo correcto del implante es muy importante.

Bajo ninguna circunstancia se debe alterar la forma de un implante terminado, ya que esto acorta su vida útil.

¬ Los implantes no deben combinarse con implantes de otros fabricantes.

¬ El instrumental indicado en la técnica quirúrgica debe utilizarse para garantizar la implantación segura de los componentes.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

¬ Los implantes no deben ser reutilizados. Los implantes se suministran estériles y están destinados a un solo uso. Los implantes usados no deben reutilizarse.

¬ El tratamiento posterior también es muy importante. El paciente debe ser informado de las limitaciones del implante. La capacidad de carga de un implante no se puede comparar con la de hueso sano.

¬ A menos que se indique lo contrario, los implantes se suministran en envases estériles.

¬ Tenga en cuenta las siguientes condiciones para el almacenamiento de implantes envasados:

• Evite los cambios de temperatura extremos o repentinos.

• Los implantes estériles en su embalaje original e intacto pueden almacenarse en edificios permanentes hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

• No deben exponerse a heladas, humedad, luz solar directa ni daños mecánicos.

• Los implantes pueden almacenarse en su embalaje original hasta 5 años después de la fecha de fabricación. La fecha de "Uso antes de" se indica en la etiqueta del producto.

• No utilice un implante si el embalaje está dañado.

¬ La trazabilidad es importante. Utilice las etiquetas proporcionadas para garantizar la trazabilidad.

¬ Deben seguirse las instrucciones de uso.

3.6- Riesgos de interferencia recíproca en investigaciones o tratamientos específicos

No corresponde

3.7- Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización

A menos que se indique lo contrario, los implantes se suministran en envases estériles.
No use un implante si el embalaje está dañado.
Evite cambios extremos o repentinos en la temperatura.
Los implantes estériles en su embalaje de protección intacto original se pueden almacenar en edificios permanentes hasta la fecha indicada en el paquete.
No deben exponerse a las heladas, a la humedad, a la luz solar directa ni a daños mecánicos.
Los implantes pueden almacenarse en su embalaje original hasta 5 años después de la fecha de fabricación.
Los implantes han sido diseñados para un solo uso. Queda prohibida la reesterilización de los implantes por parte del usuario.
El diseño de estos productos y de sus materiales no permite la reesterilización. Esta podría provocar alteraciones imprevisibles en los productos.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

El instrumental asociado al sistema se suministra sin esterilizar, debe acondicionarse y esterilizarse antes de cada uso.

3.8- Si el producto médico está destinado a reutilizarse, datos sobre los procedimientos de reutilización, incluido la limpieza, desinfección, acondicionamiento, y esterilización

Implantes: Son productos de un sólo uso.

Instrumental:
Tras cada uso, los instrumentos deben ser limpiados, desinfectados y revisados por personal cualificado.
Para ello, los instrumentos se deben desmontar al máximo posible en sus componentes individuales. Recomendamos eliminar la suciedad gruesa de los instrumentos con un paño sin pelusa inmediatamente después de su uso. A continuación, los instrumentos se deben someter a una limpieza ulterior antes de que los líquidos corporales, los restos de tejido y los demás residuos puedan secarse. Por ello, después de la intervención deben transferirse sin demora a la central de esterilización.

Limpieza manual

1. Utilice la solución de limpieza enzimática de pH neutro preparada según las especificaciones del fabricante.
2. Sumerja el instrumento (o sus componentes) completamente en la solución enzimática y déjelo en remojo durante 20 minutos. Limpie el instrumento con cuidado con un cepillo de cerdas de plástico blandas (prestando especial atención a las cavidades y a las demás zonas de difícil acceso) hasta haber eliminado toda la suciedad visible. Los conductos internos se deben limpiar con un cepillo largo y estrecho de cerdas blandas. Nota: Renueve la solución enzimática si está muy sucia (sangre y/o residuos en suspensión). No utilice para la limpieza cepillos metálicos ni lana de acero.
3. Extraiga el instrumento de la solución enzimática y enjuáguelo como mínimo durante 3 minutos en agua pura obtenida mediante ultrafiltración, OI (osmosis inversa), DI (desionización) y/o destilación o mediante la combinación de estos procedimientos. Enjuague meticulosamente los canales internos, las aberturas y las demás áreas de difícil acceso.
4. Prepare la solución de limpieza de pH neutro y viértala en un equipo de limpieza por ultrasonidos.
5. Sumerja el instrumento completamente en la solución de limpieza y límpielo durante 10 minutos con ultrasonidos, preferentemente a 45–50 kHz.
6. Enjuague meticulosamente el instrumento como mínimo durante 3 minutos con agua pura obtenida mediante ultrafiltración, OI, DI y/o destilación o mediante una combinación de estos procedimientos o hasta que el agua de lavado ya no presente restos de sangre o de suciedad.
7. Repita los pasos 5 y 6 con solución de limpieza recién preparada.
8. Seque el instrumento con un paño desechable limpio, absorbente y sin pelusa.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Limpieza mecánica:

Antes de la limpieza y desinfección mecánica en el equipo de limpieza y desinfección validado por parte de personal cualificado, se recomienda:

1. La eliminación en seco en el quirófano.
2. El desmontaje completo de los componentes desmontables.
3. La eliminación manual mecánica de la suciedad gruesa, a ser posible debajo del grifo de agua corriente.
4. La limpieza por ultrasonidos en cestas de lavado adecuadas.
5. Los instrumentos se deben introducir desmontados o abiertos en cestas de lavado adecuadas. Se debe prestar atención a que esté asegurado un lavado suficiente alrededor de los instrumentos y que no se creen sombras de lavado. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del equipo de limpieza y desinfección. En los instrumentos huecos debe ser posible realizar un lavado óptimo tanto en el exterior como en el interior; utilice en caso necesario adaptadores específicos para el equipo de limpieza y desinfección.
6. La limpieza y desinfección mecánica se debe realizar con un equipo de limpieza y desinfección validado. Para una limpieza automática validada (incluyendo la desinfección térmica a 93 °C durante 5 min.) recomendamos tras la realización de los puntos 1 hasta 5 los siguientes parámetros de programa con limpiador alcalino:

Paso de programa	Suministro de agua	Tiempo del paso	Tiempo de dosificación
Limpieza previa	Agua fría	4 min.	–
Limpieza	Agua desmineralizada	7 min.	80 s a 40 °C
Neutralizador	Agua desmineralizada	1 min.	20 s
Enjuague posterior	Agua desmineralizada	5 min.	10 s a 50 °C
Secado 1ª fase		5 min.	–
Secado 2ª fase		10 min.	–

Paso de programa	Temperatura	Producto químico
Limpieza previa	25 °C	–
Limpieza	60 °C	neodisher MediClean forte
Neutralizador	–	neodisherN
Enjuague posterior	93 °C	neodisher Mediklar
Secado 1ª fase	120 °C	–
Secado 2ª fase	120 °C	–

Esterilización:

El instrumental está diseñado para la esterilización con calor húmedo (esterilización por vapor) con el método de prevacío fraccionado (134 °C y un tiempo de mantenimiento de como mínimo 5 minutos, por parte de personal cualificado.

La esterilización por vapor se puede realizar en un embalaje de papel estéril normalizado y también en el cestillo previsto al efecto en el contenedor de esterilización.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

El método de esterilización debe ser validado por el usuario. La temperatura no debe superar los 137 °C, ya que de lo contrario podrían dañarse los mangos, los aislamientos u otros componentes no metálicos.
Se debe prestar atención a esterilizar los instrumentos montados, pero abiertos. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del esterilizador relativas a la manipulación y la carga.
Los componentes de plástico y recubiertos de plástico no pueden esterilizarse en aparatos de esterilización por aire caliente. Recomendación: Si se utilizan contenedores de esterilización con cestillos, se recomienda envolver además los cestillos cargados en paños o tejidos adecuados. El peso total por contenedor no debe superar los 10 kg.
Si se sospecha una posible contaminación por priones, se debe aplicar a 134 °C un tiempo de mantenimiento de al menos 18 minutos para la esterilización por vapor.
Manipulación, almacenamiento y transporte
Los instrumentos quirúrgicos se deben manipular siempre con cuidado. Esto es especialmente válido para el transporte, la limpieza, la conservación, la esterilización y el almacenamiento. El estado estéril de los instrumentos depende, entre otras cosas, del embalaje de material estéril y de las condiciones de almacenamiento existentes y se debe determinar en cada caso con los responsables de la higiene del operador. Deben protegerse de la luz solar directa. El manejo o la conservación incorrectos, así como el uso inadecuado, pueden provocar un desgaste prematuro o dañar los instrumentos.

3.9- Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que se deba realizar antes de utilizar el producto médico (Ej., esterilización, montaje final, entre otros)

No corresponde.

3.10- Información sobre naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación si el producto médico emite radiaciones con fines médicos

No corresponde.

3.11- Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico

No corresponde.

3.12- Precauciones que deben adoptarse, en condiciones ambientes previsibles, con respecto a la exposición a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión o variaciones de la presión, aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® no ha sido evaluado con respecto a la seguridad y compatibilidad en un entorno de tomografía por resonancia magnética.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

Los implantes no se han comprobado con respecto al calentamiento o el desplazamiento en un entorno de tomografía por resonancia magnética.
No se ha probado su calentamiento, migración o artefactos de imagen en el entorno de RM. Se desconoce la seguridad del sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® en el entorno de RM. Escanear a un paciente que tiene este dispositivo puede provocar lesiones al paciente.

3.13- Medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar

No corresponde.

3.14- Precauciones en la eliminación del producto médico

No corresponde.

3.15- Medicamentos incluidos en el producto médico

No corresponde.

3.16- Grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición

No corresponde.

El presente documento electrónico ha sido firmado digitalmente en los términos de la Ley N° 25.506, el Decreto N° 2628/2002 y el Decreto N° 283/2003.-

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2020-49277066-APN-INPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Julio de 2020

Referencia: ROT. E. INST. DE USO-SWISS PROTECH S.A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.29 16:29:54 -03:00

Marcela Claudia Rizzo
Directora Nacional
Instituto Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.29 16:29:49 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Certificado - Redacción libre

Número: CE-2020-54779024-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Agosto de 2020

Referencia: 1-47-3110-3853-20-0

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-3853-20-0

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® y su instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-096 Prótesis, de Articulación, para Rodilla, Total

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINK

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema de reemplazo total de rodilla Gemini® SL® está indicado en casos de enfermedades articulares severas con limitación de movilidad debido a artrosis o artritis degenerativa, reumatoide o postraumática, fracturas articulares que no permiten una reconstrucción osteosintética.

También se indica para pacientes con las siguientes afecciones:

- Necrosis ósea

- Artrosis bicondilar por ligamentos intactos, incluido el ligamento posterior

- Artrosis bicondilar por ligamentos colaterales intactos y ausencia de función del ligamento cruzado

- Artrosis de rótula

- Deformidades de valgo (<10 ° y 10 -15°)

Modelos:

318-102/01 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-102/02 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-102/03 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-102/04 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-102/05 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-102/16 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-102/25 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-102/26 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-103/01 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-103/02 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-103/03 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-103/04 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-103/05 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-103/16 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-103/25 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-103/26 LINK® Componente femoral - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-112/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-112/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-112/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-112/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-112/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-112/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-112/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-112/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-113/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-113/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-113/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-113/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-113/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-113/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-113/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-113/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-190/07 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 70 mm

318-190/10 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 100 mm

318-190/14 LINK® Vástago tibial - Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 140 mm

318-191/07 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 70 mm

318-191/10 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 100 mm

318-191/14 LINK® Vástago tibial - No Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 140 mm

318-204/01 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-204/02 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-204/03 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-204/04 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-204/05 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-204/16 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-204/25 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-204/26 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-205/01 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-205/02 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-205/03 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-205/04 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-205/05 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-205/16 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-205/25 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, izquierdo

318-205/26 LINK® Componente femoral - recubierto TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-206/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-206/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-206/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-206/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-206/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-206/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-206/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-206/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-207/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-207/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-207/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-207/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-207/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-207/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-207/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-207/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® -Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-208/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-208/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-208/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-208/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-208/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-208/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-208/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-208/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-209/01 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-209/02 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-209/03 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-209/04 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-209/05 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-209/16 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-209/25 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, izquierdo

318-209/26 LINK® Componente femoral -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-212/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-212/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-212/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-212/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-212/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-212/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-212/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-212/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-213/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-213/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-213/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-213/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla

GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-213/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-213/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-213/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-213/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-214/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-214/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-214/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-214/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-214/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-214/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-214/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-214/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-215/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-215/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-215/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-215/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-215/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-215/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-215/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-215/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-216/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; derecho

318-216/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-216/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-216/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-216/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-216/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; derecho

318-216/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-216/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-217/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño; izquierdo

318-217/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-217/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-217/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-217/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No

cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-217/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra pequeño plus; izquierdo

318-217/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-217/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-231/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-231/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-232/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-232/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-233/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-233/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-234/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-234/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-235/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-235/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-237/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-237/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-238/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-238/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-241/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-241/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-242/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-242/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-243/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-243/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-244/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-244/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-245/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-245/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-247/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-247/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-248/10 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/12 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/14 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/16 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-248/18 LINK® Superficie de polietileno articulada para componente tibial (soporte fijo) -Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-251/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-251/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-252/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-252/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-253/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-253/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-254/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-254/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-255/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-255/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI®

SL® extra-grande; derecho

318-256/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-256/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-258/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-258/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-261/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-261/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-262/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-262/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-263/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-263/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-264/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-264/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-265/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-265/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-266/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-266/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-268/10 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/12 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/14 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/16 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-268/18 LINK® Superficie de polietileno articulada de soporte fijo PS - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-312/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-312/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-312/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-312/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla

GEMINI® SL® grande; derecho

318-312/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-313/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-313/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-313/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-313/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-313/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-314 LINK® Tapa para cono de componente tibial- Cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm; cementado

318-314/01 LINK® Tapa para cono de componente tibial- No cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm; no cementado

318-315 LINK® Tapa para cono de componente tibial- No cementado - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® Ø 16 mm; length 31 mm;

318-316/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-316/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-316/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-316/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-316/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-317/01 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-317/02 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado-

Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-317/03 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-317/04 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-317/05 LINK® Componente tibial para componente rotacional- Recubrimiento TiCaP® - No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-324/01 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-324/02 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-324/03 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-324/04 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-324/05 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-325/01 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-325/02 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-325/03 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-325/04 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-325/05 LINK® Componente tibial Soporte móvil - de superficie modificada PorEx® -

Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-326/01 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-326/02 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-326/03 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-326/04 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-326/05 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-327/01 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-327/02 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-327/03 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-327/04 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-327/05 LINK® Componente tibial soporte móvil -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-328/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-328/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-328/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-328/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-328/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-329/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-329/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-329/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-329/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-329/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - de superficie modificada PorEx® -Cementado- Reemplazo

total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-336/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-336/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-336/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-336/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-336/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-337/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-337/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-337/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-337/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-337/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) -de superficie modificada PorEx® + TiCaP® -No cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-372/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-372/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-372/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-372/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-372/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-373/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-373/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-373/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-373/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-373/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-376/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-376/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-376/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-376/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-376/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-377/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-377/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-377/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-377/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-377/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Recubrimiento doble- No cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-401/25 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 1, Ø 25 mm

318-401/28 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 2, Ø 28 mm

318-401/31 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 3, Ø 31 mm

318-401/34 LINK® Componente rotuliano - 3 Tetones - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® 4, Ø 34 mm

318-402/01 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-402/02 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-402/03 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-402/04 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-402/05 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-402/16 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-402/25 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-402/26 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-403/01 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-403/02 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-403/03 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-403/04 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-403/05 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-403/16 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-403/25 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI®

SL® mediano pequeño; izquierdo

318-403/26 LINK® Componente femoral con Spherogrip- Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-412/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-412/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-412/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-412/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-412/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-412/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-412/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; derecho

318-412/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; derecho

318-413/01 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-413/02 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-413/03 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-413/04 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-413/05 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-413/16 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-smal plusl; izquierdo

318-413/25 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de

rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño; izquierdo

318-413/26 LINK® Componente femoral con soporte fijo PS - con Spherogrip- Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño plus; izquierdo

318-431/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-431/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-432/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-432/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-433/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-433/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-434/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-434/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-435/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande;

derecho

318-435/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-435/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-435/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-437/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-437/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; derecho

318-438/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-438/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; derecho

318-441/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-441/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-442/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-442/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-443/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-443/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-444/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-444/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-445/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-445/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-445/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-445/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-447/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano

pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-447/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano pequeño, mediano pequeño plus; izquierdo

318-448/12 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/14 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/16 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-448/18 LINK® Superficie rotacional articulada - Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño plus; izquierdo

318-452/01 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-452/02 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc - Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-452/03 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-452/04 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-452/05 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-453/01 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-453/02 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-453/03 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-453/04 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-453/05 LINK® Componente tibial con soporte móvil con Spherogrip - Monobloc -Cementado- Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

318-482/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; derecho

318-482/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; derecho

318-482/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; derecho

318-482/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; derecho

318-482/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; derecho

318-483/01 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-pequeño; izquierdo

318-483/02 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® pequeño; izquierdo

318-483/03 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® mediano; izquierdo

318-483/04 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® grande; izquierdo

318-483/05 LINK® Componente tibial (soporte fijo) - Spherogrip- Monobloc - Cementado-Reemplazo total de rodilla GEMINI® SL® extra-grande; izquierdo

Instrumental asociado.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Implantes: unidad estéril / Instrumentales: unidad no estéril

Método de esterilización: Radiación Gamma

Nombre del fabricante:

Waldemar Link GmbH & Co. KG

Lugar de elaboración:

Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1020-48, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-3853-20-0

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.20 11:47:53 -03:00

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.20 11:47:54 -03:00