



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T*

**DISPOSICIÓN Nº 13205**

**BUENOS AIRES, 01 DIC 2016**

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-4600-16-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1679-120, denominado: Equipamiento para Radiología Computada y Accesorios, marca CARESTREAM.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y Decreto Nº 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1º.-** Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1679-120, correspondiente al producto médico denominado: Equipamiento para Radiología Computada y Accesorios, marca CARESTREAM.

*E A*



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN Nº – 13205**

propiedad de la firma MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT Nº 8252 de fecha 07 de diciembre de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1679-120, denominado: Equipamiento para Radiografía Computada y Accesorios, marca CARESTREAM.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1679-120.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, proyecto de rótulo e instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-4600-16-0

DISPOSICIÓN Nº **13205**

mk

**Dr. ROBERTO LEDER**  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **13205** los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1679-120 y de acuerdo a lo solicitado por la firma MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Equipamiento para Radiología Computada y Accesorios.

Marca CARESTREAM.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 8252/11.

Tramitado por expediente N° 1-47-8170-11-2.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Nombre del Fabricante	1) CARESTREAM HEALTH INC 2) CARESTREAM HEALTH LTD 3) RAYCO (SHANGHAI) MEDICAL PRODUCTS COMPANY LIMITED	1) CARESTREAM HEALTH INC 2) CARESTREAM HEALTH LTD
Dirección del Fabricante	1) 150 VERONA STREET, ROCHESTER, NEW YORK 14608, ESTADOS UNIDOS 2) 1049 WEST RIDGE ROAD ROCHESTER NEW YORK, 14615 ESTADOS UNIDOS 3) Building 7, 1510 Chuanqia Road Jinqiao Export Processing Zone Pudong New Area, Shanghai 201206, P:R: China	1) 150 VERONA STREET, ROCHESTER, NEW YORK 14608, ESTADOS UNIDOS 2) 1049 WEST RIDGE ROAD ROCHESTER NUEVA YORK 14615 ESTADOS UNIDOS
Proyecto de Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 8252/11	A fojas 14

E

A



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

Proyecto de Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 8252/11.	A fojas 15 a 27
Vigencia del Certificado	07 de diciembre de 2016	07 de diciembre de 2021

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1679-120, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **01 DIC 2016**

Expediente N° 1-47-3110-4600-16-0

DISPOSICIÓN N° **-13205**

**Dr. ROBERTO LEDE**  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

PROYECTO DE ROTULO

**49205**



**01 DIC 2016**

**-CARESTREAM HEALTH INC**  
**150 VERONA STREET ROCHESTER-14608 NEW YORK ESTADOS UNIDOS**

**-CARESTREAM HEALTH INC**  
**1049 WEST RIDGE ROAD ROCHESTER NEW YORK 14615 ESTADOS UNIDOS**

**Importador:** MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A.  
**Dirección:** Avda. Hooke 3905 Tortuguitas  
Provincia de BS AS- ARGENTINA

Provincia de BS AS

**DENOMINACION GENERICA:** EQUIPAMIENTO PARA RADIOLOGIA  
COMPUTADA Y ACCESORIOS

**MODELO/S:** xxxxxxxx

**Marca:** CARESTREAM  
**SERIE:** XX XX XX  
**FECHA DE FABRICACION:** XX/XX/XX  
**VENCIMIENTO:** XXXXXX  
**VER INSTRUCCIONES DE USO.**


**VER INSTRUCCIONES DE USO .**


**Serie:** S/N XX XX XX

**Autorizado por A N M A T:** 1679-120

**Directora técnica:** LIC RAGGIO GABRIELA EDITH  
**MATRICULA N°:4051**

**CONDICION DE VENTA:" venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias "**

  
GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA

  
Raggio Gabriela Edith  
LIC. EN PRODUCCION  
DE BIOMAGENES

G



**3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;**

Nombre del fabricante:

**-CARESTREAM HEALTH INC**

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

**150 VERONA STREET ROCHESTER-14608 NEW YORK U.S.A.**

Nombre del fabricante:

**-CARESTREAM HEALTH INC**

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

**1049 WEST RIDGE ROAD ROCHESTER NEW YORK 14615 U.S.A.**

Nombre del fabricante:

**Importador: MEDICAL FLOW SOLUTIONS S.A.**

**Dirección: AVENIDA HOOKE 3905 TORTUGUITAS  
Provincia de BS AS**

**DENOMINACION GENERICA: EQUIPAMIENTO PARA RADIOLOGIA COMPUTADA Y  
ACCESORIOS**

**Modelo: SISTEMA CR MAX**

**Marca : Carestream**

**Serie: S/N XX XX XX**

**Autorizado por A N M A T: PM-1679-120**

**Director técnico: XXXXXXXXXXXX**

**" venta exclusiva a profesionales e instituciones de sanitarias "**

**GABRIEL BONICE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA**

13205



### 3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

#### Normas aplicadas

EN ISO 13485:2003	Productos sanitarios – Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos para fines reglamentarios
EN ISO 14971:2007	Productos sanitarios – Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios
EN 980:2008	Símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de productos sanitarios
EN 1041:1998	Información proporcionada por el fabricante con los productos sanitarios
EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995	Equipos electromédicos – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad
EN 60601-1-1:2001	Equipos electromédicos – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad – Sección 1: Norma colateral: Requisitos para la seguridad en sistemas electromédicos
EN 60601-1-2:2001+A1:2006	Equipos electromédicos – Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad – Norma colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y ensayos
EN 60601-1-4:1996+A1:1999	Equipos electromédicos – Parte 1-4: Requisitos generales para la seguridad – Norma colateral: Sistemas electromédicos programables
EN 60601-1-6:2004	Equipos electromédicos – Parte 1.6: Requisitos generales para la seguridad – Norma colateral – Aptitud de uso
EN 60825-1:1994+A1:1997+A2:2001	Seguridad de los productos láser – Parte 1: Clasificación del equipo, requisitos y guía de seguridad
EN 62304:2006	Software de dispositivos médicos. Procesos del ciclo de vida del software
EN 55011:2007, Group 1, Class A	Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia
EN 61000-3-2:2006	Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 2: Límites par las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada $\leq 16$ A
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005	Compatibilidad electromagnética (CEM) – Parte 3: Límites – Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para los equipos con corriente de entrada $\leq 16$ A, por fase sin estar sujetos a una conexión especial

#### Requerimientos Regulatorios

El sistema esta sujeto a la jurisdicción del F .D. A. (Administración Medicamentos y Cosméticos) y, certifica que dicho producto puede ser comercializado y legalmente exportados.

GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA



Las fábricas en las cuales los productos son fabricados están sujetas a inspecciones de la F. D. A.

El fabricante ofrece las prestaciones, funciones y especificaciones del producto mencionado, dándole al producto la seguridad y eficacia acorde a las normas europeas e internacionales

Hay tres tipos de mensajes para resaltar información o riesgos potenciales para el personal o el equipo: nota, importante y precauciones.

49205

### **Mensajes especiales**

Los siguientes mensajes especiales enfatizan la información o indican riesgos potenciales para el personal o el equipo.

NOTA: Las notas proporcionan información adicional, como explicaciones ampliadas, consejos o recordatorios.

IMPORTANTE: *Las notas importantes destacan información sobre principios críticos que afectan a cómo debe usar este manual y este producto.*

### **PRECAUCIÓN:**

**Las notas de precaución destacan procedimientos que se deben seguir de forma precisa para evitar daños personales, daños al sistema o a cualquiera de sus componentes, pérdidas de datos o daños en los archivos de las aplicaciones de software.**

### **ADVERTENCIA DE DISPOSITIVO LÁSER:**

Las notas de cuidado con el láser avisan al personal de que es posible el acceso a la radiación láser y de que todo el personal debe evitar la exposición directa al haz

En la Unión Europea, este símbolo indica que en el momento en el que el último usuario decide deshacerse de este producto, debe enviarlo a los centros adecuados para su recuperación y reciclado.

Póngase en contacto con su representante local autorizado para obtener más información.

### **Convenciones sobre tipos de letra**

El tipo de letra en negrita representa botones o selecciones que se realizan en la interfaz e identifica nombres de pantallas, notas de precaución y advertencias.

### **PRECAUCIÓN:**

**Las leyes federales de los EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a facultativos, por su parte o por orden de éstos.**

IMPORTANTE: *Únicamente el personal de servicio de Carestream Health autorizado puede abrir los paneles laterales y posterior.*

GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA





CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1S1-94 (R1999) Suplemento N.º 1-94 a  
CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1-M90  
CAN/CSA-C22.2 N.º 601.1B-90 (R2002) - Enmienda 2 a CAN/CSA-C22.2  
N.º 601.1-M90

13205



### **Unión Europea**

IEC 60601-1:1990 + Enmienda 1:1993 + Enmienda 2:1995 + Enmienda 13:1996 - Equipos eléctricos médicos  
EN 60825-1:1994 + Enmienda 1:1997 + Enmienda 2:2001 - Seguridad de productos con láser

### **Internacional**

IEC 60601-1:1988 + Enmienda 1:1991 + Enmienda 1:1995 - Equipos eléctricos médicos  
IEC 60825-1:1993 + Enmienda 1:1997 + Enmienda 2:2001 - Seguridad de productos con láser

**EMC** Este equipo ha superado las pruebas que lo incluyen dentro de los límites de un dispositivo digital de la Clase A de conformidad con la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar totalmente que no se produzcan interferencias perjudiciales en una instalación particular, en cuyo caso el usuario deberá corregir esta situación por cuenta propia.

### **PRECAUCIÓN:**

**Se trata de un producto de clase A. Puede causar interferencias de radiofrecuencia en el hogar y, en tal caso, puede que el usuario tenga la obligación de tomar medidas de corrección apropiadas.**

### **Emisiones electromagnéticas / Inmunidad**

1. Precauciones sobre compatibilidad electromagnética  
Los equipos eléctricos médicos requieren una precaución especial con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC). Los equipos médicos se deben instalar y poner en funcionamiento según la información de EMC proporcionada.
2. Equipo de comunicaciones  
Los equipos de comunicación portátiles por radiofrecuencia (RF) pueden afectar al rendimiento de la compatibilidad electromagnética de equipos eléctricos médicos.
3. Sustitución de cables, accesorios o transductores

Σ

GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA



El uso de cables, accesorios o transductores que no se especifican a continuación, excepto los transductores o cables vendidos por los fabricantes del equipo como partes sustitutivas de componentes internos, pueden provocar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad de los equipos médicos.

13205

#### 4. Otros equipos

Los sistemas CR no se deben utilizar en la proximidad o encima de otros equipos.

5. Información sobre los cables para los sistemas CR CLASSIC de *Kodak DirectView*:

#### **Cable Longitud(CM)**

##### **Función Protegido**

- 1 180 Alimentación AC a sistema CR N
- 2 160 Alimentación CA a equipo N
- 3 180 Alimentación de CA a adaptador de CA de la pantalla N
- 4 205 Alimentación CC a pantalla N
- 5 210 Cable de teclado a equipo Y
- 6 180 Cable USB de equipo a pantalla Y
- 7 175 Cable de ratón a equipo Y
- 8 175 Cable de altavoz a equipo Y
- 9 190 Cable de vídeo a pantalla Y
- 10 215 Cable Ethernet N

6. Localizaciones protegidas para sistemas CR: No aplicable.

#### **Emisiones electromagnéticas para grupo 1, equipo de clase A**

Los sistemas CR están diseñados para que se utilicen en el entorno electromagnético que se especifica a continuación. El cliente o el usuario de los sistemas CR deberán asegurarse de que los utilizan en dicho entorno.

#### **Prueba de emisiones**

##### **Cumplimiento Entorno electromagnético: orientación**

Emisiones de RF

CISPR 11

Grupo 1 Los sistemas CR utilizan energía RF sólo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, las emisiones de RF son muy bajas y no es probable que provoquen interferencias en equipos electrónicos próximos.

Emisiones de RF

CISPR 11

GENERALA FORCHÉ  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA



Clase A Los sistemas CR son adecuados para todo tipo de establecimiento, además de los hogares, y para aquellos que están conectados directamente a la red pública de fuentes de baja tensión que suministra electricidad de uso doméstico. Emisiones de armónicos

IEC 61000-3-2

Clase A Los sistemas CR son adecuados para todo tipo de establecimiento, incluidos los hogares, y para aquellos que están conectados directamente a la red pública de fuentes de baja tensión que suministra electricidad de uso doméstico. Tensión Fluctuaciones/ Emisiones de la fluctuación de la tensión

IEC 61000-3-3

Cumplimiento Los sistemas CR son adecuados para todo tipo de establecimiento, incluidos los hogares, y para aquellos que están conectados directamente a la red pública de fuentes de baja tensión que suministra electricidad de uso doméstico.

### **Panel de operaciones remotas**

#### **Seguridad EE. UU.**

UL 60950-1 Equipos de tecnología de la información - Seguridad Sección 1:

Requisitos generales

#### **Canadá**

CAN/CSA - C22.2 N.º 60950-1-03 sobre equipos de tecnología de la información - Seguridad Sección 1: Requisitos generales

#### **Unión Europea**

EN 60950-1:2001 sobre equipos de tecnología de la información -

Seguridad Sección 1: Requisitos generales

EN 60825-1:2001 (o EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001) sobre seguridad de productos con láser, Sección 1: Clasificación del equipo, requisitos y guía del usuario

#### **Internacional**


IEC 60950-1:2001 sobre equipos de tecnología de la información

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001 sobre seguridad de productos con láser (incluye todos los indicadores LED)

#### **EMC**

Este equipo ha superado las pruebas que lo incluyen dentro de los límites de un dispositivo digital de la clase A de conformidad con la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar totalmente que no ocurran interferencias dañinas en una instalación particular, en cuyo caso el usuario deberá corregir esta situación por cuenta propia.

**EE. UU.**

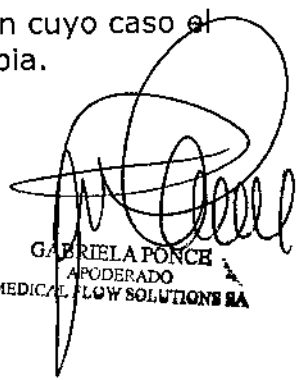  
GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA

FCC, parte 15, subclase B, clase A

**Canadá**

ICES - 003 apartado 4, clase A

**Internacional**

EN 55022:98+A1:2000+A2:2003 Clase A

Normativa sobre inmunidad: EN 55024:98+A1:2001+A2:2003

EN 61000-3-2:2000 + A1:00 + A2:05 (Armónicos)

EN 61000-3-3:1995 + A1:01 (Normativa sobre la fluctuación de la tensión)

VCCI, V-3/2006.04, clase A (Japón)

**PRECAUCIÓN:**

**Se trata de un producto de clase A. Puede causar interferencias de radiofrecuencia en el hogar y, en tal caso, puede que el usuario tenga la obligación de tomar medidas de corrección apropiadas.**

**Clasificación de equipos médicos:**

**Equipos mecánicos**

Este equipo no se puede clasificar en cuanto a seguridad eléctrica, porque no usa ni genera energía eléctrica.

**Dispone de protección ordinaria frente a una entrada dañina de agua (IPX0).**

**Adecuado para un funcionamiento continuado.**

**No es adecuado para un uso cerca de mezclas de anestésicos inflamables con aire, con oxígeno o con monóxido de nitrógeno.**

**Eliminación de los**

**EMC**


Este equipo ha superado las pruebas que lo incluyen dentro de los límites de un dispositivo digital de la clase A de conformidad con la sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se puede garantizar totalmente que no ocurran interferencias dañinas en una instalación particular, en cuyo caso, el usuario deberá corregir esta situación por cuenta propia.

**3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus**

13205

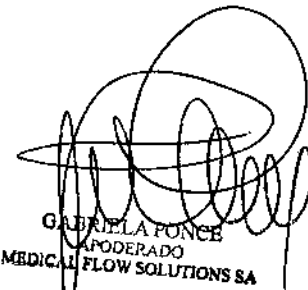

  
GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA

características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

No Aplica.

**3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;**

La notificación de mantenimiento preventivo es una opción que, una vez seleccionada, hace que cada 180 días aparezca un mensaje en el que se recuerda al usuario la conveniencia de llamar al servicio técnico para realizar las labores de mantenimiento. Para eliminar las notificaciones repetidas, seleccione la casilla de verificación Do Not Remind Me Again (No volver a mostrar este mensaje)

Limpie las superficies exteriores del sistema CR sólo con agua y un trapo suave que no suelte pelusa. Humedezca el trapo y páselo suavemente por las superficies exteriores.

**PRECAUCIÓN:**

Los rodillos de transporte, correas, rodillos y cualquier componente de uretano del sistema CR no se deben limpiar con alcohol o con soluciones con base de alcohol.

**Monitores**

**Limpieza del monitor** Limpie la pantalla regularmente para garantizar que funciona sin problemas.


**PRECAUCIÓN:**

Para evitar daños al limpiar la pantalla táctil, no utilice limpiadores líquidos o disolventes fuertes, como, por ejemplo, bencina. Tampoco pulverice detergentes en forma de aerosol directamente sobre la pantalla.

1. Apague la pantalla táctil.
2. Moje un trapo con un detergente para vidrios y limpie cuidadosamente la pantalla.
3. Para limpiar la carcasa de la pantalla, utilice un trapo suave humedecido con agua

**del panel de la interfaz de usuario local**

Limpie el panel de la interfaz de usuario local regularmente para garantizar que funciona correctamente:

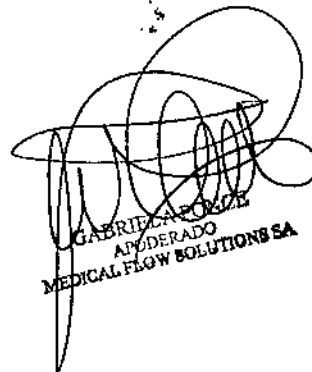

GABRIEL CAROZZE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA

13205



**PRECAUCIÓN:**

Para evitar daños al limpiar el panel de cristal líquido, no utilice limpiadores líquidos o abrasivos ni disolventes fuertes como, por ejemplo, bencina. Tampoco pulverice limpiadores en forma de aerosol directamente sobre el panel LCD.

1. Apague la pantalla.
2. Pulverice un limpiacristales sobre un trapo suave y páselo con suavidad por la superficie de la pantalla.
3. Use un trapo suave humedecido con agua para limpiar la carcasa de la pantalla.

**3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;**

**Uso dentro del entrono del paciente**

No Aplica.

**3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;**

No Aplica.

**3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;**


No Aplica.

**3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.**

No Aplica.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No Aplica.



GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA

13205



**3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);**

No aplica

**3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;**

No aplica

**3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;**  
**Cambios de funcionamiento:**

Instrucciones:

Si el producto no funciona correctamente o no responde a los controles de mando que se describe en el manual: deje de utilizar el equipo y evite realizar cambios en el. Póngase en contacto de inmediato con el servicio técnico informe el problema y espere instrucciones.

En caso de observar una avería en la unidad, debe apagarla y colocar un aviso que indique "No funciona" y llamar de inmediato al servicio técnico autorizado.

Las operaciones de revisión y mantenimiento solo pueden ser realizadas por el servicio técnico autorizado.

Si el producto no funciona correctamente, consulte a la guía del usuario, esta guía lo Ayudara a utilizar, mantener y resolver problemas, si no obtiene respuesta póngase en Contacto con el servicio técnico

**3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;**

#### **PRECAUCIÓN:**

**Se trata de un producto de clase A. Puede causar interferencias de radiofrecuencia en el hogar y, en tal caso, puede que el usuario tenga la obligación de tomar medidas de corrección apropiadas.**

#### **Emisiones electromagnéticas /Inmunidad**

##### **1. Precauciones sobre compatibilidad electromagnética**

Los equipos eléctricos médicos requieren una precaución especial con respecto a la compatibilidad electromagnética (EMC). Los

GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA



equipos médicos se deben instalar y poner en funcionamiento de acuerdo a la información de EMC proporcionada.

## 2. Equipo de comunicaciones

Los equipos de comunicación portátiles por radiofrecuencia (RF) pueden afectar al rendimiento de la compatibilidad electromagnética de equipos eléctricos médicos.

## 3. Sustitución de cables, accesorios o transductores

El uso de cables, accesorios o transductores que no se especifican a continuación, excepto los transductores o cables vendidos por los fabricantes del equipo como partes sustitutivas de componentes internos, pueden provocar un aumento de las emisiones o una disminución de la inmunidad de los equipos médicos.

### **3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;**

No Aplica

### **3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;**

Cuando el usuario final deba deshacerse de este producto está obligado a enviarlo a las instalaciones pertinentes para la apropiada recuperación y reciclado de sus componentes para mayor información póngase en contacto con el representante

#### **Reciclaje:**

Maquinas o accesorios al término de su vida útil:

La eliminación de maquinas y accesorios debe estar de acuerdo con las regulaciones nacionales para el procesamiento de desperdicios.

Todos los materiales y componentes que pongan en riesgo el medio ambiente deben ser removidos al término de la vida útil de las maquinas y accesorios (ejemplos: baterías celulares secas o mojadas, aceite transformador, etc.).


Por favor consulte a su representante antes de desechar estos productos.

### **3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;**

No Aplica

### **3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.**

-No Aplica

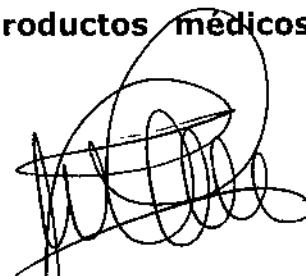  
GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA



## Especificaciones del sistema

### Max CR

#### Dimensiones

- Altura: 132,1 cm  
(104,1 cm en la estación del cassette)
- Ancho: 104,1 cm
- Profundidad: 76,2 cm
- Peso: 433,6 kg
- Monitor: pantalla táctil plana de 17", a todo color, matriz de 1.280 x 1.024

#### Rendimiento

- Capacidad para 8 cassettes expuestos y 8 cassettes borrados a la vez.
- Rendimiento hasta 101 cassettes por hora
- Tiempo desde la inserción del cassette hasta que la imagen llega a la red: 34 segundos o menos\*

\* Para cassettes de 35 x 43 cm. Los tiempos para otros tamaños de cassettes para radiografías son similares o inferiores. El tiempo para ver una imagen en un dispositivo de la red depende del rendimiento de esta última.

\*\* Para aplicaciones dentales

\*\*\* Para imágenes de mamografía

#### Resolución de escala de grises

- 4.096 (escala de grises de 12 bits)

#### Electricidad

Incluye una fuente de alimentación

ininterrumpida (UPS) integrada

100-120 V/CA 10 Amps 50/60 Hz

200-240 V/CA 5 Amps 50/60 Hz

#### Disipación del calor

1400 BTU/hora máx.

#### Red

Adaptador de red 10 BASE-T, 100 BASE-T

#### Regulación

- FDA, UL, cUL y marca CE
- El sistema está certificado como dispositivo médico de contacto esporádico con pacientes.

GABRIELA PONCE  
APODERADO  
MEDICAL FLOW SOLUTIONS SA