



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. T.*

DISPOSICIÓN N° 0908

BUENOS AIRES, 13 FEB 2012

VISTO el Expediente N° 1-47-6308-11-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones DENTALMAX S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

§. Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº **0908**

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca BIOMET 3i, nombre descriptivo COMPONENTES PROTÉSICOS PARA IMPLANTES DENTALES y nombre técnico PRÓTESIS, DENTALES, IMPLANTABLES, de acuerdo a lo solicitado por DENTALMAX S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 551 a 611 y 488 a 550 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-707-20, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 0908

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-6308-11-8  
DISPOSICIÓN N°

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**

0908



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.P.I.C.*

## ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ....0908.....

Nombre descriptivo: COMPONENTES PROTÉSICOS PARA IMPLANTES DENTALES.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-744 - PRÓTESIS, DENTALES, IMPLANTABLES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): BIOMET 3i.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Para utilizarse sobre los implantes dentales endoóseos con el fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados, para utilizarse como soportes de prótesis de uno o varios dientes, en el maxilar inferior o en el maxilar superior, Las prótesis pueden atornillarse o cementarse al pilar.

Modelo/s: Fabricante: Changzhou Biomet Medical Devices Co. Ltd - CHINA

CLA20      análogo de laboratorio para pilar cónico 4,1 y 5 mm (d)  
CS375      tornillo de cierre – implante 4,1mm(d)  
CS500      tornillo de cierre – implante 5mm(d)  
CS600      tornillo de cierre – implante 6mm(d)  
IIC12      cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC41      cofia pick-up para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC44      cofia twist lock para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC45      cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC60      cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)  
IILA20      análogo de laboratorio de implante certain 4,1mm(d)  
IILAW5      análogo de laboratorio de implante certain 5,0mm(d)  
IILAW6      análogo de laboratorio de implante certain 6,0mm(d)  
ILA20      análogo de laboratorio de implante 4,1mm(d)  
ILAW5      análogo de laboratorio de implante 5,0mm(d)



..//

ILAW6	análogo de laboratorio de implante 6,0mm(d)
IMMILA	análogo de laboratorio certain microminimplant 3,4mm(d)
IOLLAS	análogo de laboratorio iol
IWITSC	tornillo para cofia twist lock ep para implante certain (todos)
IWSU30	pin guía/tornillo de encerado certain
LTX310	implante ltx 3,75 x 10mm
LTX311	implante ltx 3,75 x 11mm
LTX313	implante ltx 3,75 x 13mm
LTX315	implante ltx 3,75 x 15,0mm
LTX3210	implante ltx 3,25 x 10mm
LTX3211	implante ltx 3,25 x 11,5mm
LTX3213	implante ltx 3,25 x 13,0mm
LTX3215	implante ltx 3,25 x 15,0mm
LTX3285	implante ltx 3,25 x 8,5mm
LTX385	implante ltx 3,75 x 8,5mm
LTX410	implante ltx 4,0 x 10,0mm
LTX411	implante ltx 4,0 x 11,5mm
LTX413	implante ltx 4,0 x 13,0mm
LTX415	implante ltx 4,0 x 15,0mm
LTX485	implante ltx 4,0 x 8,5mm
LTX510	implante ltx 5,0 x 10,0mm
LTX511	implante ltx 5,0 x 11,5mm
LTX513	implante ltx 5,0 x 13,0mm
LTX515	implante ltx 5,0 x 15,0mm
LTX585	implante ltx 5,0 x 8,5mm
LTX610	implante ltx 6,0 x 10,0mm
LTX611	implante ltx 6,0 x 11,5mm
LTX613	implante ltx 6,0 x 13,0mm
LTX615	implante ltx 6,0 x 15,0mm
LTX685	implante ltx 6,0 x 8,5mm

5,



..//

MMCLA	análogo de laboratorio cónico micromini 3,4mm(d)
MMCS1	tornillo de cierre microminimplant
MMILA	análogo de laboratorio para implante micromini 3,4mm(d)
NTOST3	osteótomo recto osseotite nt 3,25mm
NTOST3A	osteótomo angulado osseotite nt 3,25mm
NTOST4	osteótomo recto osseotite nt 4,0mm
NTOST4A	osteótomo angulado osseotite nt 4,0mm
NTOST5	osteótomo recto osseotite nt 5,0mm
NTOST5A	osteótomo angulado osseotite nt 5,0mm
NTOST6	osteótomo recto osseotite nt 6,0mm
NTOST6A	osteótomo angulado osseotite nt 6,0mm
OST01	osteótomo summers nro.1
OST02	osteótomo summers nro.2
OST03	osteótomo summers nro.3
OST04	osteótomo summers nro.4
OST05	osteótomo summers nro.5
OSTFS	osteótomo summers para emplazamiento futuro
PHD00N	destornillador hexagonal posterior estrecho-17mm
PHD01N	destornillador hexagonal estándar estrecho -24mm
PHD02N	destornillador hexagonal grande posterior estrecho -17mm
PHD03N	destornillador hexagonal grande estándar estrecho - 24mm
PSQD0N	destornillador cuadrado posterior estrecho - 17mm
PSQD1N	destornillador cuadrado estándar estrecho - 24mm
SLA20	análogo de laboratorio de pilar estándar (inoxidable)
WSK30	tornillo de encerado/pin guía 20mm (texturizado)
WSU30	uni-screw de prueba y de laboratorio texturizado
WT2668	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
WT2673	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)



..//

WT2674	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
WT2676	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
WT2678	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
WTH66	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6mm (p) x 6mm(a)
WTH672	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)
WTH673	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)
WTH674	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
WTH676	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
WTH678	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
WTH68	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6mm (p) x 8mm(a)
CNRIC	cofia pick-up ep conica (hexanogal) 4.1 y 5mm (d) x 5mm(p)
CS275	tornillo de cierre, sin cabeza
CSQ06	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)
CSQ17	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)
DRLAU	análogo de laboratorio universal dal-ro
IOLPIC	cofia de impresión pick-up iol
MIC33	cofia de impresión pick-up 3,4mm(d)
MUNITS	tornillo de prueba cuadrado 3,4mm(d)
ORLAU	análogo de pilar o-ring universal
OSO20S	tornillo para pilar o-ring 4,1mm(d) x 2mm(a)
OSODH	capuchón o-ring
PAA484	análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 4,0mm
PAA485	análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 5,5mm
PAA654	análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 4,0mm
SQIC7	cofia pick-up para pilar estándar
UNIST	tornillo uniscrew cuadrado de titanio
WITSC	tornillo de cofia twist lock ep para implante (todos)



..//

WSK10	tornillo de encerado/pin guía texturizado 10mm
WSK15	tornillo de encerado/pin guía texturizado 15mm
Fabricante: LX Precision (Shanghai) Co. Ltd. CHINA	
CS275	tornillo de cierre, sin cabeza
CS375	tornillo de cierre - implante 4,1mm(d)
CS500	tornillo de cierre - implante 5mm(d)
CS600	tornillo de cierre - implante 6mm(d)
IMCSF34	tornillo de cierre plano de 3,4mm (d) para implantes certain
IMMCS1	tornillo de cierre certain 3,4mm(d)
MMCS1	tornillo de cierre para implante 3,4mm(d)
GS200	tornillo oro c/ranura -2mm
GS300	tornillo oro c/ranura -3mm
GSH20	tornillo de retención hexagonal gold-tite 2mm
GSH30	tornillo de retención hexagonal gold-tite 3mm
GSH70	tornillo de retención hexagonal gold-tite 7mm
ILRGHG	tornillo gold -tite certain hexagonal de diámetro ancho
ILRGHT	tornillo de titanio certain hexagonal de diámetro ancho
IUNIHG	tornillo hexagonal gold-tite certain
IUNIHT	tornillo hexagonal certain de titanio
LGS30	tornillo de retención con ranura oro largo
TSH30	tornillo de titanio hexagonal de 3mm
UNIHG	tornillo uniscrew hexagonal gold-tite
UNIHT	tornillo uniscrew hexagonal de titanio
UNISG	tornillo uniscrew cuadrado gold-tite
UNIST	tornillo uniscrew cuadrado de titanio
EHA343	pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 3,0mm (a)
EHA344	pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 4mm (a)

5  
1







..//

- EHA346 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 6mm (a)
- EHA348 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 8mm (a)
- EHA353 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA354 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA356 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA358 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA443 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA444 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA446 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA448 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA453 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA454 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA456 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA458 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA463 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)

5,



..//

- EHA464 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA466 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA468 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA473 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA474 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA476 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA478 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5mm (d) x 5,5mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)



..//

- EHA573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA343 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA344 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA346 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 6,0mm (a)

5  
-



..//

- IEHA348 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 3,8mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA353 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA354 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA356 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA358 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA443 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA444 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA446 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA448 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 8,0mm (a)
- 51 IEHA453 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA454 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA456 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA458 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA463 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA464 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)



..//

IEHA466 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA468 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA473 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA474 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA476 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA478 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)



..//

IEHA574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm  
(d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

5

IEHA676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm  
(d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

IMHA32 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 2mm (a)

IMHA33 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 3mm (a)

IMHA34 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 4mm (a)

IMHA36 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 6mm (a)

ISHA42 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x  
2mm(a)

ISHA43 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x  
3mm(a)



..11

ISHA44	pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x 4mm(a)
ISHA46	pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x 6mm(a)
ISHA48	pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x 8mm(a)
ISMHA32	pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p)x 2mm(a)
ISMHA33	pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p)x 3mm(a)
ISMHA34	pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p) x 4mm(a)
ISMHA36	pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p) x 6mm(a)
ISWHA52	pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 2mm(a)
ISWHA53	pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 3mm(a)
ISWHA54	pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 4mm(a)
ISWHA56	pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 6mm(a)
ISWHA58	pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 8mm(a)
ISWHA62	pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 2mm(a)
ISWHA63	pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 3mm(a)
ISWHA64	pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 4mm(a)
ISWHA66	pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 62mm(a)
ISWHA68	pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 8mm(a)
ITHA52	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 2mm(a)
ITHA53	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 3mm(a)
ITHA54	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 4mm(a)
ITHA56	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 6mm(a)
ITHA58	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 8mm(a)
ITHA63	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 3mm(a)



..//

ITHA64	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 4mm(a)
ITHA66	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 6mm(a)
ITHA68	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 8mm(a)
ITHA73	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 3mm(a)
ITHA74	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 4mm(a)
ITHA76	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 6mm(a)
ITHA78	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 8mm(a)
IWTH52	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x2mm(a)
IWTH53	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x3mm(a)
IWTH54	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x4mm(a)
IWTH56	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x6mm(a)
IWTH562	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x2mm(a)
IWTH563	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x3mm(a)
IWTH564	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x4mm(a)
IWTH566	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 6mm (p) x 6mm (a)
IWTH568	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 6mm (p) x 8mm (a)
IWTH572	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 2mm (a)
IWTH573	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 3mm (a)
IWTH574	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 4mm (a)
IWTH576	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 6mm (a)
IWTH578	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 8mm (a)
IWTH58	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 5,6mm (p) x 8mm (a)
IWTH62	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 2mm (a)
IWTH63	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 3mm (a)
IWTH64	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 4mm (a)
IWTH66	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 6mm (a)
IWTH672	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 2mm (a)
IWTH673	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 3mm (a)
IWTH674	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 4mm (a)
IWTH676	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 6mm (a)

5.





..//

IWTH678	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 8mm (a)
IWTH68	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 8mm (a)
MHA32	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)
MHA33	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 3mm(a)
MHA34	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)
MHA36	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)
MHC33	capuchón cónico de cicatrización micromini 3,4mm(d)
MT233	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 3mm(a)
MT236	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)
MT253	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x 3mm(a)
MT254	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
MT256	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
TH253	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x3mm(a)
TH253S	tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x3mm
TH254	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x4mm(a)
TH254S	tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x4mm
TH256	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x6mm(a)
TH256S	tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x6mm
TH258	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x8mm(a)
TH258S	tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x8mm
TH263	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x3mm(a)
TH264	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x4mm(a)
TH266	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x6mm(a)
TH268	pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x8mm(a)



..//

- TH273 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x3mm  
(a)
- TH274 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x4mm  
(a)
- TH276 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x6mm  
(a)
- TH278 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x8mm  
(a)
- THA42 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 2mm(a)
- THA43 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 3mm(a)
- THA44 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 4mm(a)
- THA46 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 6mm(a)
- THA48 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 8mm(a)
- THA52 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)
- THA53 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 3mm(a)
- THA54 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- THA56 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- THA58 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 8mm(a)
- THA63 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)
- THA64 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
- THA66 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
- THA68 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
- THA73 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)
- THA74 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)
- THA76 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 6mm(a)
- THA78 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 8mm(a)
- THRC4 cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(d) x 4mm  
(a)
- THRC6 cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(d) x 6mm  
(a)



..//

- WT2553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x 3mm(a)
- WT2554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x 4mm(a)
- WT2556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x 6mm(a)
- WT2558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x 8mm(a)
- WT2563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)
- WT2564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
- WT2566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
- WT2568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
- WT2573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)
- WT2574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)
- WT2576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 6mm(a)
- WT2578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 8mm(a)
- WT2663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 3mm(a)
- WT2664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 4mm(a)
- WT2666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 6mm(a)
- WT2668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 8mm(a)
- WT2673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)

5,



..//

- WT2674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
- WT2676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
- WT2678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
- WTH52 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 2mm(a)
- WTH53 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 3mm(a)
- WTH54 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 4mm(a)
- WTH56 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 6mm(a)
- WTH562 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)
- WTH563 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)
- WTH564 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
- WTH566 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
- WTH568 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
- WTH572 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 2mm(a)
- WTH573 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)
- WTH574 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
- WTH576 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
- WTH578 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
- WTH58 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm (p) x 8mm(a)
- WTH62 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm(p) x 2mm(a)
- WTH63 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 3mm(a)
- WTH64 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 4mm(a)
- WTH66 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 6mm(a)
- WTH672 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)
- WTH673 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)
- WTH674 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
- WTH676 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
- WTH678 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)

σ



..//

WTH68	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 8mm(a)
IIOL20S	pilar iol certain 2mm
IIOL30S	pilar iol certain 3mm
IIOL40S	pilar iol certain 4mm
IIOL55S	pilar iol certain 5,5mm
IIOL70S	pilar iol certain 7mm
IOL20T	pilar con tornillo 2mm iol 2 piezas
IOL30T	pilar con tornillo 3mm iol 2 piezas todos aconsejan no usar
IOL40T	pilar con tornillo 4mm iol 2 piezas
IOL55T	pilar con tornillo 5,5mm iol 2 piezas
IOL70T	pilar con tornillo 7mm iol 2 piezas
IOLDE	extensión distal iol
IOLGC	cilindro oro iol
IOLHC	capuchón de cicatrización iol
IOLTC	cilindro provisorio iol
GUCA1C	cilindro pilar oro-hexagonal ucla 4,1mm (d)
GUCA2C	cilindro pilar oro no hexagonal ucla 4,1mm (d)
GUCA3	pilar miniplant ucla oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)
GUCA3S	tornillo para pilar miniplant ucla oro (hexagonal interno)
IGUCA1C	cilindro pilar hexagonal oro certain ucla 4,1mm (d)
IGUCA2C	cilindro pilar no hexagonal oro certain ucla 4,1mm (d) con tornillo diámetro ancho
IGUCA2T	cilindro oro-no hexagonal ucla certain 4,1mm con tornillo de diámetro ancho de titanio
IITCS41	cilindro provisorio hexagonal certain 4,1mm (d)
IITCS42	cilindro provisorio no hexagonal certain 4,1mm (d) con tornillo de diámetro ancho
IMMTCS1	cilindro provisorio hexagonal certain 3,4mm (d) con tornillo hexagonal



..//

- IMMTCS2 cilindro provisorio de titanio micromini, unidad múltiple certain
- IMUCC2C pilar ucla certain calcinable no hexagonal 3,4mm(d)
- IMUCC2T pilar ucla certain calcinable no hexagonal 3,4mm(d)
- IMUCG1C pilar ucla certain oro hexagonal 3,4mm(d)
- IMUCG2C pilar ucla certain oro no hexagonal 3,4mm(d)
- IMUCG2T pilar ucla certain oro no hexagonal 3,4mm(d)
- IMUCT1 cilindro de titanio ucla micromini, unidad simple certain
- IMUCT2 cilindro de titanio ucla micromini, unidad múltiple certain
- ITCH0 cilindro hexagonal provisorio para implante c/ tornillo hexagonal 4,1mm (d)
- ITCH1 cilindro no hexagonal provisorio para implante. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(d)
- ITCS41 cilindro hexagonal provisorio 4,1mm (d)
- ITCS42 cilindro no hexagonal provisorio 4,1mm (d) con retención
- ITUCA1 cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad simple certain
- ITUCA2 cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad múltiple certain
- ITUCA2C pilar de titanio-no hexagonal ucla certain 4,1mm (d) con tornillo de diámetro ancho
- IUNAB2C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 4,1mm (d) c/tornillo de diámetro ancho gold-tite
- IUNAB2T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 4,1mm (d) c/tornillo de titanio de diámetro ancho
- IWGA51C cilindro pilar hexagonal oro ucla certain 5mm (d)
- IWGA52C cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 5mm (d) con tornillo de diámetro ancho
- IWGA52T cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 5mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
- IWGA61C cilindro pilar hexagonal oro ucla certain 6mm (d)
- IWGA62C cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho

51

-



..//

- IWGA62T cilindro no hexagonal oro ucla certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho de titanio
- IWPC52C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 5mm (d) c/tornillo gold-tite de diámetro ancho
- IWPC52T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 5mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
- IWPC62C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 6mm (d) c/tornillo gold-tite de diámetro ancho
- IWPC62T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 6mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
- IWTA51 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad simple certain
- IWTA52 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad múltiple certain
- IWTCS51 cilindro provisorio hexagonal certain 5mm (d)
- IWTCS52 cilindro provisorio no hexagonal certain 5mm (d) con tornillo de diámetro ancho
- IWTCS61 cilindro provisorio hexagonal certain 6mm (d)
- IWTCS62 cilindro provisorio no hexagonal certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho
- MCAT2 cilindro de titanio cónico micromini, unidad múltiple
- MMTC1 cilindro provisorio 3,4mm (d) con tornillo hexagonal
- MMTCS1 cilindro hexagonal provisorio 3,4mm(d) con retención
- MMTCS2 cilindro de titanio provisorio micromini, hexagonal externo unidad múltiple
- MUCC1C pilar calcinable hexagonal ucla 3,4mm(d)
- MUCC2C pilar calcinable no hexagonal ucla 3,4mm(d)
- MUCG1C pilar hexagonal oro ucla 3,4mm (d)
- MUCG2C pilar no hexagonal oro ucla 3,4mm(d)
- MUCT1 cilindro de titanio ucla micromini, unidad simple hexagonal externa



..//

MUCT2	cilindro de titanio ucla micromini, unidad múltiple hexagonal externa
SGUCA1C	cilindro pilar hexagonal zr ucla oro estándar 4,1mm (d)
SWGA51C	cilindro pilar hexagonal zr estándar oro ucla 5mm(d)
SWGA61C	cilindro pilar hexagonal zr estándar oro ucla 6mm(d)
TUCA1	cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad simple hexagonal externa
TUCA2C	cilindro pilar no hexagonal de titanio ucla 4,1mm(d)
UNA125	cilindro ucla calcinable hexagonal paq. de 25
UNA225	cilindro ucla calcinable no hexagonal paq. de 25
UNAB1C	cilindro ucla calcinable (hexagonal)
UNAB2C	cilindro ucla calcinable (no hexagonal)
WGA51C	cilindro pilar ucla oro hexagonal 5mm (d)
WGA52C	cilindro pilar ucla oro no hexagonal 5mm (d)
WGA61C	cilindro pilar ucla oro hexagonal 6mm (d)
WGA62C	cilindro pilar ucla oro no hexagonal 6mm (d)
WPC51C	pilar ucla calcinable hexagonal 5mm(d)
WPC52C	pilar ucla calcinable no hexagonal 5mm(d)
WPC61C	pilar ucla calcinable hexagonal 6mm(d)
WPC62C	pilar ucla calcinable no hexagonal 6mm(d)
WTA51	cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad simple hexagonal externa
WTA52	cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad múltiple hexagonal externa
WTC51	cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(d)
WTC52	cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(d).
WTC61	cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(d)
WTC62	cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(d).
WTCS51	cilindro provisorio hexagonal 5mm(d) con retención





..//

- WTCS52 cilindro provisorio no hexagonal 5mm(d) con retención
- WTCS61 cilindro provisorio hexagonal 6mm(d) con retención
- WTCS62 cilindro provisorio no hexagonal 6mm(d) con retención
- IMPAPF34 poste preangulado 15° certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)
- IMPAPF36 poste preangulado 15° certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)
- IMPFP34 poste certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)
- IMPFP36 poste certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)
- IMPFTC32 cilindro provisorio certain performance 3,4mm (no hexagonal)
- IMPFTC34 cilindro provisorio certain performance 3,4mm (hexagonal)
- IPAPF454 poste preangulado 15° certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- IPAPF456 poste preangulado 15° certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- IPAPF554 poste preangulado 15° certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- U) IPAPF556 poste preangulado 15° certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- IPAPF664 poste preangulado 15° certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
- IPAPF666 poste preangulado 15° certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
- IPFP454 poste certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- IPFP456 poste certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- IPFTC41 cilindro provisorio certain performance 4,1mm (hexagonal)
- IPFTC42 cilindro provisorio certain performance 4,1mm (no hexagonal)
- IWFPF554 poste certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- IWFPF556 poste certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- IWFPF664 poste certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)



..//

IWFPF666	poste certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
IWPFTC51	cilindro provisorio certain performance 5mm (hexagonal)
IWPFTC52	cilindro provisorio certain performance 5mm (no hexagonal)
IWPFTC61	cilindro provisorio certain performance 6mm (hexagonal)
IWPFTC62	cilindro provisorio certain performance 6mm (no hexagonal)
MPAPF34	poste performance preangulado 15° 3,4mm (d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)
MPAPF36	poste performance preangulado 15° 3,4mm (d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)
MPFP34	poste performance de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 4mm (a)
MPFP36	poste performance de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 6mm (a)
MPFTC32	cilindro provisorio performance de 3,4mm (no hexagonal)
MPFTC34	cilindro provisorio performance de 3,4mm (hexagonal)
PAPF454	poste performance preangulado 15° 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm (a)
PAPF456	poste performance preangulado 15° 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm (a)
PAPF554	poste performance preangulado 15° 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm (a)
PAPF556	poste performance preangulado 15° 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm (a)
PAPF664	poste performance preangulado 15° 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm (a)
PAPF666	poste performance preangulado 15° 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm (a)
PFP454	poste performance de 4,1mm (d) x 5mm (p) x 4mm (a)
PFP456	poste performance de 4,1mm (d) x 5mm (p) x 6mm (a)
PFTC41	cilindro provisorio performance (hexagonal) de 4,1mm
PFTC42	cilindro provisorio performance (no hexagonal) de 4,1mm
WFPF554	poste performance de 5mm (d) x 5mm (p) x 4mm (a)



..//

WPFP556	poste preformance de 5mm (d) x 5mm (p) x 6mm (a)
WPFP664	poste preformance de 6mm (d) x 6mm (p) x 4mm (a)
WPFP666	poste preformance de 6mm (d) x 6mm (p) x 6mm (a)
WPFTC51	cilindro provisorio preformance 5mm (hexagonal)
WPFTC52	cilindro provisorio preformance 5mm (no hexagonal)
WPFTC61	cilindro provisorio preformance 6mm (hexagonal)
WPFTC62	cilindro provisorio preformance 6mm (no hexagonal)
AC4217	pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(d) x 2mm(a)
AC4225	pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(d) x 2mm(a)
AC4417	pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(d) x 4mm(a)
AC4425	pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(d) x 4mm(a)
CA001	pilar cónico 4,1mm (d)x 1mm (a)
CA001S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 1mm (a)
CA002	pilar cónico 4,1mm (d)x 2mm (a)
CA002S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 2mm (a)
CA003	pilar cónico 4,1mm (d)x 3mm (a)
CA003S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 3mm (a)
CA004	pilar cónico 4,1mm (d)x 4mm (a)
CA004S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 4mm (a)
CA005	pilar cónico 4,1mm (d)x 5,5mm (a)
CA005S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 5,5mm (a)
CACC5	cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1mm y 5mm
CAGC5	cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (d)
CAGC6	cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (d)
CATC5	cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (d)
CC300	cilindro provisorio cónico no hexagonal
CNC30	cilindro cónico provisorio hexagonal.
CNRC5	cilindro cónico calcinable hexagonal 4,1mm y 5mm(d)
CNRG5	cilindro oro cónico hexagonal 4,1 y 5mm (d)
CNRG6	cilindro oro cónico hexagonal 6mm (d)



..//

CS250	tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 5mm (p)
CS260	tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 6mm (p)
CS270	tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 7,5mm (p)
IAC4217	pilar certain cónico angulado 17° 4,1mm(d) x 2mm(a)
IAC4225	pilar certain cónico angulado 25° 4,1mm(d) x 2mm(a)
IAC4417	pilar certain cónico angulado 17° 4,1mm(d) x 4mm(a)
IAC4425	pilar certain cónico angulado 25° 4,1mm(d) x 4mm(a)
ICA001	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 1mm (a)
ICA001S	tornillo para pilar cónico certain 4,1 y 5mm (d) x 1mm (a)
ICA002	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 2mm (a)
ICA002S	tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 2mm (a)
ICA003	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 3mm (a)
ICA003S	tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 3mm (a)
ICA004	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 4mm (a)
ICA004S	tornillo para pilar cónico certain 4,1 y 5mm (d) x 4mm (a)
ICA055	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 5,5mm (a)
ICA055S	tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 5,5mm (a)
IMCA31	pilar cónico certain 3,4mm (d) x 1mm (a)
IMCA32	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 2mm (a)
IMCA33	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 3mm (a)
IMCA34	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 4mm (a)
IWCA51	pilar cónico certain 5mm (d) x 1mm (a)
IWCA52	pilar cónico certain 5mm (d) x 2mm (a)
IWCA53	pilar cónico certain 5mm (d) x 3mm (a)
IWCA54	pilar cónico certain 5mm (d) x 4mm (a)
IWCA55	pilar cónico certain 5mm (d) x 5,5mm (a)
IWCA61	pilar cónico certain 6mm (d) x 1mm (a)
IWCA62	pilar cónico certain 6mm (d) x 2mm (a)
IWCA63	pilar cónico certain 6mm (d) x 3mm (a)
IWCA64	pilar cónico certain 6mm (d) x 4mm (a)



..//

IWCA65	pilar cónico certain 6mm (d) x 5,5mm (a)
MCA31	pilar cónico 3,4mm(d) x 1mm(a)
MCA32	pilar cónico 3,4mm(d) x 2mm(a)
MCA33	pilar cónico 3,4mm(d) x 3mm(a)
MCA34	pilar cónico 3,4mm(d) x 4mm(a)
MCAG1	cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm(d)
MCAG2	cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm(d)
MCTC1	cilindro provisorio cónico hexagonal
MCTC2	cilindro provisorio cónico no hexagonal
MITC2	cilindro de titanio cono corto no hexagonal
QBCAP	tapa quickbridge
QKBRG	cilindro y tapa quickbridge
SCA001	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 1mm (a)
SCA002	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 2mm (a)
SCA003	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 3mm (a)
SCA004	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 4mm (a)
SCA055	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 5,5mm (a)
SWCA51	pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x1mm (a)
SWCA52	pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x2mm (a)
SWCA53	pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x3mm (a)
SWCA54	pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x4mm (a)
SWCA55	pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x5,5mm (a)
SWCA61	pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x1mm (a)
SWCA62	pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x2mm (a)
SWCA63	pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x3mm (a)
SWCA64	pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x4mm (a)
SWCA65	pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x5,5mm (a)
TRC30	cilindro de retención provisorio
WCA51	pilar cónico 5mm (d) x1mm(a)
WCA52	pilar cónico 5mm (d) x2mm(a)



..//

WCA53	pilar cónico 5mm (d) x3mm(a)
WCA54	pilar cónico 5mm (d) x4mm(a)
WCA55	pilar cónico 5mm (d) x5,5mm(a)
WCA62	pilar cónico 6mm (d) x2mm (a)
WCA63	pilar cónico 6mm(d)x 3mm(a)
WCA65	pilar cónico 6mm(d)x 5,5mm(a)
WCS66	tapa de cicatrización ep cónica de 6mm (d) x 6mm (p)
WCS67	tapa de cicatrización ep cónica de 6mm (d) x 7,5mm (p)
WCTC60	cilindro provisorio cónico ep 6mm(d)x6mm(p) hexagonal
WCTC61	cilindro provisorio cónico ep 6mm(d)x6mm(p) no hexagonal
AG900	kit de guías anguladas (set de 9 piezas)
BB001	caja organizadora esterilizable
BPAKTB	caja organizadora para kit de perfilador óseo de diametro ancho
BPGUIDE	guía para perfilador óseo
BPKITB	caja organizadora para kit de perfilador óseo de diámetro estándar
CADD1	controlador de mando directo contra ángulo
CATC1	controlador de torque contra ángulo 10ncm
CATC2	controlador de torque contra ángulo 20ncm
CATC3	controlador de torque contra ángulo 32ncm
CATDH	mango de destornillador de torque contra ángulo
CDI4500	indicador de profundidad de avellanado para cd4500
CDI5600	indicador de profundidad de avellanado para cd5600
CLA20	análogo de laboratorio para pilar cónico 4,1 y 5 mm (d)
CW100	llave de boca
DI100	indicador de dirección
DI200	indicador de dirección - largo
DI2310	indicador de dirección 2,3mm(d) x 10mm(l)
DI2315	indicador de dirección 2,3mm(d) x 15mm(l)
DP020	sonda de profundidad para implante

97



..//

DRFAT1	herramienta de ajuste de la hembra dal-ro
DRLAU	análogo de laboratorio universal dal-ro
DSB100	bloque para corte de topes de fresas
DU1IT	tubería de irrigación du100
DU1ITP	pin de tubo de irrigación
IBPGP	guía certain para perfilador óseo (paq. de 3) 4,1; 5,0; 6mm(d)
IBPMGP	pin guía de perfilador óseo 3,4mm certain (paq. de 3)
IC015	montura de implante 15mm
ICD00	transportador de cofias de impresión estrecho
ICDI100	indicador de profundidad de avellanado para icd100
IDI001	indicador de dirección certain 10mm(l)
IDIKT	kit indicador de dirección certain
IDIM01	indicador de dirección certain para implante 3,25mm(d) x 10mm(l)
IH300	pieza de inserción de agarradera de implante
IILA20	análogo de laboratorio de implante certain 4,1mm(d)
IILAW5	análogo de laboratorio de implante certain 5,00mm(d)
IILAW6	análogo de laboratorio de implante certain 6,00mm(d)
ILA20	análogo de laboratorio de implante 4,1mm(d)
ILAW5	análogo de laboratorio de implante 5,0mm(d)
ILAW6	análogo de laboratorio de implante 6,0mm(d)
ILT150	pulidor y guía certain ucla
ILTAH57	agarradera de pilar de laboratorio certain
IMBP4	perfilador óseo manual certain 4,1mm(d)/5mm(p)
IMBP5	perfilador óseo manual certain 5,0mm(d)/6,0mm(p)
IMLT150	pulidor 3,4mm(d) certain con guía
IMMBP	perfilador óseo manual certain, 3,4mm(d) x 4,1mm(p)
IMMILA	análogo de laboratorio certain 3,4mm(d)
IMRE100	extensor certain corto para llave de carraca, 3,4mm(d)
IMRE200	extensor certain largo para llave de carraca, 3,4mm(d)



..//

IOLLAS	análogo de laboratorio recto iol
IOLPP	protector de pulido iol
IPPIA3	protector de pulido certain ucla 4,1mm(d)
IPPIA5	protector de pulido certain ucla 5mm(d)
IPPIA6	protector de pulido certain ucla 6mm(d)
IPPMM1	protector de pulido certain ucla 3,4mm(d)
IQSA01	activador quickseat certain
IRE100	extensor certain para llave de carraca corto 4,1; 5,0; 6,0mm(d)
IRE200	extensor certain para llave de carraca largo 4,1; 5,0; 6,0mm(d)
IRH600	escariador con manija certain
IRH600RMR	escariador calcinable ucla certain
IRORDR	o rings de repuesto para destornillador certain, cant: 10
ISRT01	terraja manual certain
ISRT05	manija guía certain
ISRT06	herramienta para remoción de tornillo certain
ISRT07	fresa reversible manual
IWITSC	tornillo twist lock certain
IWSU30	pin guía/tornillo de encerado certain
LA200	análogo de laboratorio pilar estándar (latón)
LALA1	análogo de laboratorio pilar locator
LOA8397	herramienta para remoción de macho locator
LOAD	fresa para conector de barra locator para rosca de 2mm
LOAT	terraja para barra locator para rosca de 2mm
LPCAMI	pulidor para pilar de perfil bajo
LPCLA	análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo
LPCPP	protector de pulido para pilar de perfil bajo
LPCWS	tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
LT150	pulidor para pilar ucla de plástico calcinable
LTAH5	agarradera para pilar de laboratorio para 3,4mm(d)
LTAH7	agarradera de laboratorio para 4,1; 5,0; 6,0mm(d)

9  
/





..//

MALL1	martillo, acero inoxidable
MBP4	perfilador óseo manual 4,1mm(d) x 5mm(p)
MBP5	perfilador óseo manual 5mm(d) x 6mm(p)
MDR10H	adaptador para llave de carraca tg
ME100	elevador de membranas pequeño
ME200	elevador de membranas mediano
ME300	elevador de membranas grande
MIDTH	mango para punta transportadora intercambiable manual
MLT150	pulidor con guía para 3,4mm(d)
MMBP	perfilador óseo manual 3,4mm(d) x 4,1mm(p)
MMC03	montura de implante 3,4mm(d) x 3mm(l)
MMC15	montura de implante 3,4mm(d) x 15mm(l)
MMCLA	análogo de laboratorio cónico 3,4mm(d)
MMILA	análogo de laboratorio 3,4mm(d)
MMKIT	kit de montura de implante 3,4mm(d)
MSGIAM1	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 1(l)
MSGIAM2	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 2(l)
MSGIAM3	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 3(l)
MSGIAM4	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 4(l)
MSGIAML	montura para análogo navigator 3,4mm(d) largo
MSGIAMS	montura para análogo navigator 3,4mm(d) corto
MSGIIM1	montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 1(l)
MSGIIM2	montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 2(l)
MSGIIM3	montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 3(l)
MSGIIM4	montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 4(l)
MSGIIML	montura para implante navigator certain 3,4mm(d) largo
MSGIIMS	montura para implante navigator certain 3,4mm(d) corto
MUNITS	tornillo de prueba cuadrado 3,4mm(d)
MWS15	tornillo de encerado a nivel del implante para 3,4mm(d)
NTDI3210	indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm(d) x 10mm(l)

ds



..//

NTDI3211	indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm(d) x 11,5mm(l)
NTDI3213	indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 13mm(l)
NTDI3215	indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 15mm(l)
NTDI3285	indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 8,5mm(l)
NTDI410	indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 10mm(l)
NTDI411	indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 11,5mm(l)
NTDI413	indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 13mm(l)
NTDI415	indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 15mm(l)
NTDI485	indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 8,5mm(l)
NTDI510	indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 10mm(l)
NTDI511	indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 11,5mm(l)
NTDI513	indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 13mm(l)
NTDI515	indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 15mm(l)
NTDI585	indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 8,5mm(l)
NTDI610	indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 10mm(l)
NTDI611	indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 11,5mm(l)
NTDI613	indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 13mm(l)
NTDI615	indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 15mm(l)
NTDI685	indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 8,5mm(l)
NTDIKT	bandeja para indicador de profundidad osseotite nt
NTOST0	kit de sistema de osteótomo cónico natural – recto
NTOST0A	kit de sistema de osteótomo cónico natural – angulado
NTOST3	osteótomo recto osseotite nt 3,25mm
NTOST3A	osteótomo angulado osseotite nt 3,25mm
NTOST4	osteótomo recto osseotite nt 4,0mm
NTOST4A	osteótomo angulado osseotite nt 4,0mm
NTOST5	osteótomo recto osseotite nt 5,0mm
NTOST5A	osteótomo angulado osseotite nt 5,0mm
NTOST6	osteótomo recto osseotite nt 6,0mm
NTOST6A	osteótomo angulado osseotite nt 6,0mm

h  
,



..//

NTOSTTRA bandeja para osteótomo osseotite nt - angulado  
NTOSTTRS bandeja para osteótomo osseotite nt - recto  
NTT300S arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño gris paq. x 2  
NTT301 arandelas aislantes para ntt300, diámetro mediano gris paq. x 2  
NTT302 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño violeta paq. x  
2  
NTT303 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño verde paq. x  
2  
NTT304 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño amarillo paq.  
x 2  
ORCG1 clip tipo hader oro  
ORCY1 clip tipo hader plástico  
ORLAU análogo de pilar o-ring universal  
OST00 kit de osteótomos summers nros. 1-4  
OST01 osteótomo summers nro.1  
OST02 osteótomo summers nro.2  
OST03 osteótomo summers nro.3  
OST04 osteótomo summers nro.4  
OST05 osteótomo summers nro.5  
OST10 kit de osteótomos summers nros.1-5  
OST20 kit de osteótomos summers nros.1-5 y emplazamiento futuro  
OSTFS osteótomo summers para emplazamiento futuro  
OSTTR bandeja para sistema de osteótomo  
PAA484 análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 4,0mm  
PAA485 análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 5,5mm  
PAA654 análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 4,0mm  
PAA655 análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 5,5mm  
PAAP48 análogo de pilar provide con pin 4,8mm(p)  
PAAP65 análogo de pilar provide con pin 6,5mm(p)  
PAD00 transportador para pilares posterior 17mm



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

DISPOSICIÓN N°

0908

..//

PAD01 transportador para pilares dalro/o-ring  
PAD03 transportador para pilares dal-ro  
PAD24 transportador para pilares estándar 24mm(l)  
PHD00N destornillador hexagonal posterior estrecho-17mm  
PHD01N destornillador hexagonal estándar estrecho -24mm  
PHD02N destornillador hexagonal grande posterior estrecho -17mm  
PHD03N destornillador hexagonal grande estándar estrecho - 24mm  
PMKIT kit de guía de medición preangulada  
PPCA3 pilar cónico protector de pulido  
PPIA3 pilar ucla protector de pulido 4,1mm(d)  
PPMC1 pilar cónico 3,4mm(d), protector de pulido  
PPMM1 pilar ucla 3,4mm(d), protector de pulido  
PPSA3 pilar estándar protector de pulido  
PSD00 destornillador para tornillos posteriores -17mm  
PSD01 destornillador estándar -24mm  
PSDT1 bandeja para destornillador de sistema protésico  
PSQD0N destornillador cuadrado posterior estrecho - 17mm  
PSQD1N destornillador cuadrado estándar estrecho - 24mm  
PTT100 bandeja organizadora de plástico  
PTT300G arandelas aislantes para ptt300 (paq. x 2)  
PTT300GS arandelas aislantes para ptt300, diámetro pequeño (paq. x 2)  
PTT300I bandeja quirúrgica certain para implantes rectos  
PTT300UI pieza de inserción moldeada certain para actualización de kit  
pskt30u  
PWS48M manguito de encerado provide 4,8mm(p) - unidad múltiple  
PWS48S manguito de encerado provide 4,8mm(p) - unidad simple  
PWS65M manguito de encerado provide 6,8mm(p) - unidad múltiple  
PWS65S manguito de encerado provide 6,8mm(p) - unidad simple  
QNTSKI pieza de inserción moldeada para kit quirúrgico de fresa quad



..//

- QNTSKT base, pieza de inserción moldeada y cubierta ahumada liviana para el kit quirúrgico de fresas quad
- RE100 extensor de llave de carraca de 6mm de largo
- RE200 extensor de llave de carraca de 15mm de largo
- RH600 escariador con mango para hex. externo
- RMB30 bolas de marcación radiográfica (paq. de 30)
- RTI2035 indicador de torque para restauración
- RTI2035TR bandeja de indicador de torque para restauración
- SEKT1 kit de elevación de senos
- SEKTR bandeja de elevación de senos (sola)
- SGDPH1 tutor de posicionamiento de fresas navigator, 1
- SGDPH2 tutor de posicionamiento de fresas navigator, 2
- SGDPH3 tutor de posicionamiento de fresas navigator, 3
- SGDPH4 tutor de posicionamiento de fresas navigator, 4
- SGDPH5 tutor de posicionamiento de fresas navigator, 5
- SGFT24 tubo de fijación navigator (paq. de 25) 2mm(d) x 4mm(l)
- SGIAM41 montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 1 (l)
- SGIAM42 montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 2 (l)
- SGIAM43 montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 3 (l)
- SGIAM44 montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 4 (l)
- SGIAM4L montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) larga
- SGIAM4S montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) corta
- SGIAM51 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 1 (l)
- SGIAM52 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 2 (l)
- SGIAM53 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 3 (l)
- SGIAM54 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 4 (l)
- SGIAM5L montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) larga
- SGIAM5S montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) corta
- SGIIM41 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 1 (l)
- SGIIM42 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 2 (l)

5



..//

SGIIM43	montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 3 (l)
SGIIM44	montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 4 (l)
SGIIM4L	montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) larga
SGIIM4S	montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) corta
SGIIM51	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 1 (l)
SGIIM52	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 2 (l)
SGIIM53	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 3 (l)
SGIIM54	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 4 (l)
SGIIM5L	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) larga
SGIIM5S	montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) corta
SGLKIT	kit de laboratorio navigator
SGLTRAY	bandeja de laboratorio navigator
SGMT44	tubo maestro navigator (paq. de 25) 4,1mm(d) x 4mm(a)
SGMT54	tubo maestro navigator (paq. de 25) 5,0mm(d) x 4mm(a)
SGT25	tubo guía para férula (paq. de 25)
SGTDPHR	tutor de posicionamiento para fresa de reducción navigator cónico
SGTDPHT	tutor de posicionamiento para fresa espiral twist drill navigator cónica
SGTILKIT	kit de laboratorio certain navigator cónico
SGTLTRAY	bandeja de laboratorio navigator cónico
SGTRAY	bandeja quirúrgica navigator
SGTTAPT	bandeja de terraja ósea navigator cónica
SGTTRAY	bandeja quirúrgica navigator cónica
SLA20	análogo de laboratorio de pilar estándar (inoxidable)
SRT01	terraja manual para srt10
SRT02	fresa manual 1,04mm(d) fresa de bronce para srt10
SRT03	fresa manual 1,18mm(d) fresa de plata para srt10
SRT05	tutor guía para srt10
STLA5	análogo de laboratorio pilar sta 4,1mm y 5mm(d)



..//

TE003	elevador de titanio
TF002	pinzas de titanio
TIBC1	transportador de hueso revestido de nitruro de titanio para sekt1
TIPL1	taponador de titanio grande
TIPS1	taponador de titanio pequeño
TMP80	poste de medición de tejidos
TP001	bisturí circular para tejido 4,1mm(d)
TP005	bisturí circular para tejido 5mm(d)
TP006	bisturí circular para tejido 6mm(d)
TT150	bandeja para entrega de implante
UNITS	tornillo cuadrado de prueba universal (paq. de 5)
WCLA6	análogo de laboratorio pilar cónico 6mm(d)
WCPP6	protector de pulido 6mm cónico
WITSC	tornillo de cofia twist lock ep para implante (todos)
WLT10	pulidor para implante de diámetro ancho
WPP50	protector de pulido 5mm(d)
WPP60	protector de pulido 6mm(d)
WR150	llave de carraca
WSK10	tornillo de encerado/pin guía texturizado 10mm
WSK15	tornillo de encerado/pin guía texturizado 15mm
WSK30	tornillo de encerado/pin guía texturizado 20mm
WSU30	pin guía/tornillo de encerado para implante texturizado
XDG00	kit de sondas de profundidad para rayos x gelb
XDG01	kit de sondas de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d)
XDG13	sonda de profundidad para rayos x gelb 13mm
XDG20	sonda de profundidad para rayos x gelb 20mm
XDG2313	sonda de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d) x 13mm(l)
XDG2320	sonda de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d) x 20mm(l)
CIC55	cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)
CIC56	cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)

U  
-



..//

CIC57	cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)
CNRIC	cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)
CSQ06	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)
CSQ07	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)
CSQ17	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)
CSQN6	cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)
CSQN7	cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)
IC100	cofia de impresión quirúrgica
ICZTIS	tornillo de prueba encode zircon
IIC12	cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC41	cofia pick-up para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC44	cofia twist lock para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC45	cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC46	cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)
IIC47	cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 7,5mm(p)
IIC60	cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)
IIC75	cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 7,5mm(p)
IIC12	cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC41	cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC42	cofia pick-up para implante no hexagonal certain 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC44	cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC45	cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC46	cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 6mm(p)
IIC47	cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p)
IIC60	cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 6mm(p)
IIC75	cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p)
IMIC30	cofia pick up recta certain 3,4mm(d) x 0mm(p)
IMIC33	cofia pick up certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p)
IOLPIC	cofia de impresión pick-up iol





..//

IOLTIC	cofia de impresión de transferencia iol
IUNITS	tornillo de prueba hexagonal certain (paq. de 5) 3,4; 4,1; 5,0; 6,0mm(d)
IWIP50	cofia pick-up recta certain 5,0mm(d) x 0mm(p)
IWIP55	cofia pick-up certain 5mm(d) x 5mm(p)
IWIP56	cofia pick-up certain 5mm(d) x 6mm(p)
IWIP57	cofia pick-up certain 5mm(d) x 7,5mm(p)
IWIP60	cofia pick-up recta certain 6,0mm(d) x 0mm(p)
IWIP66	cofia pick-up certain 6,0mm(d) x 6mm(p)
IWIP67	cofia pick-up certain 6,0mm(d) x 7,5mm(p)
IWIT50	cofia de transferencia recta twist lock certain 5,0mm(d) x 0mm(p)
IWIT55	cofia twist lock certain 5mm(d) x 5mm(p)
IWIT56	cofia twist lock certain 5mm(d) x 6mm(p)
IWIT57	cofia twist lock certain 5mm(d) x 7,5mm(p)
IWIT60	cofia de transferencia recta twist lock certain 6,0mm(d) x 0mm(p)
IWIT66	cofia twist lock certain 6mm(d) x 6mm(p)
IWIT67	cofia twist lock ep para implante certain 6mm(d) x 7,5mm(p)
IZIRTS	tornillo de prueba hexagonal zireal certain
LAIC1	cofia de impresión para pilar locator
LPCPIC1	cofia de impresión pick-up para pilar de perfil bajo (hexagonal)
LPCPIC2	cofia de impresión pick-up para pilar de perfil bajo (no hexagonal)
LPCRIC	cofia de impresión quickbridge para pilar de perfil bajo
LPCTIC1	cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTIC2	cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
MEC33	cofia pick-up para pilar cónico 3,4mm(d)



..//

MIC33	cofia de impresión pick-up 3,4mm(d)
PIC484	cofia de impresión provide 4,8mm(d) – poste de 4,0mm
PIC484H	cofia de impresión provide con orificios 4,8mm(d) – poste de 4,0mm
PIC485	cofia de impresión provide 4,8mm(d) – poste de 5,5mm
PIC485H	cofia de impresión provide con orificios 4,8mm(d) – poste de 5,5mm
PIC654	cofia de impresión provide 6,5mm(d) – poste de 4,0mm
PIC654H	cofia de impresión provide con orificios 6,5mm(d) – poste de 4,0mm
PIC655	cofia de impresión provide 6,5mm(d) – poste de 5,5mm
PIC655H	cofia de impresión provide con orificios 6,5mm(d) – poste de 5,5mm
SIC70	cofia de transferencia para pilar estándar
SQIC7	cofia pick-up para pilar estándar
WCP661	cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)
WCP662	cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)
WCP671	cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)
WCT661	cofia twist lock ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)
WCT662	cofia twist lock ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)
WCT671	cofia twist lock ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)
WCT672	cofia twist lock ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)
WIP55	cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 5mm(p)
WIP56	cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 6mm(p)
WIP57	cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 7,5mm(p)
WIP66	cofia pick-up ep para implante 6mm(d) x 6mm(p)
WIP67	cofia pick-up ep para implante 6mm(d) x 7,5mm(p)
WIT55	cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 5mm(p)
WIT56	cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 6mm(p)
WIT57	cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 7,5mm(p)

5  
-



..//

- WIT66 cofia twist lock ep para implante 6mm(d) x 6mm(p)  
WIT67 cofia twist lock ep para implante 6mm(d) x 7,5mm(p)  
APP42 poste prep-tite 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a) con tornillo hexagonal de titanio  
APP452G poste gingihue 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
APP454G poste gingihue 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
APP462G poste gingihue 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
APP464G poste gingihue 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
APP472G poste gingihue 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
APP474G poste gingihue 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
IAPP452G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
IAPP454G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
IAPP462G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
IAPP464G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
IAPP472G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
IAPP474G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
IMAP32G poste gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)  
IMAP34G poste gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
IMPAP32G poste angulado 15° gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)  
IMPAP34G poste angulado 15° gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
IPAP452G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
IPAP454G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
IPAP462G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
IPAP464G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

5



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.S.M.S.T.

DISPOSICIÓN N°

0908

..//

IPAP472G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)

IPAP474G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)

IPAP552G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)

IPAP554G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IPAP562G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

IPAP564G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IPAP572G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d)x 7,5mm(p)x2mm(a)

IPAP574G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d)x 7,5mm(p)x4mm(a)

IPAP662G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 6mm(p)x2mm(a)

IPAP664G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 6mm(p)x4mm(a)

5) IPAP672G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 7,5mm(p)x2mm(a)

IPAP674G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 7,5mm(p)x4mm(a)

IWPP552G poste gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)

IWPP554G poste gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IWPP562G poste gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

IWPP564G poste gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IWPP572G poste gingihue certain 5mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)

IWPP574G poste gingihue certain 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)

IWPP662G poste gingihue certain 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

IWPP664G poste gingihue certain 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)



..//

IWPP672G poste gingihue certain 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
IWPP674G poste gingihue certain 6mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
MAP32G poste gingihue 3,4mm(d) x3,8mm(p)x 2mm(a)  
MAP34G poste gingihue 3,4mm(d) x3,8mm(p)x 4mm(a)  
MPAP32G poste gingihue preangulado 15° 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
2mm(a)  
MPAP34G poste gingihue preangulado 15° 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
4mm(a)  
PA154C pilar preangulado 15° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA156C pilar preangulado 15° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PA254C pilar preangulado 25° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA256C pilar preangulado 25° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PA352 SCREW tornillo pa352  
PA352C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PA354C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA356C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PAP452G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PAP454G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PAP462G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP464G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
PAP472G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
PAP474G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
PAP552G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PAP554G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PAP562G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP564G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
PAP572G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
PAP574G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
PAP662G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP664G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)



..//

PAP672G	poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)
PAP674G	poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)
PAW00	arandela para pilar preangulado
PTC345	tapa prep-tite 5mm
PTC347	tapa prep-tite 7mm
PTC455	tapa prep-tite 5mm
PTC457	tapa prep-tite 7mm
PTC465	tapa prep-tite 5mm
PTC467	tapa prep-tite 7mm
PTC475	tapa prep-tite 5mm
PTC477	tapa prep-tite 7mm
PTC555	tapa prep-tite 5mm
PTC557	tapa prep-tite 7mm
PTC665	tapa prep-tite 5mm
PTC667	tapa prep-tite 7mm
WPP552	poste prep-tite 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a) con tornillo de titanio hexagonal
WPP552G	poste gingihue 5mm(d) x 5mm(p)x 2mm(a)
WPP554G	poste gingihue 5mm(d) x 5mm(p)x 4mm(a)
WPP562G	poste gingihue 5mm(d) x 6mm(p)x 2mm(a)
WPP564G	poste gingihue 5mm(d) x 6mm(p)x 4mm(a)
WPP572G	poste gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p)x 2mm(a)
WPP574G	poste gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p)x 4mm(a)
WPP662	poste prep-tite 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a) con tornillo de titanio hexagonal
WPP662G	poste gingihue 6mm(d) x 6mm(p)x 2mm(a)
WPP664G	poste gingihue 6mm(d) x 6mm(p)x 4mm(a)
WPP672G	poste gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p)x 2mm(a)
WPP674G	poste gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p)x 4mm(a)
AB200	pilar estándar 4,1mm(d) x 2mm (a)



..//

AB200S	tornillo para pilar estándar de titanio 2mm (a)
AB300	pilar estándar 4,1mm(d) x 2mm (a)
AB300S	tornillo para pilar estándar de titanio 3mm (a)
AB400	pilar estándar 4,1mm(d) x 4mm (a)
AB400S	tornillo para pilar estándar de titanio 4mm (a)
AB550	pilar estándar 4,1mm (d) x 5,5mm(a)
AB550S	tornillo para pilar estándar de titanio 5,5mm(a)
AB700	pilar estándar 4,1mm(d) x 7mm(a)
AHP72	poste pilar 4,1mm(d) x 2mm(a)
AHP73	poste pilar 4,1mm(d) x 3mm(a)
AHP74	poste pilar 4,1mm(d) x 4mm(a)
CGC30	cilindro biselado oro para pilar estándar
IAB200	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 2mm (a)
IAB300	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 3mm (a)
IAB400	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 4mm (a)
IAB550	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 5,5mm (a)
IAB700	pilar estándar certain 4,1mm (d) x 7mm(a)
SGC30	cilindro oro para pilar estándar
SGC34	cilindro plástico calcinable para pilar estándar
STC30	cilindro para pilar estándar de titanio
TC300	cilindro provisorio (pilar estándar)
TS250	tornillo provisorio para pilar estándar 4,1mm(d)
WAB200	pilar estándar 5mm (d) x 2mm (a)
WAB300	pilar estándar 5mm (d) x 3mm (a)
WAB400	pilar estándar 5mm (d) x 4mm (a)
WAB550	pilar estándar 5mm (d) x 5,5mm(a)

Fabricante: BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L - ESPAÑA

ILPAC3217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)

ILPAC3330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)

ILPAC3417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)



..//

- ILPAC3530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
- ILPAC4217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
- ILPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
- ILPC341 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
- ILPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
- ILPC342 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPC343 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPC344 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPC441 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILPC442 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPC443 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPC444 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILPC444U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILPC541 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
- ILPC541U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
- ILPC542 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
- ILPC542U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
- ILPC543 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)

5





..//

- ILPC543U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
- ILPC544 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
- ILPC544U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
- LPAC3217 Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
- LPAC3330 Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
- LPAC3417 Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
- LPAC3530 Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
- LPAC4217 Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
- LPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
- LPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
- LPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
- LPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
- LPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
- LPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
- LPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
- LPC341 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
- LPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
- LPC342 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
- LPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
- LPC343 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
- LPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
- LPC344 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
- LPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
- LPC441 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
- LPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
- LPC442 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
- LPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
- LPC443 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
- LPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
- LPC444 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)



..//

LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCAMI	Instrumento de pulido para pilar de perfil bajo
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCDE	Extensión distal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCLA	Análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo
LPCPIC1	Cofia de impresión Pick-up (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCPIC2	Cofia de impresión Pick-up (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCPP	Protector de pulido para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCRIC	Cofia de impresión para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo



..//

LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTIC1	Cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTIC2	Cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
FABRICANTE: BIOMET 3i – ESTADOS UNIDOS	
AB550	Pilar estándar 4,1mm (D) x 5,5mm(A)
AB550S	Tornillo de titanio para pilar estándar 5,5mm(A)
AB700	Pilar estándar 4,1mm(D) x 7mm(A)
AC4217	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4225	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4417	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
AC4425	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
ACSCREW	Tornillo p/pilar cónico angulado 17° y 25° - 4,1mm y 5mm(D) x 2mm y 4mm(A)
AHP72	Poste pilar 4,1mm(D) x 2mm(A)
AHP73	Poste pilar 4,1mm(D) x 3mm(A)
AHP74	Poste pilar 4,1mm(D) x 4mm(A)
APP42	Poste Prep-Tite 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A) c/tornillo hexagonal de titanio
APP452G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
APP454G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
APP462G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 2mm (A)
APP464G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
APP472G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
APP474G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
CA001	Pilar cónico 4,1mm (D)x 1mm (A)

5



..//

CA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 1mm (A)
CA002	Pilar cónico 4,1mm (D)x 2mm (A)
CA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 2mm (A)
CA003	Pilar cónico 4,1mm (D)x 3mm (A)
CA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 3mm (A)
CA004	Pilar cónico 4,1mm (D)x 4mm (A)
CA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 4mm (A)
CA055	Pilar cónico 4,1mm (D)x 5,5mm (A)
CA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 5,5mm (A)
CACC5	Cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1 x 5mm
CAGC5	Cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (D)
CAGC6	Cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (D)
CATC5	Cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (D)
CC300	Cilindro prov. cónico no hexagonal.
CGC30	Cilindro biselado oro para pilar estándar
CSCM05	Barra para 5 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM06	Barra para 6 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
5) CSCM07	Barra para 7 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
- CSCM08	Barra para 8 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM09	Barra para 9 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM10	Barra para 10 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSD02	Barra Camstructsure Dolder
CSD03	Barra Camstructsure Dolder
CSD04	Barra Camstructsure Dolder
CSD05	Barra Camstructsure Dolder
CSD06	Barra Camstructsure Dolder
CSD07	Barra Camstructsure Dolder
CSD08	Barra Camstructsure Dolder
CSD09	Barra Camstructsure Dolder
CSD10	Barra Camstructsure Dolder



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.*

DISPOSICIÓN N°

0908

..//

CSH02	Barra Camstructsure Hadar
CSH03	Barra Camstructsure Hadar
CSH04	Barra Camstructsure Hadar
CSH05	Barra Camstructsure Hadar
CSH06	Barra Camstructsure Hadar
CSH07	Barra Camstructsure Hadar
CSH08	Barra Camstructsure Hadar
CSH09	Barra Camstructsure Hadar
CSH10	Barra Camstructsure Hadar
CSHY04	Barra híbrida Camstructsure
CSHY05	Barra híbrida Camstructsure
CSHY06	Barra híbrida Camstructsure
CSHY07	Barra híbrida Camstructsure
CSHY08	Barra híbrida Camstructsure
CSHY09	Barra híbrida Camstructsure
CSHY10	Barra híbrida Camstructsure
CSP02	Barra primaria Camstructsure
CSP03	Barra primaria Camstructsure
CSP04	Barra primaria Camstructsure
CSP05	Barra primaria Camstructsure
CSP06	Barra primaria Camstructsure
CSP07	Barra primaria Camstructsure
CSP08	Barra primaria Camstructsure
CSP09	Barra primaria Camstructsure
CSP10	Barra primaria Camstructsure
DRAF	Conector hembra roscado Dal-Ro
DRCS1	Sistema calcinable Dal-Ro
DRFM1	Conector hembra de metal Dal-Ro
DRH20	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 2mm (A)
DRH40	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 4mm (A)



..//

- DRH60 Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 6mm (A)
- DRTH Conjunto Dal-Ro de capuchón y conector hembra
- EDA Pilar de diseñador Encode
- EDAX Pilar diseñado en laboratorio Encode
- EDAZX Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
- EHA343 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3,0mm (A)
- EHA344 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
- EHA346 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
- EHA348 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
- EHA353 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
- EHA354 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- EHA356 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
- EHA358 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
- EHA443 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)
- EHA444 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)
- EHA446 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)
- EHA448 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)



..//

- EHA453 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
- EHA454 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- EHA456 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
- EHA458 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
- EHA463 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
- EHA464 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- EHA466 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- EHA468 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
- EHA473 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- EHA474 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- EHA476 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- EHA478 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- EHA553 Pilar de cicatrización Ep de -piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)
- EHA554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)
- EHA556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)



..//

- EHA558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)
- EHA563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
- EHA564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- EHA566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- EHA568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
- EHA573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- EHA574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- EHA576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- EHA578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- EHA663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)
- EHA664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
- EHA666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
- EHA668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
- EHA673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- EHA674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

5,





..//

- EHA676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- EHA678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- GS200 Tornillo oro c/ranura 2mm
- GS300 Tornillo oro c/ranura 3mm
- GSH20 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 2mm
- GSH30 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 3mm
- GSH70 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 7mm
- GUCA1C Pilar oro-hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
- GUCA2C Pilar oro no hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
- GUCA3 Pilar Minimplant UCLA oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)
- GUCA3S Tornillo para pilar Minimplant UCLA oro (hexagonal interno)
- IAB200 Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 2mm (A)
- IAB300 Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 3mm (A)
- IAB400 Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 4mm (A)
- IAB550 Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 5,5mm (A)
- IAB700 Pilar estándar Certain 4,1mm (D) x 7mm(A)
- IAC4217 Pilar Certain cónico angulado 17°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
- IAC4225 Pilar Certain cónico angulado 25°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
- IAC4417 Pilar Certain cónico angulado 17°-4,1mm(D) x 4mm(A)
- IAC4425 Pilar Certain cónico angulado 25°-4,1mm(D) x 4mm(A)
- IAPP452G Poste GingiHue Certain 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
- IAPP454G Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- IAPP462G Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 2mm (A)
- IAPP464G Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- IAPP472G Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
- IAPP474G Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- ICA001 Pilar cónico 4,1mm (D) x 1mm (A) Certain



..//

- ICA001S Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 1mm (A)Certain
- ICA002 Pilar cónico 4,1mm (D) x 2mm (A)Certain
- ICA002S Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 2mm (A)Certain
- ICA003 Pilar cónico 4,1mm (D) x 3mm (A)Certain
- ICA003S Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 3mm (A)Certain
- ICA004 Pilar cónico 4,1mm (D) x 4mm (A) Certain
- ICA004S Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 4mm (A)Certain
- ICA055 Pilar cónico 4,1mm (D) x 5,5mm (A)Certain
- ICA055S Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 5,5mm (A)Certain
- ICAP454 Poste ZiReal 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
- ICAP464 Poste ZiReal 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
- ICZGS Tornillo Gold-Tite de circonio Encode
- ICZTIS Tornillo de prueba de circonio Encode
- IEHA343 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3mm (A)
- IEHA344 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
- IEHA346 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
- IEHA348 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
- IEHA353 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
- IEHA354 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- IEHA356 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

5,



..//

IEHA358 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)

IEHA443 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)

IEHA444 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)

IEHA446 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)

IEHA448 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)

IEHA453 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)

IEHA454 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

IEHA456 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

↗ IEHA458 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)

✓ IEHA463 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)

IEHA464 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

IEHA466 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

IEHA468 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

IEHA473 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA474 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)



..//

IEHA476 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

IEHA478 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA553 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)

IEHA556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)

IEHA558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)

IEHA564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

U)

IEHA566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

IEHA568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

IEHA573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

IEHA576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

IEHA578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)



..//

- IEHA664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
- IEHA666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
- IEHA668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
- IEHA673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- IEHA674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- IEHA676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- IEHA678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- IGUCA1C Cilindro de pilar hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D)
- IGUCA2C Cilindro de pilar no hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D) con tornillo diámetro ancho
- IGUCA2T Pilar oro-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm con tornillo ancho de titanio
- IIOL20S Pilar IOL Certain 2mm
- IIOL30S Pilar IOL Certain 3mm
- IIOL40S Pilar IOL Certain 4mm
- IIOL55S Pilar IOL Certain 5,5mm
- IIOL70S Pilar IOL Certain 7mm
- IITCS41 Cilindro provisorio hexagonal Certain 4,1mm (D)
- IITCS42 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- ILOA001 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILOA002 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILOA003 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)



..//

- ILOA004 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILOA005 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
- ILOA006 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 6mm (A)
- ILPAC3217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC3330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC3417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC3530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
- ILPAC4217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
- ILPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
- ILPC341 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
- ILPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
- ILPC342 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPC343 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPC344 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPC441 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILPC442 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPC443 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPC444 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)



..//

ILPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC541	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC542	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC543	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC544	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILRGHG	Tornillo Gold -Tite Certain hexagonal de diámetro ancho
ILRGHT	Tornillo de titanio Certain hexagonal de diámetro ancho
IMAP32G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 2mm(A)
IMAP34G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMCA31	Pilar cónico 3,4mm (D) x 1mm (A) Certain
IMCA32	Pilar cónico 3,4mm (D)x 2mm (A) Certain
IMCA33	Pilar cónico 3,4mm (D)x 3mm (A) Certain
IMCA34	Pilar cónico 3,4mm (D)x 4mm (A) Certain
IMHA32	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 2mm (A)
IMHA33	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 3mm (A)
IMHA34	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 4mm (A)
IMHA36	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 6mm (A)
IMLOA001	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 1mm (A)
IMLOA002	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 2mm (A)
IMLOA003	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 3mm (A)



..//

- IMLOA004 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 4mm (A)  
IMLOA005 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 5mm (A)  
IMLOA006 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 6mm (A)  
IMMTCS1 Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal  
IMPAP32G Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)  
IMPAP34G Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)  
IMPAPF34 Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)  
IMPAPF36 Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)  
IMPFP34 Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)  
IMPFP36 Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)  
IMPFTC32 Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (no hexagonal)  
IMPFTC34 Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (hexagonal)  
IMUCC2C Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCC2T Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCG1C Pilar hexagonal oro UCLA Certain 3,4mm(D)  
IMUCG2C Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCG2T Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IOL20T Pilar con tornillo 2mm IOL 2 piezas  
IOL30T Pilar con tornillo 3mm IOL 2 piezas  
IOL40T Pilar con tornillo 4mm IOL 2 piezas  
IOL55T Pilar con tornillo 5,5mm IOL 2 piezas  
IOL70T Pilar con tornillo 7mm IOL 2 piezas  
IOLDE Extensión distal IOL  
IOLGC Cilindro oro IOL  
IOLHC Capuchón de cicatrización IOL





..//

IOLTC	Cilindro provisorio IOL
IPA4140	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA4155	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA4240	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA4255	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA4340	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA4355	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
IPA4440	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
IPA4455	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) - Post 5,5mm
IPA5140	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5155	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5240	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5255	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5340	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5355	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm

5,



..//

- IPA5440 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
- IPA5455 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
- IPA6140 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
- IPA6155 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
- IPA6240 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
- IPA6255 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
- IPA6340 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
- IPA6355 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
- IPA6440 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
- IPA6455 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
- IPAP452G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
- IPAP454G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
- IPAP462G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- IPAP464G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IPAP472G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)



..//

IPAP474G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)  
IPAP552G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)  
IPAP554G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)  
IPAP562G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)  
IPAP564G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)  
IPAP572G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)  
IPAP574G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)  
IPAP662G Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x2mm(A)  
IPAP664G Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)  
IPAP672G Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)  
IPAP674G Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)  
j  
- IPAPF454 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)  
IPAPF456 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)  
IPAPF464 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)  
IPAPF466 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)  
IPAPF474 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

DISPOSICIÓN N°

0908

..//

IPAPF476 Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IPAPF554 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)

IPAPF556 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)

IPAPF564 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IPAPF566 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IPAPF574 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IPAPF576 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IPAPF664 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IPAPF666 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IPAPF674 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IPAPF676 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IPFP454 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)

IPFP456 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)

IPFP464 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IPFP466 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IPFP474 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IPFP476 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IPFTC41 Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (hexagonal)

IPFTC42 Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (no hexagonal)



..//

ISHA42	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 2mm(A)
ISHA43	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 3mm(A)
ISHA44	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 4mm(A)
ISHA46	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 6mm(A)
ISHA48	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 8mm(A)
ISMHA32	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x 2mm(A)
ISMHA33	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x 3mm(A)
ISMHA34	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 4mm(A)
ISMHA36	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 6mm(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITCH0	Cilindro provisorio para implante hexagonal c/ tornillo hexagonal 4,1mm



..//

- ITCH1 Cilindro provisorio para implante no hexagonal. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(D)
- ITCS41 Cilindro provisorio hexagonal 4,1mm (D) con retención
- ITCS42 Cilindro provisorio no hexagonal 4,1mm (D) con retención
- ITHA52 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 2mm(A)
- ITHA53 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 3mm(A)
- ITHA54 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 4mm(A)
- ITHA56 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 6mm(A)
- ITHA58 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 8mm(A)
- ITHA63 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 3mm(A)
- ITHA64 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 4mm(A)
- ITHA66 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 6mm(A)
- ITHA68 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 8mm(A)
- ITHA73 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 3mm(A)
- ITHA74 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 4mm(A)
- ITHA76 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 6mm(A)
- ITHA78 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 8mm(A)
- ITUCA2C Pilar de titanio-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- IUNAB2C Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de diámetro ancho Gold-Tite
- IUNAB2T Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de titanio de diámetro ancho
- IUNIHG Tornillo hexagonal Gold-Tite Certain
- IUNIHT Tornillo hexagonal Certain de titanio
- IWCA51 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 1mm (A)



..//

- IWCA52 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 2mm (A)  
IWCA53 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 3mm (A)  
IWCA54 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 4mm (A)  
IWCA55 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 5mm (A)  
IWCA61 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 1mm (A)  
IWCA62 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 2mm (A)  
IWCA63 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 3mm (A)  
IWCA64 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 4mm (A)  
IWCA65 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 5,5mm (A)  
IWCAP564 Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal  
IWCAP574 Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal  
IWGA51C Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D)  
IWGA52C Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho  
IWGA52T Pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWGA61C Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D)  
IWGA62C Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho  
IWGA62T Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWPC52C Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho  
IWPC52T Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWPC62C Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho



..//

- IWPC62T Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
- IWPP554 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP556 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
- IWPP564 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP566 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
- IWPP574 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP576 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
- IWPP664 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP666 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
- IWPP674 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP676 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
- IWPF51 Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (hexagonal)
- IWPF52 Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (no hexagonal)
- IWPF61 Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (hexagonal)
- IWPF62 Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (no hexagonal)
- IWPP552G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP554G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP562G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- IWPP564G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP572G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP574G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP662G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- IWPP664G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP672G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP674G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWTCS51 Cilindro provisorio hexagonal Certain 5mm (D)
- IWTCS52 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- IWTCS61 Cilindro provisorio hexagonal Certain 6mm (D)





..//

- IWTC562 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- IWTH52 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x2mm(A)
- IWTH53 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x3mm(A)
- IWTH54 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x4mm(A)
- IWTH56 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x6mm(A)
- IWTH562 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x2mm(A)
- IWTH563 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x3mm(A)
- IWTH564 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x4mm(A)
- IWTH566 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- IWTH568 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
- IWTH572 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
- IWTH573 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- IWTH574 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- IWTH576 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- IWTH578 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- IWTH58 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 5,6mm (P) x 8mm (A)
- IWTH62 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 2mm (A)
- IWTH63 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 3mm (A)
- IWTH64 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 4mm (A)

01



..//

IWTH66	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 6mm (A)
IWTH672	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IWTH673	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IWTH674	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IWTH676	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IWTH678	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IWTH68	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 8mm (A)
IZSHG	Tornillo para pilar hexagonal Gold-Tite para poste Certain ZiReal
LAELM	Machos de retención extra ligeros Locator - Pack x 4
LAERM	Machos de rango extendido Locator - Pack x 4
LARMS	Machos de repuesto Locator - Pack x 4
LELARM	Machos de repuesto angulados extra ligeros Locator - Pack x4.
LGS30	Tornillo de retención con ranura oro largo
LLRMS	Machos de retención ligera Locator - Pack x 4
LOA001	Pilar Locator 1mm
LOA002	Pilar Locator 2mm
LOA003	Pilar Locator 3mm
LOA004	Pilar Locator 4mm
LOA005	Pilar Locator 5mm
LOA006	Pilar Locator 6mm
LOAB	Accesorio Locator
LOAH	Cazoleta de repuesto Locator
LORHK	Kit de cazoletas de repuesto Locator



..//

LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo	3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo	3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo	3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo	3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo	4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo	4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo	4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo	4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo	5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo	5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo	5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo	5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo	3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo	3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo	3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo	3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC343	Pilar de perfil bajo	3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo	3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo	3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo	3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC441	Pilar de perfil bajo	4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo	4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo	4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo	4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo	4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo	4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo	4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo	4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo	5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo	5,0mm (D) x 1mm (A)

9



..//

LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
MAP32G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 2mm(A)
MAP34G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 4mm(A)
MCA31	Pilar cónico 3,4mm(D) x 1mm(A)
MCA32	Pilar cónico 3,4mm(D) x 2mm(A)
MCA33	Pilar cónico 3,4mm(D) x 3mm(A)
MCA34	Pilar cónico 3,4mm(D) x 4mm(A)
MCAG1	Cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm (D)



..//

MCAG2	Cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm (D)
MCTC1	Cilindro provisorio para pilar cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCTC2	Cilindro provisorio cónico no hexagonal MicroMiniplant™
MHA32	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MHA33	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MHA34	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MHA36	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MHC33	Capuchón cónico de cicatrización 3,4mm(D)
MITC2	Cilindro cono corto de titanio no hexagonal
MLOA001	Pilar Locator 3,4mm (D) x 1mm (A)
MLOA002	Pilar Locator 3,4mm (D) x 2mm (A)
MLOA003	Pilar Locator 3,4mm (D) x 3mm (A)
MLOA004	Pilar Locator 3,4mm (D) x 4mm (A)
MLOA005	Pilar Locator 3,4mm (D) x 5mm (A)
MLOA006	Pilar Locator 3,4mm (D) x 6mm (A)
MMTC1	Cilindro hexagonal provisorio MicroMini c/torn hexagonal
MMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal con retención 3,4mm (D)
MPAP32G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MPAP34G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF34	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF36	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MPFP34	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
MPFP36	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
MPFTC32	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (no hexagonal)
MPFTC34	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (hexagonal)



..//

MT233	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MT236	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MT253	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
MT254	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
MT256	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
MUCC1C	Pilar calcinable hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCC2C	Pilar calcinable no hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal 3,4mm(D)
OSO20	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO20S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO40	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO40S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO60	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSO60S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSOBLK	Repuesto O-Ring negro
OSOCA	Sistema calcinable O-Ring
OSODH	Capuchón O-Ring
OSORED	O-Ring de procesamiento
PA154C	Pilar preangulado 15° - 4mm(A)
PA156C	Pilar preangulado 15° - 6mm(A)
PA254C	Pilar preangulado 25° - 4mm(A)
PA256C	Pilar preangulado 25° - 6mm(A)
PA352 SCREW	Tornillo PA352
PA352C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 2mm(A)



..//

- PA354C Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 4mm(A)
- PA356C Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 6mm(A)
- PAK4140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
- PAK4155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
- PAK4240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
- PAK4255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
- PAK4340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
- PAK4355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
- PAK4440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
- PAK4455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
- PAK5140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
- PAK5155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
- PAK5240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
- PAK5255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
- PAK5340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
- PAK5355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm



..//

- PAK5440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
- PAK5455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
- PAK6155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
- PAK6255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
- PAK6355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
- PAK6455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
- 5  
-  
PAP452G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 2mm
- PAP454G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 4mm
- PAP462G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 2mm
- PAP464G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 4mm
- PAP472G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 2mm
- PAP474G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 4mm
- PAP552G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 2mm
- PAP554G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 4mm
- PAP562G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 2mm
- PAP564G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 4mm





..//

PAP572G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 2mm
PAP574G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 4mm
PAP662G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 2mm
PAP664G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 4mm
PAP672G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 2mm
PAP674G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 4mm
PAPF454	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF456	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF464	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF466	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF474	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF476	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAPF554	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF556	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF564	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF566	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF574	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF576	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)



..//

- PAPF664 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
- PAPF666 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
- PAPF674 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
- PAPF676 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
- PAW00 Arandela para pilar preangulado
- PFP454 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- PFP456 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
- PFP464 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- PFP466 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- PFP474 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- PFP476 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- PFTC41 Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1mm
- PFTC42 Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1mm
- PPC484 Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 4,0mm
- PPC485 Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 5,5mm
- PPC654 Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 4,0mm
- PPC655 Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 5,5mm
- PTC345 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con MAP32G, MAP34G
- PTC347 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con MAP32G, MAP34G
- PTC455 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP452G, APP454G
- PTC457 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP452G, APP454G
- PTC465 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G, WPP564G
- PTC467 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G, WPP564G



..//

- PTC475 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G
- PTC477 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G
- PTC555 Tapa Prep-Tite 5mm: WPP552G, WPP554G
- PTC557 Tapa Prep-Tite 7mm: WPP552G, WPP554G
- PTC665 Tapa Prep-Tite 5mm: WPP662G, WPP664G
- PTC667 Tapa Prep-Tite 7mm: WPP662G, WPP664G
- PUA48M Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) – Unidad múltiple
- PUA48S Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) - Unidad simple
- PUA65M Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad múltiple
- PUA65S Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad simple
- QBCAP Tapa Quick Bridge
- QKBRG Cilindro y tapa Quick Bridge
- SCA001 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 1mm (A)
- SCA002 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 2mm (A)
- SCA003 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 3mm (A)
- SCA004 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 4mm (A)
- SCA055 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 5,5mm (A)
- SGC30 Cilindro oro para pilar estándar
- SGC34 Cilindro plástico calcinable para pilar estándar
- SGUCA1C Cilindro pilar hexagonal ZR UCLA oro estándar 4,1mm (D)
- STC30 Cilindro pilar estándar de titanio
- STGC5 Cilindro oro Sta 4,1mm y 5,0mm (D)
- STGC6 Cilindro oro Sta 6mm (D)
- SWCA51 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x1mm (A)
- SWCA52 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x2mm (A)
- SWCA53 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x3mm (A)
- SWCA54 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x4mm (A)
- SWCA55 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x5,5mm (A)



..//

- SWCA61 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x1mm (A)  
SWCA62 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x2mm (A)  
SWCA63 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x3mm (A)  
SWCA64 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x4mm (A)  
SWCA65 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x5mm (A)  
SWGA51C Cilindro pilar hexagonal ZR estándar oro UCLA 5mm(D)  
SWGA61C Cilindro pilar hexagonal ZR oro UCLA 6mm(D)  
TC300 Cilindro provisorio (pilar estándar)  
TH253 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x3mm(A)  
TH253S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x3mm(A)  
TH254 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x4mm(A)  
TH254S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x4mm(A)  
TH256 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x6mm(A)  
TH256S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x6mm(A)  
TH258 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x8mm(A)  
TH258S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x8mm(A)  
TH263 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x3mm(A)  
TH264 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)  
TH266 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x6mm(A)  
TH268 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x8mm(A)  
TH273 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x3mm (A)  
TH274 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x4mm (A)  
TH276 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x6mm (A)



..//

TH278	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x8mm (A)
THA42	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 2mm(A)
THA43	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 3mm(A)
THA44	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 4mm(A)
THA46	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 6mm(A)
THA48	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 8mm(A)
THA52	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
THA53	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
THA54	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
THA56	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
THA58	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 8mm(A)
THA63	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
THA64	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
THA66	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
THA68	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
THA73	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
THA74	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
THA76	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
THA78	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
THRC4	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 4mm (A)
THRC6	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 6mm (A)
TRC30	Cilindro de retención provisorio
TS250	Tornillo provisorio (pilar estándar) 4,1mm(D)
TSH30	Tornillo de titanio hexagonal de 3mm
TUCA2C	Cilindro pilar UCLA de titanio no hexagonal 4,1mm(D)
UNA125	Pack cilindro UCLA calcinable hexagonal x 25
UNA225	Pack cilindro UCLA calcinable no hexagonal x 25



..//

UNAB1C	Cilindro UCLA calcinable (hexagonal)
UNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal)
UNIHG	Tornillo Uniscrew hexagonal Gold-Tite
UNIHT	Tornillo Uniscrew hexagonal de titanio
UNISG	Tornillo Uniscrew cuadrado Gold-Tite
UNIST	Tornillo Uniscrew cuadrado de titanio
WAB200	Pilar estándar 5mm (D) x 2mm (A)
WAB300	Pilar estándar 5mm (D) x 3mm (A)
WAB400	Pilar estándar 5mm (D) x 4mm (A)
WAB550	Pilar estándar 5mm (D) x 5,5mm(A)
WCA51	Pilar cónico 5mm (D) x1mm(A)
WCA52	Pilar cónico 5mm (D) x2mm(A)
WCA53	Pilar cónico 5mm (D) x3mm(A)
WCA54	Pilar cónico 5mm (D) x4mm(A)
WCA55	Pilar cónico 5mm (D) x5,5mm(A)
WCA62	Pilar cónico 6mm (D) x2mm (A)
WCA63	Pilar cónico 6mm(D)x 3mm(A)
WCA65	Pilar cónico 6mm(D)x 5,5mm(A)
WCS66	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 6mm (P)
WCS67	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 7,5mm (P)
WCTC60	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) hexagonal
WCTC61	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) no hexagonal
WGA51C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 5mm (D)
WGA52C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 5mm (D)
WGA61C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 6mm (D)
WGA62C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 6mm (D)
WOSO20	Pilar O-Ring 5mm (D)x 2mm(A)
WOSO40	Pilar O-Ring 5mm (D)x 4mm(A)
WOSO60	Pilar O-Ring 5mm (D)x 6mm(A)
WPC51C	Pilar UCLA calcinable hexagonal 5mm(D)



..//

- WPC52C Pilar UCLA calcinable no hexagonal 5mm(D)
- WPC61C Pilar UCLA calcinable hexagonal con tornillo hexagonal 6mm(D)
- WPC62C Pilar UCLA calcinable no hexagonal 6mm(D)
- WPP554 Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
- WPP556 Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
- WPP564 Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- WPP566 Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- WPP574 Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- WPP576 Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- WPP664 Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
- WPP666 Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- WPP674 Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
- WPP676 Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- WPFTC51 Cilindro provisorio PreFormance 5mm (hexagonal)
- WPFTC52 Cilindro provisorio PreFormance 5mm (no-hexagonal)
- WPFTC61 Cilindro provisorio PreFormance 6mm (hexagonal)
- WPFTC62 Cilindro provisorio PreFormance 6mm (no-hexagonal)
- WPP552 Poste Prep-Tite 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal
- WPP552G Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 2mm(A)
- WPP554G Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 4mm(A)
- WPP562G Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
- WPP564G Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
- WPP572G Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)
- WPP574G Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
- WPP662 Poste Prep-Tite 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal
- WPP662G Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
- WPP664G Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
- WPP672G Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)



..//

- WPP674G Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
- WT2553 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
- WT2554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
- WT2556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
- WT2558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 8mm(A)
- WT2563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
- WT2564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- WT2566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
- WT2568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
- WT2573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
- WT2574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- WT2576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
- WT2578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
- WT2663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 3mm(A)
- WT2664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 4mm(A)





..//

- WT2666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 6mm(A)
- WT2668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 8mm(A)
- WT2673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
- WT2674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
- WT2676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
- WT2678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
- WTC51 Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D)
- WTC52 Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D).
- WTC61 Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D)
- WTC62 Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D).
- WTCS51 Cilindro provisorio hexagonal 5mm(D) con retención
- WTCS52 Cilindro provisorio no hexagonal 5mm(D) con retención
- WTCS61 Cilindro provisorio hexagonal 6mm(D) con retención
- WTCS62 Cilindro provisorio no hexagonal 6mm(D) con retención
- WTH52 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 2mm(A)
- WTH53 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
- WTH54 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
- WTH56 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
- WTH562 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- WTH563 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)



..//

WTH564	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
WTH566	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
WTH568	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
WTH572	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH573	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)
WTH574	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH576	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH578	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH58	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm (P) x 8mm(A)
WTH62	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm(P) x 2mm(A)
WTH63	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 3mm(A)
WTH64	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 4mm(A)
WTH66	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 6mm(A)
WTH672	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH673	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)
WTH674	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH676	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH678	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH68	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 8mm(A)
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZ	Pilar de diseñador de circonio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode / ZiReal Art
ICZTIS	Tornillo de prueba de circonio Encode / ZiReal Art

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) BIOMET 3i.

2) BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

**0908**

3) CHANGZHOU BIOMET MEDICAL DEVICES CO. LTD.

4) LX Precision (Shanghai) Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: 1) 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, Florida, ESTADOS UNIDOS.

2) Islas Baleares, 50 Poligono Fuente Del Jarro Paterna, 46988, ESPAÑA.

3) Nº 235 Chuangxin Road, Epz Xinbei District, Changzhou City, 213031, CHINA.

4) Bldg. 8, Lane 88; Yuan Shan Road, Minhang Dist. Shanghai - 201108, CHINA.

Expediente Nº 1-47-6308-11-8

DISPOSICIÓN Nº

**0908**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**0908**.....

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. Fabricado por:

BIOMET 3i – 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, Florida, ESTADOS UNIDOS.

BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L. – Islas Baleares, 50 Poligono Fuente Del Jarro – Paterna – España 46988.

CHANGZHOU BIOMET MEDICAL DEVICES Co. Ltd. Nº 235 Chuangxin Road, Epz Xinbei District, Changzhou City, 213031, CHINA

LX PRECISION (SHANGHAI) Co. Ltd. Bldg 8, Lane 88, Yuan Shan Road, Minhang Dist. Shanghai, 201108, CHINA


2. Importado por DENTALMAX S.A. – Av. Santa Fe 2206 3º piso D – Capital Federal - ARGENTINA

3. Componentes protesicos para implantes dentales, Marca: Biomet 3i

Modelo:


Fabricante: **Changzhou Biomet Medical Devices Co. Ltd - CHINA**

WT2668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WT2673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WT2674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WT2676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WT2678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6MM (P) X 6MM(A)
WTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
WTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6MM (P) X 8MM(A)

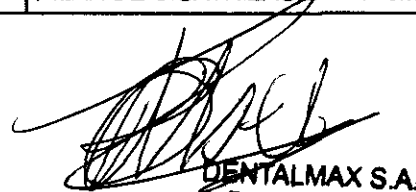  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N: 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060




Fabricante: LX Precision (Shanghai) Co. Ltd. CHINA


CS275	TORNILLO DE CIERRE, SIN CABEZA
CS375	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 4,1MM(D)
CS500	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 5MM(D)
CS600	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 6MM(D)
IMCSF34	Tornillo de cierre plano de 3,4mm (D) para implantes Certain
IMMCS1	TORNILLO DE CIERRE CERTAIN 3,4MM(D)
MMCS1	TORNILLO DE CIERRE PARA IMPLANTE 3,4MM(D)
GS200	TORNILLO ORO C/RANURA -2MM
GS300	TORNILLO ORO C/RANURA -3MM
GSH20	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 2MM
GSH30	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 3MM
GSH70	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 7MM
ILRGHG	TORNILLO GOLD -TITE CERTAIN HEXAGONAL DE DIÁMETRO ANCHO
ILRGHT	TORNILLO DE TITANIO CERTAIN HEXAGONAL DE DIÁMETRO ANCHO
IUNIHG	TORNILLO HEXAGONAL GOLD-TITE CERTAIN
IUNIHT	TORNILLO HEXAGONAL CERTAIN DE TITANIO
LGS30	TORNILLO DE RETENCIÓN CON RANURA ORO LARGO
TSH30	TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL DE 3MM
UNIHG	TORNILLO UNISCREW HEXAGONAL GOLD-TITE
UNIHT	TORNILLO UNISCREW HEXAGONAL DE TITANIO
UNISG	TORNILLO UNISCREW CUADRADO GOLD-TITE
UNIST	TORNILLO UNISCREW CUADRADO DE TITANIO
EHA343	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 3,0MM (A)
EHA344	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4MM (A)
EHA346	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6MM (A)

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
**SANDRA BRÓZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




EHA348	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 8MM (A)
EHA353	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA354	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA356	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA358	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA443	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 3,0MM (A)
EHA444	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 4,0MM (A)
EHA446	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 6,0MM (A)
EHA448	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 8,0MM (A)
EHA453	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA454	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA456	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA458	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA463	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA464	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA466	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA468	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA473	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA474	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA476	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA478	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5MM (D) X 5,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




EHA566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 3,0MM (A)
EHA664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 4,0MM (A)
EHA666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 6,0MM (A)
EHA668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 8,0MM (A)
EHA673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA343	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA344	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA346	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA348	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA353	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA354	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA356	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA358	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA443	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA444	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA446	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA448	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA453	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)

  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA


8060






IEHA454	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA456	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA458	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA463	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA464	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA466	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA468	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA473	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA474	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA476	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA478	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 4,0MM (A)


1

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060


27




IEHA666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IMHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 2MM (A)
IMHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 3MM (A)
IMHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 4MM (A)
IMHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 6MM (A)
ISHA42	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 2mm(A)
ISHA43	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 3mm(A)
ISHA44	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 4mm(A)
ISHA46	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 6mm(A)
ISHA48	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 8mm(A)
ISMHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P)X 2MM(A)
ISMHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P)X 3MM(A)
ISMHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P) X 4MM(A)
ISMHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P) X 6MM(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APC...


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

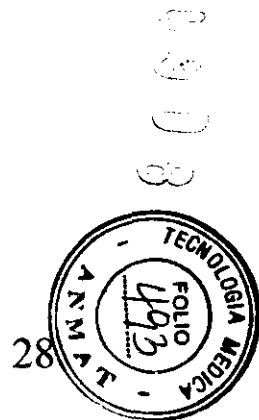


ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 62mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITHA52	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 2MM(A)
ITHA53	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 3MM(A)
ITHA54	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 4MM(A)
ITHA56	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 6MM(A)
ITHA58	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 8MM(A)
ITHA63	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 3MM(A)
ITHA64	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 4MM(A)
ITHA66	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 6MM(A)
ITHA68	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 8MM(A)
ITHA73	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 3MM(A)
ITHA74	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 4MM(A)
ITHA76	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 6MM(A)
ITHA78	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 8MM(A)
IWTH52	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X2MM(A)
IWTH53	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X3MM(A)
IWTH54	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X4MM(A)
IWTH56	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X6MM(A)
IWTH562	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X2MM(A)
IWTH563	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X3MM(A)
IWTH564	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X4MM(A)
IWTH566	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 6MM (P) X 6MM (A)
IWTH568	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 6MM (P) X 8MM (A)
IWTH572	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 2MM (A)
IWTH573	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 3MM (A)
IWTH574	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 4MM (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA




IWTH576	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 6MM (A)
IWTH578	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 8MM (A)
IWTH58	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 5,6MM (P) X 8MM (A)
IWTH62	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 2MM (A)
IWTH63	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 3MM (A)
IWTH64	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 4MM (A)
IWTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 6MM (A)
IWTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 2MM (A)
IWTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 3MM (A)
IWTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 4MM (A)
IWTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 6MM (A)
IWTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 8MM (A)
IWTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 8MM (A)
MHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
MHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 3MM(A)
MHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
MHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MHC33	CAPUCHÓN CÓNICO DE CICATRIZACIÓN MICROMINI 3,4MM(D)
MT233	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 3MM(A)
MT236	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MT253	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 3MM(A)
MT254	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
MT256	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
TH253	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X3MM(A)
TH253S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x3mm
TH254	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X4MM(A)
TH254S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x4mm

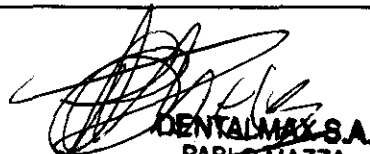  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA


30




09060

TH256	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X6MM(A)
TH256S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x6mm
TH258	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X8MM(A)
TH258S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x8mm
TH263	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X3MM(A)
TH264	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X4MM(A)
TH266	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X6MM(A)
TH268	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X8MM(A)
TH273	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X3MM (A)
TH274	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X4MM (A)
TH276	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X6MM (A)
TH278	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X8MM (A)
THA42	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 2MM(A)
THA43	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 3MM(A)
THA44	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 4MM(A)
THA46	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 6MM(A)
THA48	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 8MM(A)
THA52	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
THA53	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 3MM(A)
THA54	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
THA56	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
THA58	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 8MM(A)
THA63	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
THA64	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
THA66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
THA68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
THA73	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)

1

  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10998  
DIRECTORA TECNICA




0908

THA74	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
THA76	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 6MM(A)
THA78	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 8MM(A)
THRC4	CILINDRO DE RETENCIÓN DE CICATRIZACIÓN PROVISORIO 4,1MM(D) X 4MM (A)
THRC6	CILINDRO DE RETENCIÓN DE CICATRIZACIÓN PROVISORIO 4,1MM(D) X 6MM (A)
WT2553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 3MM(A)
WT2554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 4MM(A)
WT2556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 6MM(A)
WT2558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 8MM(A)
WT2563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
WT2564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
WT2566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
WT2568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WT2573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)
WT2574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
WT2576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 6MM(A)
WT2578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 8MM(A)
WT2663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 3MM(A)
WT2664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 4MM(A)
WT2666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 6MM(A)
WT2668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 8MM(A)
WT2673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)
WT2674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WT2676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WT2678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH52	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 2MM(A)
WTH53	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 3MM(A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10698  
DIRECTORA TECNICA




WTH54	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 4MM(A)
WTH56	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 6MM(A)
WTH562	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
WTH563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
WTH564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
WTH566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
WTH568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WTH572	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 2MM(A)
WTH573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH58	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM (P) X 8MM(A)
WTH62	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM(P) X 2MM(A)
WTH63	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 3MM(A)
WTH64	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 4MM(A)
WTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 6MM(A)
WTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
WTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 8MM(A)
IIOL20S	PILAR IOL CERTAIN 2MM
IIOL30S	PILAR IOL CERTAIN 3MM
IIOL40S	PILAR IOL CERTAIN 4MM
IIOL55S	PILAR IOL CERTAIN 5,5MM


9


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




IOL70S	PILAR IOL CERTAIN 7MM
IOL20T	PILAR CON TORNILLO 2MM IOL 2 PIEZAS
IOL30T	PILAR CON TORNILLO 3MM IOL 2 PIEZAS Todos aconsejan no usar
IOL40T	PILAR CON TORNILLO 4MM IOL 2 PIEZAS
IOL55T	PILAR CON TORNILLO 5,5MM IOL 2 PIEZAS
IOL70T	PILAR CON TORNILLO 7MM IOL 2 PIEZAS
IOLDE	EXTENSIÓN DISTAL IOL
IOLGC	CILINDRO ORO IOL
IOLHC	CAPUCHÓN DE CICATRIZACIÓN IOL
IOLTC	CILINDRO PROVISORIO IOL
GUCA1C	CILINDRO PILAR ORO-HEXAGONAL UCLA 4,1MM (D)
GUCA2C	CILINDRO PILAR ORO NO HEXAGONAL UCLA 4,1MM (D)
GUCA3	PILAR MINIPLANT UCLA ORO CON TORNILLO HEXAGONAL (HEXAGONAL INTERNO)
GUCA3S	TORNILLO PARA PILAR MINIPLANT UCLA ORO (HEXAGONAL INTERNO)
IGUCA1C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO CERTAIN UCLA 4,1MM (D)
IGUCA2C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO CERTAIN UCLA 4,1MM (D) CON TORNILLO DIÁMETRO ANCHO
IGUCA2T	CILINDRO ORO-NO HEXAGONAL UCLA CERTAIN 4,1MM CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IITCS41	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 4,1MM (D)
IITCS42	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 4,1MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IMMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal
IMMTCS2	CILINDRO PROVISORIO DE TITANIO MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
IMUCC2C	Pilar UCLA Certain calcinable no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCC2T	Pilar UCLA Certain calcinable no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG1C	Pilar UCLA Certain oro hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG2C	Pilar UCLA Certain oro no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG2T	Pilar UCLA Certain oro no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCT1	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD SIMPLE CERTAIN

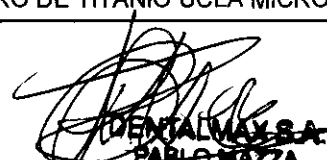  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
**DIRECTORA TECNICA**


34


3908







IMUCT2	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
ITCH0	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO PARA IMPLANTE C/ TORNILLO HEXAGONAL 4,1MM (D)
ITCH1	CILINDRO NO HEXAGONAL PROVISORIO PARA IMPLANTE. C/ TORNILLO HEXAGONAL 4,1MM(D)
ITCS41	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO 4,1MM (D)
ITCS42	CILINDRO NO HEXAGONAL PROVISORIO 4,1MM (D) CON RETENCIÓN
ITUCA1	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD SIMPLE CERTAIN
ITUCA2	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
ITUCA2C	PILAR DE TITANIO-NO HEXAGONAL UCLA CERTAIN 4,1MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IUNAB2C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 4,1MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO GOLD-TITE
IUNAB2T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 4,1MM (D) C/TORNILLO DE TITANIO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA51C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D)
IWGA52C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA52T	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWGA61C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D)
IWGA62C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA62T	CILINDRO NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWPC52C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO GOLD-TITE DE DIÁMETRO ANCHO
IWPC52T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWPC62C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 6MM (D) C/TORNILLO GOLD-TITE DE DIÁMETRO ANCHO
IWPC62T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 6MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWTA51	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD SIMPLE CERTAIN
IWTA52	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
IWTCS51	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 5MM (D)
IWTCS52	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 5MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWTCS61	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 6MM (D)
IWTCS62	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

090  
060  
35  
  
LABORATORIO MÉDICA  
FOLIO 500  
ANNA


MCAT2	CILINDRO DE TITANIO CÓNICO MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE
MMTC1	CILINDRO PROVISORIO 3,4MM (D) CON TORNILLO HEXAGONAL
MMTCS1	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO 3,4MM(D) CON RETENCIÓN
MMTCS2	CILINDRO DE TITANIO PROVISORIO MICROMINI, HEXAGONAL EXTERNO UNIDAD MÚLTIPLE
MUCC1C	PILAR CALCINABLE HEXAGONAL UCLA 3,4MM(D)
MUCC2C	PILAR CALCINABLE NO HEXAGONAL UCLA 3,4MM(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA 3,4MM(D)
MUCT1	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
MUCT2	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE HEXAGONAL EXTERNA
SGUCA1C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR UCLA ORO ESTÁNDAR 4,1MM (D)
SWGGA51C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR ESTÁNDAR ORO UCLA 5MM(D)
SWGGA61C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR ESTÁNDAR ORO UCLA 6MM(D)
TUCA1	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
TUCA2C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL DE TITANIO UCLA 4,1MM(D)
UNA125	CILINDRO UCLA CALCINABLE HEXAGONAL PAQ. DE 25
UNA225	CILINDRO UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL PAQ. DE 25
UNAB1C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (HEXAGONAL)
UNAB2C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL)
WGA51C	CILINDRO PILAR UCLA ORO HEXAGONAL 5MM (D)
WGA52C	CILINDRO PILAR UCLA ORO NO HEXAGONAL 5MM (D)
WGA61C	CILINDRO PILAR UCLA ORO HEXAGONAL 6MM (D)
WGA62C	CILINDRO PILAR UCLA ORO NO HEXAGONAL 6MM (D)
WPC51C	PILAR UCLA CALCINABLE HEXAGONAL 5MM(D)
WPC52C	PILAR UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL 5MM(D)
WPC61C	PILAR UCLA CALCINABLE HEXAGONAL 6MM(D)
WPC62C	PILAR UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL 6MM(D)

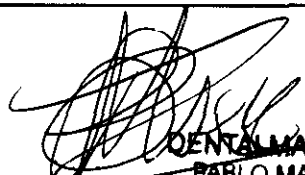
  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA BROZ**  
**M.N. 10898**  
**DIRECTORA TECNICA**


0908  
36  


WTA51	CILINORO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
WTA52	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD MÚLTIPLE HEXAGONAL EXTERNA
WTC51	CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 5MM(D)
WTC52	CILINDRO PARA IMPLANTE NO HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 5MM(D).
WTC61	CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 6MM(D)
WTC62	CILINDRO PARA IMPLANTE NO HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 6MM(D).
WTCS51	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS52	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS61	CILINORO PROVISORIO HEXAGONAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS62	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
IMPAPF34	POSTE PREANGULADO 15° CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPAPF36	POSTE PREANGULADO 15° CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
IMPFP34	POSTE CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPFP36	POSTE CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
IMPFTC32	CILINDRO PROVISORIO CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM (NO HEXAGONAL)
IMPFTC34	CILINDRO PROVISORIO CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM (HEXAGONAL)
IPAPF454	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAPF456	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPAPF554	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAPF556	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPAPF664	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAPF666	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
IPFP454	Poste Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPFP456	Poste Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPFTC41	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1MM (hexagonal)
IPFTC42	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1MM (no hexagonal)
IWPFP554	Poste Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)


  
**DENTAL MAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BRÓZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA


37



IWPF556	Poste Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IWPF664	Poste Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IWPF666	Poste Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
IWPFTC51	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5MM (hexagonal)
IWPFTC52	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5MM (no hexagonal)
IWPFTC61	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6MM (hexagonal)
IWPFTC62	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6MM (no hexagonal)
MPAPF34	POSTE PERFORMANCE PREANGULADO 15° 3,4MM (D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
MPAPF36	POSTE PERFORMANCE PREANGULADO 15° 3,4MM (D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MPFP34	POSTE PERFORMANCE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4MM (A)
MPFP36	POSTE PERFORMANCE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6MM (A)
MPFTC32	CILINDRO PROVISORIO PERFORMANCE DE 3,4MM (NO HEXAGONAL)
MPFTC34	CILINDRO PROVISORIO PERFORMANCE DE 3,4MM (HEXAGONAL)
PAPF454	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM (A)
PAPF456	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM (A)
PAPF554	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM (A)
PAPF556	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM (A)
PAPF664	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM (A)
PAPF666	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM (A)
PFP454	Poste PreFormance de 4,1MM (D) X 5MM (P) X 4MM (A)
PFP456	Poste PreFormance de 4,1MM (D) X 5MM (P) X 6MM (A)
PFTC41	Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1MM
PFTC42	Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1MM
WPF554	Poste PreFormance de 5MM (D) X 5MM (P) X 4MM (A)
WPF556	Poste PreFormance de 5MM (D) X 5MM (P) X 6MM (A)
WPF664	Poste PreFormance de 6MM (D) X 6MM (P) X 4MM (A)
WPF666	Poste PreFormance de 6MM (D) X 6MM (P) X 6MM (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




060

WPFTC51	Cilindro provisorio PreFormance 5MM (hexagonal)
WPFTC52	Cilindro provisorio PreFormance 5MM (no hexagonal)
WPFTC61	Cilindro provisorio PreFormance 6MM (hexagonal)
WPFTC62	Cilindro provisorio PreFormance 6MM (no hexagonal)
AC4217	PILAR CÓNICO ANGULADO 17° - 4,1MM(D) X 2MM(A)
AC4225	PILAR CÓNICO ANGULADO 25° - 4,1MM(D) X 2MM(A)
AC4417	PILAR CÓNICO ANGULADO 17° - 4,1MM(D) X 4MM(A)
AC4425	PILAR CÓNICO ANGULADO 25° - 4,1MM(D) X 4MM(A)
CA001	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 1MM (A)
CA001S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 1MM (A)
CA002	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 2MM (A)
CA002S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 2MM (A)
CA003	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 3MM (A)
CA003S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 3MM (A)
CA004	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 4MM (A)
CA004S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 4MM (A)
CA055	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 5,5MM (A)
CA055S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 5,5MM (A)
CACC5	CILINDRO CÓNICO CALCINABLE NO HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM
CAGC5	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM (D)
CAGC6	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 6MM (D)
CATC5	CILINDRO CÓNICO DE TITANIO NO-HEXAGONAL 4,1MM Y 5,0MM (D)
CC300	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO NO HEXAGONAL
CNC30	CILINDRO CÓNICO PROVISORIO HEXAGONAL.
CNRC5	CILINDRO CÓNICO CALCINABLE HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM(D)
CNRG5	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 4,1 Y 5MM (D)
CNRG6	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 6MM (D)

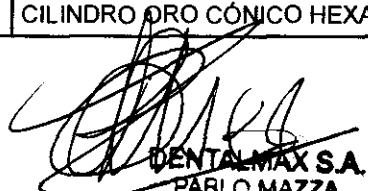  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA

39



CS250	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 5MM (P)
CS260	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 6MM (P)
CS270	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 7,5MM (P)
IAC4217	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 17° 4,1MM(D) X 2MM(A)
IAC4225	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 25° 4,1MM(D) X 2MM(A)
IAC4417	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 17° 4,1MM(D) X 4MM(A)
IAC4425	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 25° 4,1MM(D) X 4MM(A)
ICA001	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 1MM (A)
ICA001S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1 Y 5MM (D) X 1MM (A)
ICA002	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 2MM (A)
ICA002S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 2MM (A)
ICA003	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 3MM (A)
ICA003S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 3MM (A)
ICA004	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 4MM (A)
ICA004S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1 Y 5MM (D) X 4MM (A)
ICA055	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 5,5MM (A)
ICA055S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 5,5MM (A)
IMCA31	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D) X 1MM (A)
IMCA32	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 2MM (A)
IMCA33	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 3MM (A)
IMCA34	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 4MM (A)
IWCA51	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 1MM (A)
IWCA52	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 2MM (A)
IWCA53	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 3MM (A)
IWCA54	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 4MM (A)
IWCA55	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 5,5MM (A)
IWCA61	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 1MM (A)

1

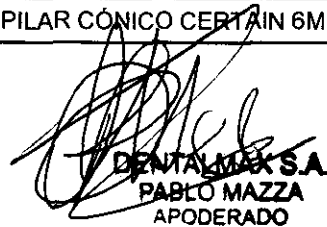  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


40


090

TECNOLOGIA MEDICA  
FOLIO 505  
ANM

IWCA62	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 2MM (A)
IWCA63	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 3MM (A)
IWCA64	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 4MM (A)
IWCA65	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 5,5MM (A)
MCA31	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 1MM(A)
MCA32	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 2MM(A)
MCA33	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 3MM(A)
MCA34	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 4MM(A)
MCAG1	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 3,4MM(D)
MCAG2	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 3,4MM(D)
MCTC1	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO HEXAGONAL
MCTC2	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO NO HEXAGONAL
MITC2	CILINDRO DE TITANIO CONO CORTO NO HEXAGONAL
QBCAP	TAPA QUICKBRIDGE
QKBRG	CILINDRO Y TAPA QUICKBRIDGE
SCA001	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 1MM (A)
SCA002	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 2MM (A)
SCA003	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 3MM (A)
SCA004	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 4MM (A)
SCA055	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 5,5MM (A)
SWCA51	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X1MM (A)
SWCA52	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X2MM (A)
SWCA53	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X3MM (A)
SWCA54	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X4MM (A)
SWCA55	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X5,5MM (A)
SWCA61	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X1MM (A)
SWCA62	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X2MM (A)

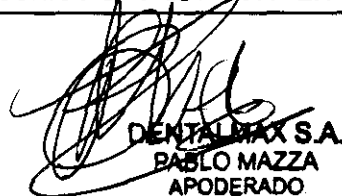
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




8060

SWCA63	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X3MM (A)
SWCA64	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X4MM (A)
SWCA65	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X5,5MM (A)
TRC30	CILINDRO DE RETENCIÓN PROVISORIO
WCA51	PILAR CÓNICO 5MM (D) X1MM(A)
WCA52	PILAR CÓNICO 5MM (D) X2MM(A)
WCA53	PILAR CÓNICO 5MM (D) X3MM(A)
WCA54	PILAR CÓNICO 5MM (D) X4MM(A)
WCA55	PILAR CÓNICO 5MM (D) X5,5MM(A)
WCA62	PILAR CÓNICO 6MM (D) X2MM (A)
WCA63	PILAR CÓNICO 6MM(D)X 3MM(A)
WCA65	PILAR CÓNICO 6MM(D)X 5,5MM(A)
WCS66	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 6MM (D) X 6MM (P)
WCS67	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 6MM (D) X 7,5MM (P)
WCTC60	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO EP 6MM(D)X6MM(P) HEXAGONAL
WCTC61	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO EP 6MM(D)X6MM(P) NO HEXAGONAL
APP42	POSTE PREP-TITE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO HEXAGONAL DE TITANIO
APP452G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
APP454G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
APP462G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
APP464G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
APP472G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
APP474G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IAPP452G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IAPP454G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IAPP462G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IAPP464G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)

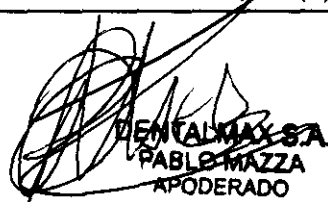  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA






IAPP472G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IAPP474G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IMAP32G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
IMAP34G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPAP32G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
IMPAP34G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IPAP452G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IPAP454G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAP462G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP464G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP472G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP474G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IPAP552G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IPAP554G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAP562G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP564G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP572G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP574G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IPAP662G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP664G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP672G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP674G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IWPP552G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IWPP554G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IWPP562G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IWPP564G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IWPP572G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)

1

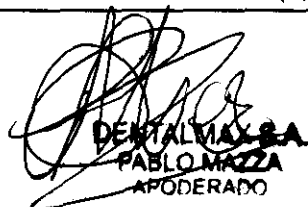
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA




8060


IWPP574G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IWPP662G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IWPP664G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IWPP672G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IWPP674G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
MAP32G	POSTE GINGIHUE 3,4MM(D) X3,8MM(P)X 2MM(A)
MAP34G	POSTE GINGIHUE 3,4MM(D) X3,8MM(P)X 4MM(A)
MPAP32G	POSTE GINGIHUE PREANGULADO 15° 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
MPAP34G	POSTE GINGIHUE PREANGULADO 15° 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
PA154C	PILAR PREANGULADO 15° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA156C	PILAR PREANGULADO 15° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PA254C	PILAR PREANGULADO 25° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA256C	PILAR PREANGULADO 25° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PA352 SCREW	TORNILLO PA352
PA352C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PA354C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA356C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PAP452G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PAP454G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PAP462G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
PAP464G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
PAP472G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP474G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAP552G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PAP554G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PAP562G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
PAP564G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)

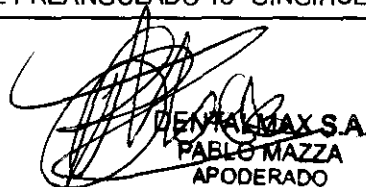  
DENTAMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




PAP572G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP574G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAP662G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
PAP664G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
PAP672G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP674G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAW00	ARANDELA PARA PILAR PREANGULADO
PTC345	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC347	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC455	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC457	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC465	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC467	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC475	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC477	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC555	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC557	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC665	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC667	TAPA PREP-TITE 7MM
WPP552	POSTE PREP-TITE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL
WPP552G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P)X 2MM(A)
WPP554G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P)X 4MM(A)
WPP562G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P)X 2MM(A)
WPP564G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P)X 4MM(A)
WPP572G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P)X 2MM(A)
WPP574G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P)X 4MM(A)
WPP662	POSTE PREP-TITE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



WPP662G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P)X 2MM(A)
WPP664G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P)X 4MM(A)
WPP672G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P)X 2MM(A)
WPP674G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P)X 4MM(A)
AB200	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 2MM (A)
AB200S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 2MM (A)
AB300	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 2MM (A)
AB300S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 3MM (A)
AB400	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 4MM (A)
AB400S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 4MM (A)
AB550	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM (D) X 5,5MM(A)
AB550S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 5,5MM(A)
AB700	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 7MM(A)
AHP72	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 2MM(A)
AHP73	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 3MM(A)
AHP74	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 4MM(A)
CGC30	CILINDRO BISELADO ORO PARA PILAR ESTÁNDAR
IAB200	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 2MM (A)
IAB300	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 3MM (A)
IAB400	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 4MM (A)
IAB550	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 5,5MM (A)
IAB700	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM (D) X 7MM(A)
SGC30	CILINDRO ORO PARA PILAR ESTÁNDAR
SGC34	CILINDRO PLÁSTICO CALCINABLE PARA PILAR ESTÁNDAR
STC30	CILINDRO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO
TC300	CILINDRO PROVISORIO (PILAR ESTÁNDAR)
TS250	TORNILLO PROVISORIO PARA PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D)

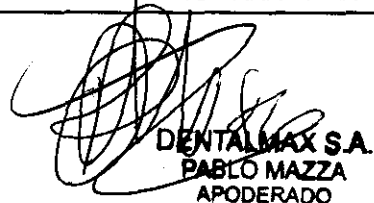  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA




8008

WAB200	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 2MM (A)
WAB300	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 3MM (A)
WAB400	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 4MM (A)
WAB550	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 5,5MM(A)

Fabricante: **BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L - ESPAÑA**


ILPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
ILPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
ILPC341	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC342	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC343	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC344	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC441	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC442	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)

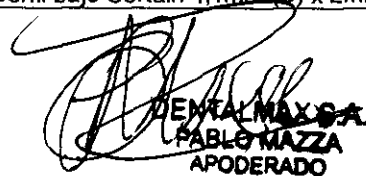  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060


47




ILPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC443	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC444	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC541	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC542	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC543	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC544	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC343	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC441	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCAMI	Instrumento de pulido para pilar de perfil bajo
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCDE	Extensión distal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCLA	Análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo
LPCPIC1	Cofia de impresión Pick-up (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCPIC2	Cofia de impresión Pick-up (no hexagonal) para pilar de perfil bajo

  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060




LPCPP	Protector de pulido para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCRIC	Cofia de impresión para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTIC1	Cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTIC2	Cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo


Fabricante: **BIOMET 3i – ESTADOS UNIDOS**

AB550	Pilar estándar 4,1mm (D) x 5,5mm(A)
AB550S	Tornillo de titanio para pilar estándar 5,5mm(A)
AB700	Pilar estándar 4,1mm(D) x 7mm(A)
AC4217	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4225	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4417	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
AC4425	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
ACSCREW	Tornillo p/pilar cónico angulado 17° y 25° - 4,1mm y 5mm(D) x 2mm y 4mm(A)
AHP72	Poste pilar 4,1mm(D) x 2mm(A)
AHP73	Poste pilar 4,1mm(D) x 3mm(A)
AHP74	Poste pilar 4,1mm(D) x 4mm(A)
APP42	Poste Prep-Tite 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A) c/tornillo hexagonal de titanio

  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


8060

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA






APP452G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
APP454G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
APP462G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 2mm (A)
APP464G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
APP472G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
APP474G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
CA001	Pilar cónico 4,1mm (D)x 1mm (A)
CA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 1mm (A)
CA002	Pilar cónico 4,1mm (D)x 2mm (A)
CA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 2mm (A)
CA003	Pilar cónico 4,1mm (D)x 3mm (A)
CA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 3mm (A)
CA004	Pilar cónico 4,1mm (D)x 4mm (A)
CA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 4mm (A)
CA055	Pilar cónico 4,1mm (D)x 5,5mm (A)
CA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 5,5mm (A)
CACC5	Cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1 x 5mm
CAGC5	Cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (D)
CAGC6	Cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (D)
CATC5	Cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (D)
CC300	Cilindro prov. cónico no hexagonal.
CGC30	Cilindro biselado oro para pilar estándar
CSCM05	Barra para 5 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM06	Barra para 6 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM07	Barra para 7 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM08	Barra para 8 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM09	Barra para 9 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado

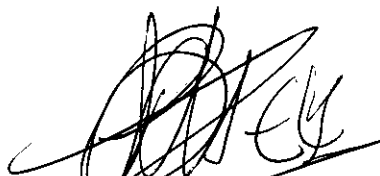
  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA BROZ**  
**M.N. 10898**  
**DIRECTORA TECNICA**

51



CSCM10	Barra para 10 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSD02	Barra Camstructsure Dolder
CSD03	Barra Camstructsure Dolder
CSD04	Barra Camstructsure Dolder
CSD05	Barra Camstructsure Dolder
CSD06	Barra Camstructsure Dolder
CSD07	Barra Camstructsure Dolder
CSD08	Barra Camstructsure Dolder
CSD09	Barra Camstructsure Dolder
CSD10	Barra Camstructsure Dolder
CSH02	Barra Camstructsure Hadar
CSH03	Barra Camstructsure Hadar
CSH04	Barra Camstructsure Hadar
CSH05	Barra Camstructsure Hadar
CSH06	Barra Camstructsure Hadar
CSH07	Barra Camstructsure Hadar
CSH08	Barra Camstructsure Hadar
CSH09	Barra Camstructsure Hadar
CSH10	Barra Camstructsure Hadar
CSHY04	Barra hibrida Camstructsure
CSHY05	Barra hibrida Camstructsure
CSHY06	Barra hibrida Camstructsure
CSHY07	Barra hibrida Camstructsure
CSHY08	Barra hibrida Camstructsure
CSHY09	Barra hibrida Camstructsure
CSHY10	Barra hibrida Camstructsure
CSP02	Barra primaria Camstructsure

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


0908


52

TECNOLOGIA MEDICA  
FOLIO 19  
L. ANNA T.

CSP03	Barra primaria Camstructure
CSP04	Barra primaria Camstructure
CSP05	Barra primaria Camstructure
CSP06	Barra primaria Camstructure
CSP07	Barra primaria Camstructure
CSP08	Barra primaria Camstructure
CSP09	Barra primaria Camstructure
CSP10	Barra primaria Camstructure
DRAF	Conector hembra roscado Dal-Ro
DRCS1	Sistema calcinable Dal-Ro
DRFM1	Conector hembra de metal Dal-Ro
DRH20	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 2mm (A)
DRH40	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 4mm (A)
DRH60	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 6mm (A)
DRTH	Conjunto Dal-Ro de capuchón y conector hembra
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
EHA343	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3,0mm (A)
EHA344	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
EHA346	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
EHA348	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
EHA353	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
EHA354	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
EHA356	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
EHA358	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
EHA443	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




906


EHA444	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)
EHA446	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)
EHA448	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)
EHA453	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
EHA454	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
EHA456	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
EHA458	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
EHA463	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
EHA464	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
EHA466	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
EHA468	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
EHA473	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
EHA474	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
EHA476	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
EHA478	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
EHA553	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)
EHA554	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)
EHA556	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)
EHA558	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)
EHA563	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
EHA564	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
EHA566	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
EHA568	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
EHA573	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
EHA574	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
EHA576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




EHA578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
EHA663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)
EHA664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
EHA666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
EHA668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
EHA673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
EHA674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
EHA676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
EHA678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
GS200	Tomillo oro c/ranura 2mm
GS300	Tornillo oro c/ranura 3mm
GSH20	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 2mm
GSH30	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 3mm
GSH70	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 7mm
GUCA1C	Pilar oro-hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA2C	Pilar oro no hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA3	Pilar Minimplant UCLA oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)
GUCA3S	Tornillo para pilar Minimplant UCLA oro (hexagonal interno)
IAB200	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 2mm (A)
IAB300	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 3mm (A)
IAB400	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 4mm (A)
IAB550	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 5,5mm (A)
IAB700	Pilar estándar Certain 4,1mm (D) x 7mm(A)
IAC4217	Pilar Certain cónico angulado 17°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4225	Pilar Certain cónico angulado 25°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4417	Pilar Certain cónico angulado 17°-4,1mm(D) x 4mm(A)
IAC4425	Pilar Certain cónico angulado 25°-4,1mm(D) x 4mm(A)

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
**DIRECTORA TECNICA**



IAPP452G	Poste GingiHue Certain 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
IAPP454G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 5mm (P) x 4mm (A)
IAPP462G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 2mm (A)
IAPP464G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IAPP472G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IAPP474G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
ICA001	Pilar cónico 4,1mm (D) x 1mm (A) Certain
ICA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 1mm (A)Certain
ICA002	Pilar cónico 4,1mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA003	Pilar cónico 4,1mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA004	Pilar cónico 4,1mm (D) x 4mm (A) Certain
ICA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 4mm (A)Certain
ICA055	Pilar cónico 4,1mm (D) x 5,5mm (A)Certain
ICA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 5,5mm (A)Certain
ICAP454	Poste ZiReal 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
ICAP464	Poste ZiReal 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode
ICZTIS	Tornillo de prueba de circonio Encode
IEHA343	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3mm (A)
IEHA344	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
IEHA346	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
IEHA348	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
IEHA353	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
IEHA354	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

806


IEHA356	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
IEHA358	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
IEHA443	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)
IEHA444	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)
IEHA446	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)
IEHA448	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)
IEHA453	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
IEHA454	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
IEHA456	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
IEHA458	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
IEHA463	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
IEHA464	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IEHA466	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IEHA468	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
IEHA473	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA474	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA476	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA478	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA553	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA554	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA556	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA558	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA563	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
IEHA564	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IEHA566	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IEHA568	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



IEHA573	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA574	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)
IEHA664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
IEHA666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
IEHA668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
IEHA673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IGUCA1C	Cilindro de pilar hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D)
IGUCA2C	Cilindro de pilar no hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D) con tornillo diámetro ancho
IGUCA2T	Pilar oro-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm con tornillo ancho de titanio
IIOL20S	Pilar IOL Certain 2mm
IIOL30S	Pilar IOL Certain 3mm
IIOL40S	Pilar IOL Certain 4mm
IIOL55S	Pilar IOL Certain 5,5mm
IIOL70S	Pilar IOL Certain 7mm
IITCS41	Cilindro provisorio hexagonal Certain 4,1mm (D)
IITCS42	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
ILOA001	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILOA002	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILOA003	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILOA004	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA





ILOA005	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILOA006	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 6mm (A)
ILPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
ILPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
ILPC341	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC342	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC343	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC344	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC441	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC442	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC443	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

59




ILPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC444	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC541	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC542	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC543	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC544	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILRGHG	Tornillo Gold -Tite Certain hexagonal de diámetro ancho
ILRGHT	Tornillo de titanio Certain hexagonal de diámetro ancho
IMAP32G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 2mm(A)
IMAP34G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMCA31	Pilar cónico 3,4mm (D) x 1mm (A) Certain
IMCA32	Pilar cónico 3,4mm (D)x 2mm (A) Certain
IMCA33	Pilar cónico 3,4mm (D)x 3mm (A) Certain
IMCA34	Pilar cónico 3,4mm (D)x 4mm (A) Certain
IMHA32	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 2mm (A)
IMHA33	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 3mm (A)
IMHA34	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 4mm (A)
IMHA36	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 6mm (A)
IMLOA001	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 1mm (A)
IMLOA002	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 2mm (A)
IMLOA003	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 3mm (A)
IMLOA004	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 4mm (A)

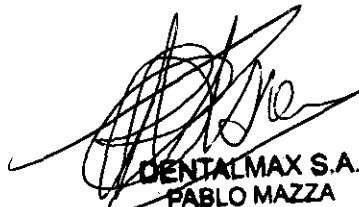  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



  
SANDRA BROZ  
N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


0908



IMLOA005	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 5mm (A)
IMLOA006	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 6mm (A)
IMMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal
IMPAP32G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
IMPAP34G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPAPF34	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPAPF36	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
IMPPF34	Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPPF36	Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
IMPFTC32	Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (no hexagonal)
IMPFTC34	Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (hexagonal)
IMUCC2C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCC2T	Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA Certain 3,4mm(D)
IMUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCG2T	Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IOL20T	Pilar con tornillo 2mm IOL 2 piezas
IOL30T	Pilar con tornillo 3mm IOL 2 piezas
IOL40T	Pilar con tornillo 4mm IOL 2 piezas
IOL55T	Pilar con tornillo 5,5mm IOL 2 piezas
IOL70T	Pilar con tornillo 7mm IOL 2 piezas
IOLDE	Extensión distal IOL
IOLGC	Cilindro oro IOL
IOLHC	Capuchón de cicatrización IOL
IOLTC	Cilindro provisorio IOL
IPA4140	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4155	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 5,5mm

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BRÓZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA

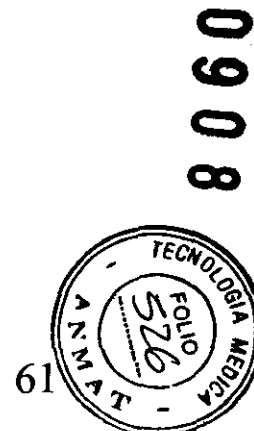

IPA4240	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4255	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 5,5mm
IPA4340	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4355	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) – Poste 5,5mm
IPA4440	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4455	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) – Post 5,5mm
IPA5140	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5155	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5240	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5255	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5340	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5355	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5440	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5455	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6140	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6155	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6240	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6255	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6340	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6355	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6440	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6455	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
IPAP452G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IPAP454G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAP462G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


0909

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

62


TECNOLOGIA MEDICA  
FOLIO 527  
L. ANNA

IPAP464G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAP472G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IPAP474G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAP552G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IPAP554G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAP562G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IPAP564G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAP572G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)
IPAP574G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAP662G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x2mm(A)
IPAP664G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
IPAP672G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)
IPAP674G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAPF454	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF456	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF464	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF466	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF474	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF476	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF554	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF556	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF564	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF566	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF574	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF576	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF664	Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

0908


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




IPAPF666	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF674	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF676	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPFP454	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPFP456	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPFP464	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPFP466	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPFP474	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPFP476	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPFTC41	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (hexagonal)
IPFTC42	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (no hexagonal)
ISHA42	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 2mm(A)
ISHA43	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 3mm(A)
ISHA44	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 4mm(A)
ISHA46	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 6mm(A)
ISHA48	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 8mm(A)
ISMHA32	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 2mm(A)
ISMHA33	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 3mm(A)
ISMHA34	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 4mm(A)
ISMHA36	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 6mm(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

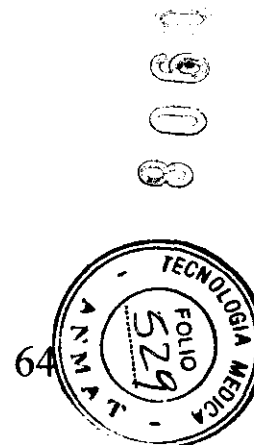


ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITCHO	Cilindro provisorio para implante hexagonal c/ tornillo hexagonal 4,1mm
ITCH1	Cilindro provisorio para implante no hexagonal. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(D)
ITCS41	Cilindro provisorio hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITCS42	Cilindro provisorio no hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITHA52	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 2mm(A)
ITHA53	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 3mm(A)
ITHA54	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 4mm(A)
ITHA56	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 6mm(A)
ITHA58	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 8mm(A)
ITHA63	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 3mm(A)
ITHA64	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 4mm(A)
ITHA66	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 6mm(A)
ITHA68	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 8mm(A)
ITHA73	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 3mm(A)
ITHA74	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 4mm(A)
ITHA76	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 6mm(A)
ITHA78	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 8mm(A)
ITUCA2C	Pilar de titanio-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IUNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de diámetro ancho Gold-Tite
IUNAB2T	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de titanio de diámetro ancho
IUNIHG	Tornillo hexagonal Gold-Tite Certain
IUNIHT	Tornillo hexagonal Certain de titanio
IWCA51	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 1mm (A)
IWCA52	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 2mm (A)




**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

8060



**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



IWCA53	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 3mm (A)
IWCA54	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 4mm (A)
IWCA55	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 5mm (A)
IWCA61	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 1mm (A)
IWCA62	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 2mm (A)
IWCA63	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 3mm (A)
IWCA64	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 4mm (A)
IWCA65	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 5,5mm (A)
IWCAP564	Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal
IWCAP574	Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal
IWGA51C	Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D)
IWGA52C	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWGA52T	Pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWGA61C	Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D)
IWGA62C	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWGA62T	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho de titanio
IWPC52C	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho
IWPC52T	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWPC62C	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho
IWPC62T	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWFPF554	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IWFPF556	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IWFPF564	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWFPF566	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IWFPF574	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWFPF576	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IWFPF664	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

0908



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



66



IWFP666	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IWFP674	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWFP676	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IWPFTC51	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (hexagonal)
IWPFTC52	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (no hexagonal)
IWPFTC61	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (hexagonal)
IWPFTC62	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (no hexagonal)
IWPP552G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IWPP554G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IWPP562G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IWPP564G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWPP572G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IWPP574G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWPP662G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IWPP664G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWPP672G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IWPP674G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWTCS51	Cilindro provisorio hexagonal Certain 5mm (D)
IWTCS52	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWTCS61	Cilindro provisorio hexagonal Certain 6mm (D)
IWTCS62	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWTH52	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x2mm(A)
IWTH53	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x3mm(A)
IWTH54	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x4mm(A)
IWTH56	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x6mm(A)
IWTH562	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x2mm(A)
IWTH563	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x3mm(A)
IWTH564	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x4mm(A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


0908



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




IWTH566	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IWTH568	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
IWTH572	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IWTH573	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IWTH574	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IWTH576	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IWTH578	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IWTH58	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 5,6mm (P) x 8mm (A)
IWTH62	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 2mm (A)
IWTH63	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 3mm (A)
IWTH64	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 4mm (A)
IWTH66	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 6mm (A)
IWTH672	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IWTH673	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IWTH674	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IWTH676	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IWTH678	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IWTH68	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 8mm (A)
IZSHG	Tomillo para pilar hexagonal Gold-Tite para poste Certain ZiReal
LAELM	Machos de retención extra ligeros Locator - Pack x 4
LAERM	Machos de rango extendido Locator - Pack x 4
LARMS	Machos de repuesto Locator - Pack x 4
LELARM	Machos de repuesto angulados extra ligeros Locator - Pack x4.
LGS30	Tornillo de retención con ranura oro largo
LLRMS	Machos de retención ligera Locator - Pack x 4
LOA001	Pilar Locator 1mm
LOA002	Pilar Locator 2mm


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO


0908

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA




LOA003	Pilar Locator 3mm
LOA004	Pilar Locator 4mm
LOA005	Pilar Locator 5mm
LOA006	Pilar Locator 6mm
LOAB	Accesorio Locator
LOAH	Cazoleta de repuesto Locator
LORHK	Kit de cazoletas de repuesto Locator
LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC343	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


8060



LPC441	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0908  
70  


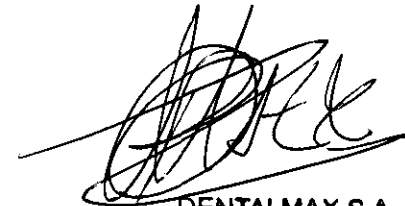
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
MAP32G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 2mm(A)
MAP34G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 4mm(A)
MCA31	Pilar cónico 3,4mm(D) x 1mm(A)
MCA32	Pilar cónico 3,4mm(D) x 2mm(A)
MCA33	Pilar cónico 3,4mm(D) x 3mm(A)
MCA34	Pilar cónico 3,4mm(D) x 4mm(A)
MCAG1	Cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCAG2	Cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm (D)
MCTC1	Cilindro provisorio para pilar cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCTC2	Cilindro provisorio cónico no hexagonal MicroMiniplant™
MHA32	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MHA33	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MHA34	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MHA36	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MHC33	Capuchón cónico de cicatrización 3,4mm(D)
MITC2	Cilindro cono corto de titanio no hexagonal
MLOA001	Pilar Locator 3,4mm (D) x 1mm (A)
MLOA002	Pilar Locator 3,4mm (D) x 2mm (A)
MLOA003	Pilar Locator 3,4mm (D) x 3mm (A)
MLOA004	Pilar Locator 3,4mm (D) x 4mm (A)
MLOA005	Pilar Locator 3,4mm (D) x 5mm (A)
MLOA006	Pilar Locator 3,4mm (D) x 6mm (A)
MMTC1	Cilindro hexagonal provisorio MicroMini c/tom hexagonal
MMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal con retención 3,4mm (D)
MPAP32G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



MPAP34G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF34	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF36	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MPFP34	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
MPFP36	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
MPFTC32	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (no hexagonal)
MPFTC34	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (hexagonal)
MT233	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MT236	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MT253	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
MT254	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
MT256	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
MUCC1C	Pilar calcinable hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCC2C	Pilar calcinable no hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal 3,4mm(D)
OSO20	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO20S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO40	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO40S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO60	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSO60S	Tomillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSOBK	Repuesto O-Ring negro
OSOCA	Sistema calcinable O-Ring
OSODH	Capuchón O-Ring
OSORED	O-Ring de procesamiento
PA154C	Pilar preangulado 15° - 4mm(A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

0908




SANDRA PROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


72




PA156C	Pilar preangulado 15° - 6mm(A)
PA254C	Pilar preangulado 25° - 4mm(A)
PA256C	Pilar preangulado 25° - 6mm(A)
PA352 SCREW	Tornillo PA352
PA352C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 2mm(A)
PA354C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 4mm(A)
PA356C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 6mm(A)
PAK4140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK4155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK4240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
PAK4255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK4340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK4355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK4440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK4455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAK5140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK5155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK5240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
PAK5255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK5340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK5355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK5440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK5455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAK6140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK6155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK6240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

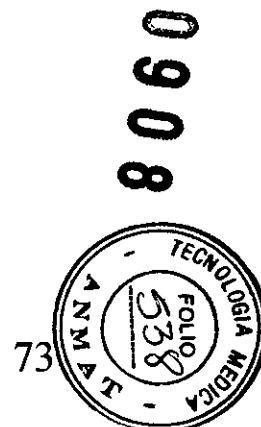


PAK6255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK6340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK6355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK6440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK6455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAP452G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 2mm
PAP454G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 4mm
PAP462G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 2mm
PAP464G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 4mm
PAP472G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 2mm
PAP474G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 4mm
PAP552G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 2mm
PAP554G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 4mm
PAP562G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 2mm
PAP564G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 4mm
PAP572G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 2mm
PAP574G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 4mm
PAP662G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 2mm
PAP664G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 4mm
PAP672G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 2mm
PAP674G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 4mm
PAPF454	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF456	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF464	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF466	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF474	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


0908

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA






PAPF476	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAPF554	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF556	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF564	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF566	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF574	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF576	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAPF664	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF666	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF674	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF676	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAW00	Arandela para pilar preangulado
PFP454	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
PFP456	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
PFP464	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
PFP466	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
PFP474	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
PFP476	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
PFTC41	Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1mm
PFTC42	Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1mm
PPC484	Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 4,0mm
PPC485	Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 5,5mm
PPC654	Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 4,0mm
PPC655	Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 5,5mm
PTC345	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con MAP32G, MAP34G
PTC347	Tapa Prep-Tite 7mm: usar con MAP32G, MAP34G
PTC455	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP452G, APP454G

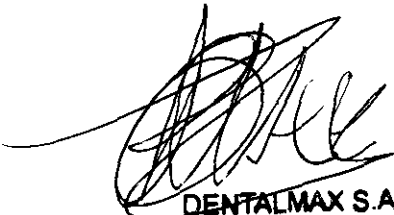  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


8060

  
**SANDRA BROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

75




PTC457	Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP452G, APP454G
PTC465	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G, WPP564G
PTC467	Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G, WPP564G
PTC475	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G
PTC477	Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G
PTC555	Tapa Prep-Tite 5mm: WPP552G, WPP554G
PTC557	Tapa Prep-Tite 7mm: WPP552G, WPP554G
PTC665	Tapa Prep-Tite 5mm: WPP662G, WPP664G
PTC667	Tapa Prep-Tite 7mm: WPP662G, WPP664G
PUA48M	Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) – Unidad múltiple
PUA48S	Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) - Unidad simple
PUA65M	Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad múltiple
PUA65S	Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad simple
QBCAP	Tapa Quick Bridge
QKBRG	Cilindro y tapa Quick Bridge
SCA001	Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 1mm (A)
SCA002	Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 2mm (A)
SCA003	Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 3mm (A)
SCA004	Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 4mm (A)
SCA055	Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 5,5mm (A)
SGC30	Cilindro oro para pilar estándar
SGC34	Cilindro plástico calcinable para pilar estándar
SGUCA1C	Cilindro pilar hexagonal ZR UCLA oro estándar 4,1mm (D)
STC30	Cilindro pilar estándar de titanio
STGC5	Cilindro oro Sta 4,1mm y 5,0mm (D)
STGC6	Cilindro oro Sta 6mm (D)
SWCA51	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x1mm (A)

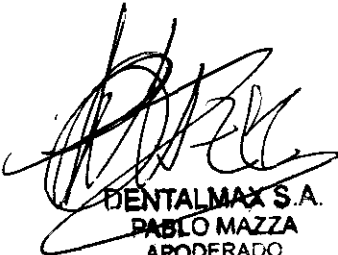  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

090

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

76



SWCA52	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x2mm (A)
SWCA53	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x3mm (A)
SWCA54	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x4mm (A)
SWCA55	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x5,5mm (A)
SWCA61	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x1mm (A)
SWCA62	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x2mm (A)
SWCA63	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x3mm (A)
SWCA64	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x4mm (A)
SWCA65	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x5mm (A)
SWGA51C	Cilindro pilar hexagonal ZR estándar oro UCLA 5mm(D)
SWGA61C	Cilindro pilar hexagonal ZR oro UCLA 6mm(D)
TC300	Cilindro provisorio (pilar estándar)
TH253	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x3mm(A)
TH253S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep@ 4,1mm (D) x 5mm(P)x3mm(A)
TH254	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x4mm(A)
TH254S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep@ 4,1mm (D) x 5mm(P)x4mm(A)
TH256	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x6mm(A)
TH256S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep@ 4,1mm (D) x 5mm(P)x6mm(A)
TH258	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x8mm(A)
TH258S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep@ 4,1mm (D) x 5mm(P)x8mm(A)
TH263	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x3mm(A)
TH264	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
TH266	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x6mm(A)
TH268	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x8mm(A)
TH273	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x3mm (A)
TH274	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x4mm (A)
TH276	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x6mm (A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




7

TH278	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x8mm (A)
THA42	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 2mm(A)
THA43	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 3mm(A)
THA44	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 4mm(A)
THA46	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 6mm(A)
THA48	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 8mm(A)
THA52	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
THA53	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
THA54	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
THA56	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
THA58	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 8mm(A)
THA63	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
THA64	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
THA66	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
THA68	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
THA73	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
THA74	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
THA76	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
THA78	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
THRC4	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 4mm (A)
THRC6	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 6mm (A)
TRC30	Cilindro de retención provisorio
TS250	Tornillo provisorio (pilar estándar) 4,1mm(D)
TSH30	Tornillo de titanio hexagonal de 3mm
TUCA2C	Cilindro pilar UCLA de titanio no hexagonal 4,1mm(D)
UNA125	Pack cilindro UCLA calcinable hexagonal x 25
UNA225	Pack cilindro UCLA calcinable no hexagonal x 25


?

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




UNAB1C	Cilindro UCLA calcinable (hexagonal)
UNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal)
UNIHG	Tornillo Uniscrew hexagonal Gold-Tite
UNIHT	Tornillo Uniscrew hexagonal de titanio
UNISG	Tornillo Uniscrew cuadrado Gold-Tite
UNIST	Tornillo Uniscrew cuadrado de titanio
WAB200	Pilar estándar 5mm (D) x 2mm (A)
WAB300	Pilar estándar 5mm (D) x 3mm (A)
WAB400	Pilar estándar 5mm (D) x 4mm (A)
WAB550	Pilar estándar 5mm (D) x 5,5mm(A)
WCA51	Pilar cónico 5mm (D) x1mm(A)
WCA52	Pilar cónico 5mm (D) x2mm(A)
WCA53	Pilar cónico 5mm (D) x3mm(A)
WCA54	Pilar cónico 5mm (D) x4mm(A)
WCA55	Pilar cónico 5mm (D) x5,5mm(A)
WCA62	Pilar cónico 6mm (D) x2mm (A)
WCA63	Pilar cónico 6mm(D)x 3mm(A)
WCA65	Pilar cónico 6mm(D)x 5,5mm(A)
WCS66	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 6mm (P)
WCS67	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 7,5mm (P)
WCTC60	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) hexagonal
WCTC61	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) no hexagonal
WGA51C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 5mm (D)
WGA52C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 5mm (D)
WGA61C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 6mm (D)
WGA62C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 6mm (D)
WOSO20	Pilar O-Ring 5mm (D)x 2mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

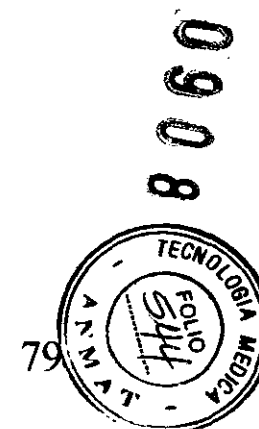


WOSO40	Pilar O-Ring 5mm (D)x 4mm(A)
WOSO60	Pilar O-Ring 5mm (D)x 6mm(A)
WPC51C	Pilar UCLA calcinable hexagonal 5mm(D)
WPC52C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal 5mm(D)
WPC61C	Pilar UCLA calcinable hexagonal con tornillo hexagonal 6mm(D)
WPC62C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal 6mm(D)
WFP554	Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
WFP556	Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
WFP564	Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
WFP566	Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
WFP574	Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
WFP576	Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
WFP664	Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
WFP666	Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
WFP674	Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
WFP676	Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
WPFTC51	Cilindro provisorio PreFormance 5mm (hexagonal)
WPFTC52	Cilindro provisorio PreFormance 5mm (no-hexagonal)
WPFTC61	Cilindro provisorio PreFormance 6mm (hexagonal)
WPFTC62	Cilindro provisorio PreFormance 6mm (no-hexagonal)
WPP552	Poste Prep-Tite 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal
WPP552G	Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 2mm(A)
WPP554G	Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 4mm(A)
WPP562G	Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
WPP564G	Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
WPP572G	Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)
WPP574G	Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
WPP662	Poste Prep-Tite 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060


  
SANDRA BROZ  
M.D. 10898  
DIRECTORA TECNICA




WPP662G	Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
WPP664G	Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
WPP672G	Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)
WPP674G	Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
WT2553	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
WT2554	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
WT2556	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
WT2558	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 8mm(A)
WT2563	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
WT2564	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
WT2566	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
WT2568	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
WT2573	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
WT2574	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
WT2576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
WT2578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
WT2663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 3mm(A)
WT2664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 4mm(A)
WT2666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 6mm(A)
WT2668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 8mm(A)
WT2673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
WT2674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WT2676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WT2678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTC51	Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D)
WTC52	Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D).

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



WTC61	Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D)
WTC62	Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D).
WTCS51	Cilindro provisorio hexagonal 5mm(D) con retención
WTCS52	Cilindro provisorio no hexagonal 5mm(D) con retención
WTCS61	Cilindro provisorio hexagonal 6mm(D) con retención
WTCS62	Cilindro provisorio no hexagonal 6mm(D) con retención
WTH52	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 2mm(A)
WTH53	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
WTH54	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
WTH56	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
WTH562	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
WTH563	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
WTH564	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
WTH566	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
WTH568	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
WTH572	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH573	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)
WTH574	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH576	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH578	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH58	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm (P) x 8mm(A)
WTH62	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm(P) x 2mm(A)
WTH63	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 3mm(A)
WTH64	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 4mm(A)
WTH66	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 6mm(A)
WTH672	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH673	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA

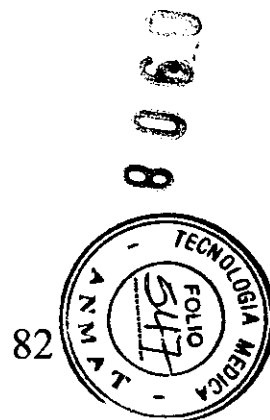



WTH674	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH676	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH678	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH68	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 8mm(A)
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZ	Pilar de diseñador de circonio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode / ZiReal Art
ICZTIS	Tornillo de prueba de circonio Encode / ZiReal Art

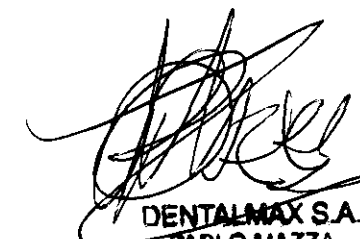
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

4. Director técnico: Farmaceutica Sandra Broz – MN 10898
5. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-707-20.
6. Condición de venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS


### Instrucciones de Uso

Los pilares dentales y las barras de sobre dentaduras de BIOMET 3i están concebidos para utilizarse sobre los implantes dentales endoosseos con el fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados. Están diseñados para utilizarse como soportes de prótesis de uno o varios dientes, en el maxilar inferior o en el maxilar superior. Las prótesis pueden atornillarse o cementarse al pilar.

Los postes de pilares y los cilindros provisionales están concebidos para utilizarse como sobre los implantes dentales endoosseos a fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados. Están diseñados para utilizarse como soportes de prótesis unitarias de unidades múltiples en el maxilar inferior o en el maxilar superior por un tiempo máximo de 180 días durante la cicatrización endoossea y gingival, y son para carga no oclusal de prótesis provisionales unitarias y de unidades múltiples.

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA

83



0908

Las prótesis pueden atornillarse y/o cementarse al pilar. Estos postes y cilindros provisionales requieren un espacio inter-arcada mínimo de 6mm y una angulación máxima de 15°. También permiten la carga oclusal de prótesis unitarias y de unidades múltiples de implantes ya integrados para la cicatrización guiada del tejido blando.

Los componentes provisionales están concebidos para acoplarse con los pilares cónicos BIOMET 3i y utilizarse sobre los implantes dentales endoóseos con el fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados.

Los componentes provisionales están diseñados para conferir soporte a prótesis de unidades múltiples en el maxilar inferior o en el maxilar superior por un tiempo máximo de 180 días durante la cicatrización endoósea y gingival.


#### Precauciones

- Para la segura y efectiva utilización de los mismos, los pilares deben ser utilizados solamente por profesionales entrenados.
- La prótesis dental solo debe ser utilizada luego de un análisis detallado del procedimiento que se adopte.
- El uso en conjunción con componentes de otros fabricantes puede dar lugar a incongruencia entre los componentes.
- El paciente debe tener control médico periódico para verificar las condiciones de la prótesis dental.
- La inadecuada esterilización de los instrumentos utilizados en el procedimiento puede causar infección de prótesis.

#### Contraindicaciones:

- La colocación de implantes dentales puede tenerse que descartar si el paciente presenta afecciones que contraindiquen el empleo de cirugía. Los implantes dentales de BIOMET 31 no deben colocarse en pacientes en los que no quede hueso maxilar suficiente para permitir lograr una estabilidad adecuada del implante.

1

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

Advertencias:

- Cuando un pilar se cargue mas de lo que permita su capacidad funcional, pueden producirse porosidad óseas excesivas o roturas de implantes dentales o de dispositivos protésicos. Las condiciones fisiológicas y anatómicas pueden afectar negativamente a la eficacia de las prótesis dentales.

La manipulación incorrecta de componentes pequeños en el interior de la boca del paciente conlleva riesgo de aspiración o ingestión.

Almacenamiento

El producto en su envase primario tipo blister se embala en un envase secundario de cartón correctamente etiquetado para su identificación.

Los dispositivos deben almacenarse a temperatura ambiente.


Periodo de vida útil

5 años


Formas de presentación

Los pilares son envasados en forma individual en empaque tipo blister, y se comercializan no esterilizados.



  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BRÓZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



8060

**PROYECTO DE ROTULO**

7. Fabricado por:

BIOMET 3i – 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, Florida, ESTADOS UNIDOS.

BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L. – Islas Baleares, 50 Poligono Fuente Del Jarro – Paterna – España 46988.

CHANGZHOU BIOMET MEDICAL DEVICES Co. Ltd. N° 235 Chuangxin Road, Epz Xinbei District, Changzhou City, 213031, CHINA

LX PRECISION (SHANGHAI) Co. Ltd. Bldg 8, Lane 88, Yuan Shan Road, Minhang Dist. Shanghai, 201108, CHINA


8. Importado por DENTALMAX S.A. – Av. Santa Fe 2206 3° piso D – Capital Federal - ARGENTINA

9. Componentes protesicos para implantes dentales, Marca: Biomet 3i

Modelo:

Fabricante: **Changzhou Biomet Medical Devices Co. Ltd - CHINA**

WT2668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WT2673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WT2674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WT2676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WT2678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6MM (P) X 6MM(A)
WTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
WTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6MM (P) X 8MM(A)

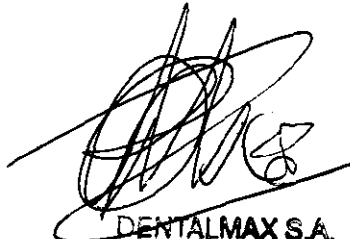


DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060




SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA



Fabricante: LX Precision (Shanghai) Co. Ltd. CHINA


CS275	TORNILLO DE CIERRE, SIN CABEZA
CS375	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 4,1MM(D)
CS500	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 5MM(D)
CS600	TORNILLO DE CIERRE – IMPLANTE 6MM(D)
IMCSF34	Tornillo de cierre plano de 3,4mm (D) para implantes Certain
IMMCS1	TORNILLO DE CIERRE CERTAIN 3,4MM(D)
MMCS1	TORNILLO DE CIERRE PARA IMPLANTE 3,4MM(D)
GS200	TORNILLO ORO C/RANURA -2MM
GS300	TORNILLO ORO C/RANURA -3MM
GSH20	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 2MM
GSH30	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 3MM
GSH70	TORNILLO DE RETENCIÓN HEXAGONAL GOLD-TITE 7MM
ILRGHG	TORNILLO GOLD -TITE CERTAIN HEXAGONAL DE DIÁMETRO ANCHO
ILRGHT	TORNILLO DE TITANIO CERTAIN HEXAGONAL DE DIÁMETRO ANCHO
IUNIHG	TORNILLO HEXAGONAL GOLD-TITE CERTAIN
IUNIHT	TORNILLO HEXAGONAL CERTAIN DE TITANIO
LGS30	TORNILLO DE RETENCIÓN CON RANURA ORO LARGO
TSH30	TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL DE 3MM
UNIHG	TORNILLO UNISCREW HEXAGONAL GOLD-TITE
UNIHT	TORNILLO UNISCREW HEXAGONAL DE TITANIO
UNISG	TORNILLO UNISCREW CUADRADO GOLD-TITE
UNIST	TORNILLO UNISCREW CUADRADO DE TITANIO
EHA343	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 3,0MM (A)
EHA344	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4MM (A)
EHA346	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6MM (A)

1


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


87



EHA348	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 8MM (A)
EHA353	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA354	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA356	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA358	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA443	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 3,0MM (A)
EHA444	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 4,0MM (A)
EHA446	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 6,0MM (A)
EHA448	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 8,0MM (A)
EHA453	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA454	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA456	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA458	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA463	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA464	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
EHA466	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA468	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA473	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA474	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA476	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA478	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5MM (D) X 5,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
EHA564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)

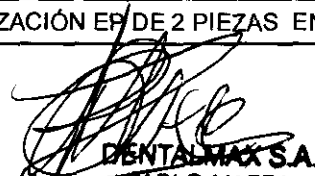  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10896  
DIRECTORA TECNICA




EHA566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
EHA568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
EHA573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
EHA663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 3,0MM (A)
EHA664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 4,0MM (A)
EHA666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 6,0MM (A)
EHA668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 8,0MM (A)
EHA673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
EHA674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
EHA676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
EHA678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA343	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA344	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA346	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA348	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA353	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA354	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA356	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA358	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 3,4MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA443	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA444	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA446	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA448	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 4,1MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA453	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 3,0MM (A)

*[Handwritten Signature]*

DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

0908

*[Handwritten Signature]*  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



IEHA454	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA456	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA458	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 5,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA463	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA464	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA466	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA468	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA473	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA474	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA476	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA478	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 4,1MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 5,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 6,0MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 5,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 4,0MM (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060


  
SANDRA BROZ  
M.N. 1089  
DIRECTORA TÉCNICA  
FOLIO 555  
TAMNAT  
MEDICINA  
90



IEHA666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 6,6MM (P) X 8,0MM (A)
IEHA673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 3,0MM (A)
IEHA674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 4,0MM (A)
IEHA676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 6,0MM (A)
IEHA678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS CERTAIN ENCODE DE 6,0MM (D) X 7,5MM (P) X 8,0MM (A)
IMHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 2MM (A)
IMHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 3MM (A)
IMHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 4MM (A)
IMHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN 3,4MM (D) X 3,8MM (P) 6MM (A)
ISHA42	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 2mm(A)
ISHA43	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 3mm(A)
ISHA44	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 4mm(A)
ISHA46	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 6mm(A)
ISHA48	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 8mm(A)
ISMHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P)X 2MM(A)
ISMHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P)X 3MM(A)
ISMHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P) X 4MM(A)
ISMHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN RECTO CERTAIN 3,4MM(D) X 3,4MM (P) X 6MM(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 62mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITHA52	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 2MM(A)
ITHA53	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 3MM(A)
ITHA54	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 4MM(A)
ITHA56	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 6MM(A)
ITHA58	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 5MM (P)X 8MM(A)
ITHA63	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 3MM(A)
ITHA64	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 4MM(A)
ITHA66	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 6MM(A)
ITHA68	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 6MM (P)X 8MM(A)
ITHA73	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 3MM(A)
ITHA74	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 4MM(A)
ITHA76	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 6MM(A)
ITHA78	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 4,1MM (D) X 7,5MM (P)X 8MM(A)
IWTH52	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X2MM(A)
IWTH53	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X3MM(A)
IWTH54	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X4MM(A)
IWTH56	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 5,6MM (P)X6MM(A)
IWTH562	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X2MM(A)
IWTH563	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X3MM(A)
IWTH564	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM(D)X 6MM (P)X4MM(A)
IWTH566	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 6MM (P) X 6MM (A)
IWTH568	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 6MM (P) X 8MM (A)
IWTH572	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 2MM (A)
IWTH573	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 3MM (A)
IWTH574	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 4MM (A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0  
8




IWTH576	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 6MM (A)
IWTH578	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 7,5MM (P) X 8MM (A)
IWTH58	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 5MM (D) X 5,6MM (P) X 8MM (A)
IWTH62	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 2MM (A)
IWTH63	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 3MM (A)
IWTH64	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 4MM (A)
IWTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 6MM (A)
IWTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 2MM (A)
IWTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 3MM (A)
IWTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 4MM (A)
IWTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 6MM (A)
IWTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 7,5MM (P) X 8MM (A)
IWTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN CERTAIN EP 6MM (D) X 6,8MM (P) X 8MM (A)
MHA32	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
MHA33	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 3MM(A)
MHA34	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
MHA36	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MHC33	CAPUCHÓN CÓNICO DE CICATRIZACIÓN MICROMINI 3,4MM(D)
MT233	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 3MM(A)
MT236	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MT253	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 3MM(A)
MT254	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
MT256	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 3,4MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
TH253	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X3MM(A)
TH253S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x3mm
TH254	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X4MM(A)
TH254S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x4mm

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
C.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


0908




TH256	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X6MM(A)
TH256S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x6mm
TH258	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 5MM(P)X8MM(A)
TH258S	TORNILLO PARA PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1x5x8mm
TH263	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X3MM(A)
TH264	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X4MM(A)
TH266	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X6MM(A)
TH268	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 6MM(P)X8MM(A)
TH273	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X3MM (A)
TH274	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X4MM (A)
TH276	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X6MM (A)
TH278	PILAR DE CICATRIZACIÓN DE 2 PIEZAS EP 4,1MM(D)X 7,5MM(P)X8MM (A)
THA42	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 2MM(A)
THA43	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 3MM(A)
THA44	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 4MM(A)
THA46	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 6MM(A)
THA48	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 4,1MM(P) X 8MM(A)
THA52	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
THA53	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 3MM(A)
THA54	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
THA56	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
THA58	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 5MM(P) X 8MM(A)
THA63	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
THA64	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
THA66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
THA68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
THA73	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




THA74	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
THA76	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 6MM(A)
THA78	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 8MM(A)
THRC4	CILINDRO DE RETENCIÓN DE CICATRIZACIÓN PROVISORIO 4,1MM(D) X 4MM (A)
THRC6	CILINDRO DE RETENCIÓN DE CICATRIZACIÓN PROVISORIO 4,1MM(D) X 6MM (A)
WT2553	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 3MM(A)
WT2554	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 4MM(A)
WT2556	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 6MM(A)
WT2558	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 5,6MM(P) X 8MM(A)
WT2563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
WT2564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
WT2566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
WT2568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WT2573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)
WT2574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
WT2576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 6MM(A)
WT2578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 5MM(D) X 7,5MM(P) X 8MM(A)
WT2663	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 3MM(A)
WT2664	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 4MM(A)
WT2666	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 6MM(A)
WT2668	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 6,8MM(P) X 8MM(A)
WT2673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM(P) X 3MM(A)
WT2674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WT2676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WT2678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP DE 2 PIEZAS 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH52	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 2MM(A)
WTH53	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 3MM(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0  
6  
0  
8




WTH54	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 4MM(A)
WTH56	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM(P) X 6MM(A)
WTH562	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
WTH563	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 3MM(A)
WTH564	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
WTH566	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
WTH568	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 6MM(P) X 8MM(A)
WTH572	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 2MM(A)
WTH573	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH574	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH576	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH578	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH58	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 5MM(D) X 5,6MM (P) X 8MM(A)
WTH62	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM(P) X 2MM(A)
WTH63	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 3MM(A)
WTH64	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 4MM(A)
WTH66	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 6MM(A)
WTH672	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
WTH673	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 3MM(A)
WTH674	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 4MM(A)
WTH676	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 6MM(A)
WTH678	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 7,5MM (P) X 8MM(A)
WTH68	PILAR DE CICATRIZACIÓN EP 6MM(D) X 6,8MM (P) X 8MM(A)
IOL20S	PILAR IOL CERTAIN 2MM
IOL30S	PILAR IOL CERTAIN 3MM
IOL40S	PILAR IOL CERTAIN 4MM
IOL55S	PILAR IOL CERTAIN 5,5MM

7


  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**


  
**SANDRA BROZ**  
CIN 10898  
**DIRECTORA TECNICA**

**80608**




IOL70S	PILAR IOL CERTAIN 7MM
IOL20T	PILAR CON TORNILLO 2MM IOL 2 PIEZAS
IOL30T	PILAR CON TORNILLO 3MM IOL 2 PIEZAS Todos aconsejan no usar
IOL40T	PILAR CON TORNILLO 4MM IOL 2 PIEZAS
IOL55T	PILAR CON TORNILLO 5,5MM IOL 2 PIEZAS
IOL70T	PILAR CON TORNILLO 7MM IOL 2 PIEZAS
IOLDE	EXTENSIÓN DISTAL IOL
IOLGC	CILINORO ORO IOL
IOLHC	CAPUCHÓN DE CICATRIZACIÓN IOL
IOLTC	CILINDRO PROVISORIO IOL
GUCA1C	CILINORO PILAR ORO-HEXAGONAL UCLA 4,1MM (D)
GUCA2C	CILINDRO PILAR ORO NO HEXAGONAL UCLA 4,1MM (D)
GUCA3	PILAR MINIPLANT UCLA ORO CON TORNILLO HEXAGONAL (HEXAGONAL INTERNO)
GUCA3S	TORNILLO PARA PILAR MINIPLANT UCLA ORO (HEXAGONAL INTERNO)
IGUCA1C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO CERTAIN UCLA 4,1MM (D)
IGUCA2C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO CERTAIN UCLA 4,1MM (D) CON TORNILLO DIÁMETRO ANCHO
IGUCA2T	CILINDRO ORO-NO HEXAGONAL UCLA CERTAIN 4,1MM CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IITCS41	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 4,1MM (D)
IITCS42	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 4,1MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IMMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal
IMMTCS2	CILINDRO PROVISORIO DE TITANIO MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
IMUCC2C	Pilar UCLA Certain calcinable no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCC2T	Pilar UCLA Certain calcinable no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG1C	Pilar UCLA Certain oro hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG2C	Pilar UCLA Certain oro no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCG2T	Pilar UCLA Certain oro no hexagonal 3,4mm(D)
IMUCT1	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD SIMPLE CERTAIN

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA PROZA  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8068


97




1

IMUCT2	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
ITCH0	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO PARA IMPLANTE C/ TORNILLO HEXAGONAL 4,1MM (D)
ITCH1	CILINDRO NO HEXAGONAL PROVISORIO PARA IMPLANTE. C/ TORNILLO HEXAGONAL 4,1MM(D)
ITCS41	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO 4,1MM (D)
ITCS42	CILINDRO NO HEXAGONAL PROVISORIO 4,1MM (D) CON RETENCIÓN
ITUCA1	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD SIMPLE CERTAIN
ITUCA2	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
ITUCA2C	PILAR DE TITANIO-NO HEXAGONAL UCLA CERTAIN 4,1MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IUNAB2C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 4,1MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO GOLD-TITE
IUNAB2T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 4,1MM (D) C/TORNILLO DE TITANIO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA51C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D)
IWGA52C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA52T	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWGA61C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D)
IWGA62C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWGA62T	CILINDRO NO HEXAGONAL ORO UCLA CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWPC52C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO GOLD-TITE DE DIÁMETRO ANCHO
IWPC52T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 5MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWPC62C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 6MM (D) C/TORNILLO GOLD-TITE DE DIÁMETRO ANCHO
IWPC62T	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL) CERTAIN 6MM (D) C/TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO DE TITANIO
IWTA51	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD SIMPLE CERTAIN
IWTA52	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD MÚLTIPLE CERTAIN
IWTCS51	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 5MM (D)
IWTCS52	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 5MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
IWTCS61	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL CERTAIN 6MM (D)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA







IWTCS62	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL CERTAIN 6MM (D) CON TORNILLO DE DIÁMETRO ANCHO
MCAT2	CILINDRO DE TITANIO CÓNICO MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE
MMTC1	CILINDRO PROVISORIO 3,4MM (D) CON TORNILLO HEXAGONAL
MMTCS1	CILINDRO HEXAGONAL PROVISORIO 3,4MM(D) CON RETENCIÓN
MMTCS2	CILINDRO DE TITANIO PROVISORIO MICROMINI, HEXAGONAL EXTERNO UNIDAD MÚLTIPLE
MUCC1C	PILAR CALCINABLE HEXAGONAL UCLA 3,4MM(D)
MUCC2C	PILAR CALCINABLE NO HEXAGONAL UCLA 3,4MM(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	PILAR NO HEXAGONAL ORO UCLA 3,4MM(D)
MUCT1	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
MUCT2	CILINDRO DE TITANIO UCLA MICROMINI, UNIDAD MÚLTIPLE HEXAGONAL EXTERNA
SGUCA1C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR UCLA ORO ESTÁNDAR 4,1MM (D)
SWG51C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR ESTÁNDAR ORO UCLA 5MM(D)
SWG61C	CILINDRO PILAR HEXAGONAL ZR ESTÁNDAR ORO UCLA 6MM(D)
TUCA1	CILINDRO DE TITANIO UCLA 4,1MM, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
TUCA2C	CILINDRO PILAR NO HEXAGONAL DE TITANIO UCLA 4,1MM(D)
UNA125	CILINDRO UCLA CALCINABLE HEXAGONAL PAQ. DE 25
UNA225	CILINDRO UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL PAQ. DE 25
UNAB1C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (HEXAGONAL)
UNAB2C	CILINDRO UCLA CALCINABLE (NO HEXAGONAL)
WGA51C	CILINDRO PILAR UCLA ORO HEXAGONAL 5MM (D)
WGA52C	CILINDRO PILAR UCLA ORO NO HEXAGONAL 5MM (D)
WGA61C	CILINDRO PILAR UCLA ORO HEXAGONAL 6MM (D)
WGA62C	CILINDRO PILAR UCLA ORO NO HEXAGONAL 6MM (D)
WPC51C	PILAR UCLA CALCINABLE HEXAGONAL 5MM(D)
WPC52C	PILAR UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL 5MM(D)
WPC61C	PILAR UCLA CALCINABLE HEXAGONAL 6MM(D)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




WPC62C	PILAR UCLA CALCINABLE NO HEXAGONAL 6MM(D)
WTA51	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD SIMPLE HEXAGONAL EXTERNA
WTA52	CILINDRO DE TITANIO UCLA 5,0MM, UNIDAD MÚLTIPLE HEXAGONAL EXTERNA
WTC51	CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 5MM(D)
WTC52	CILINDRO PARA IMPLANTE NO HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 5MM(D).
WTC61	CILINDRO PARA IMPLANTE HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 6MM(D)
WTC62	CILINDRO PARA IMPLANTE NO HEXAGONAL PROVISORIO C/TORNILLO HEXAGONAL 6MM(D).
WTCS51	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS52	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL 5MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS61	CILINDRO PROVISORIO HEXAGONAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
WTCS62	CILINDRO PROVISORIO NO HEXAGONAL 6MM(D) CON RETENCIÓN
IMPAPF34	POSTE PREANGULADO 15° CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPAPF36	POSTE PREANGULADO 15° CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
IMPFP34	POSTE CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPFP36	POSTE CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
IMPFTC32	CILINDRO PROVISORIO CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM (NO HEXAGONAL)
IMPFTC34	CILINDRO PROVISORIO CERTAIN PERFORMANCE 3,4MM (HEXAGONAL)
IPAPF454	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAPF456	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPAPF554	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAPF556	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPAPF664	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAPF666	Poste PREANGULADO15° Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
IPFP454	Poste Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPFP456	Poste Certain PreFormance 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IPFTC41	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1MM (hexagonal)
IPFTC42	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1MM (no hexagonal)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
C.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0600

100




IWFPF554	Poste Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IWFPF556	Poste Certain PreFormance 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM(A)
IWFPF664	Poste Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IWFPF666	Poste Certain PreFormance 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM(A)
IWPFTC51	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5MM (hexagonal)
IWPFTC52	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5MM (no hexagonal)
IWPFTC61	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6MM (hexagonal)
IWPFTC62	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6MM (no hexagonal)
MPAPF34	POSTE PREFORMANCE PREANGULADO 15° 3,4MM (D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
MPAPF36	POSTE PREFORMANCE PREANGULADO 15° 3,4MM (D) X 3,8MM(P) X 6MM(A)
MPFP34	POSTE PREFORMANCE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 4MM (A)
MPFP36	POSTE PREFORMANCE DE 3,4MM (D) X 3,8MM (P) X 6MM (A)
MPFTC32	CILINDRO PROVISORIO PREFORMANCE DE 3,4MM (NO HEXAGONAL)
MPFTC34	CILINDRO PROVISORIO PREFORMANCE DE 3,4MM (HEXAGONAL)
PAPF454	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM (A)
PAPF456	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 4,1MM(D) X 5MM(P) X 6MM (A)
PAPF554	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM (A)
PAPF556	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 5MM(D) X 5MM(P) X 6MM (A)
PAPF664	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM (A)
PAPF666	Poste PreFormance PREANGULADO 15° 6MM(D) X 6MM(P) X 6MM (A)
PFP454	Poste PreFormance de 4,1MM (D) X 5MM (P) X 4MM (A)
PFP456	Poste PreFormance de 4,1MM (D) X 5MM (P) X 6MM (A)
PFTC41	Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1MM
PFTC42	Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1MM
WFPF554	Poste PreFormance de 5MM (D) X 5MM (P) X 4MM (A)
WFPF556	Poste PreFormance de 5MM (D) X 5MM (P) X 6MM (A)
WFPF664	Poste PreFormance de 6MM (D) X 6MM (P) X 4MM (A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO




SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA




WPFP666	Poste PreFormance de 6MM (D) X 6MM (P) X 6MM (A)
WPFTC51	Cilindro provisorio PreFormance 5MM (hexagonal)
WPFTC52	Cilindro provisorio PreFormance 5MM (no hexagonal)
WPFTC61	Cilindro provisorio PreFormance 6MM (hexagonal)
WPFTC62	Cilindro provisorio PreFormance 6MM (no hexagonal)
AC4217	PILAR CÓNICO ANGULADO 17° - 4,1MM(D) X 2MM(A)
AC4225	PILAR CÓNICO ANGULADO 25° - 4,1MM(D) X 2MM(A)
AC4417	PILAR CÓNICO ANGULADO 17° - 4,1MM(D) X 4MM(A)
AC4425	PILAR CÓNICO ANGULADO 25° - 4,1MM(D) X 4MM(A)
CA001	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 1MM (A)
CA001S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 1MM (A)
CA002	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 2MM (A)
CA002S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 2MM (A)
CA003	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 3MM (A)
CA003S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 3MM (A)
CA004	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 4MM (A)
CA004S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 4MM (A)
CA055	PILAR CÓNICO 4,1MM (D)X 5,5MM (A)
CA055S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO 4,1MM Y 5MM (D) X 5,5MM (A)
CACC5	CILINDRO CÓNICO CALCINABLE NO HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM
CAGC5	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM (D)
CAGC6	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 6MM (D)
CATC5	CILINDRO CÓNICO DE TITANIO NO-HEXAGONAL 4,1MM Y 5,0MM (D)
CC300	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO NO HEXAGONAL
CNC30	CILINDRO CÓNICO PROVISORIO HEXAGONAL.
CNRC5	CILINDRO CÓNICO CALCINABLE HEXAGONAL 4,1MM Y 5MM(D)
CNRG5	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 4,1 Y 5MM (D)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
CTORA TECNICA

8060



1


CNRG6	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 6MM (D)
CS250	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 5MM (P)
CS260	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 6MM (P)
CS270	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 4,1 Y 5MM (D) X 7,5MM (P)
IAC4217	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 17° 4,1MM(D) X 2MM(A)
IAC4225	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 25° 4,1MM(D) X 2MM(A)
IAC4417	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 17° 4,1MM(D) X 4MM(A)
IAC4425	PILAR CERTAIN CÓNICO ANGULADO 25° 4,1MM(D) X 4MM(A)
ICA001	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 1MM (A)
ICA001S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1 Y 5MM (D) X 1MM (A)
ICA002	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 2MM (A)
ICA002S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 2MM (A)
ICA003	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 3MM (A)
ICA003S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 3MM (A)
ICA004	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 4MM (A)
ICA004S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1 Y 5MM (D) X 4MM (A)
ICA055	PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM (D) X 5,5MM (A)
ICA055S	TORNILLO PARA PILAR CÓNICO CERTAIN 4,1MM Y 5MM (D) X 5,5MM (A)
IMCA31	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D) X 1MM (A)
IMCA32	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 2MM (A)
IMCA33	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 3MM (A)
IMCA34	PILAR CÓNICO CERTAIN 3,4MM (D)X 4MM (A)
IWCA51	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 1MM (A)
IWCA52	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 2MM (A)
IWCA53	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 3MM (A)
IWCA54	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 4MM (A)
IWCA55	PILAR CÓNICO CERTAIN 5MM (D) X 5,5MM (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APROBADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


80608

103




1

IWCA61	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 1MM (A)
IWCA62	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 2MM (A)
IWCA63	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 3MM (A)
IWCA64	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 4MM (A)
IWCA65	PILAR CÓNICO CERTAIN 6MM (D) X 5,5MM (A)
MCA31	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 1MM(A)
MCA32	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 2MM(A)
MCA33	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 3MM(A)
MCA34	PILAR CÓNICO 3,4MM(D) X 4MM(A)
MCAG1	CILINDRO ORO CÓNICO HEXAGONAL 3,4MM(D)
MCAG2	CILINDRO ORO CÓNICO NO HEXAGONAL 3,4MM(D)
MCTC1	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO HEXAGONAL
MCTC2	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO NO HEXAGONAL
MITC2	CILINDRO DE TITANIO CONO CORTO NO HEXAGONAL
QBCAP	TAPA QUICKBRIDGE
QKBRG	CILINDRO Y TAPA QUICKBRIDGE
SCA001	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 1MM (A)
SCA002	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 2MM (A)
SCA003	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 3MM (A)
SCA004	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 4MM (A)
SCA055	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR 4,1MM (D) X 5,5MM (A)
SWCA51	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X1MM (A)
SWCA52	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X2MM (A)
SWCA53	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X3MM (A)
SWCA54	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X4MM (A)
SWCA55	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 5MM (D)X5,5MM (A)
SWCA61	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X1MM (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


10 

7

SWCA62	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X2MM (A)
SWCA63	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X3MM (A)
SWCA64	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X4MM (A)
SWCA65	PILAR CÓNICO ORO ESTÁNDAR ZR TM 6MM (D)X5,5MM (A)
TRC30	CILINDRO DE RETENCIÓN PROVISORIO
WCA51	PILAR CÓNICO 5MM (D) X1MM(A)
WCA52	PILAR CÓNICO 5MM (D) X2MM(A)
WCA53	PILAR CÓNICO 5MM (D) X3MM(A)
WCA54	PILAR CÓNICO 5MM (D) X4MM(A)
WCA55	PILAR CÓNICO 5MM (D) X5,5MM(A)
WCA62	PILAR CÓNICO 6MM (D) X2MM (A)
WCA63	PILAR CÓNICO 6MM(D)X 3MM(A)
WCA65	PILAR CÓNICO 6MM(D)X 5,5MM(A)
WCS66	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 6MM (D) X 6MM (P)
WCS67	TAPA DE CICATRIZACIÓN EP CÓNICA DE 6MM (D) X 7,5MM (P)
WCTC60	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO EP 6MM(D)X6MM(P) HEXAGONAL
WCTC61	CILINDRO PROVISORIO CÓNICO EP 6MM(D)X6MM(P) NO HEXAGONAL
APP42	POSTE PREP-TITE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO HEXAGONAL DE TITANIO
APP452G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
APP454G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
APP462G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
APP464G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
APP472G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
APP474G	POSTE GINGIHUE 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IAPP452G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IAPP454G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IAPP462G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

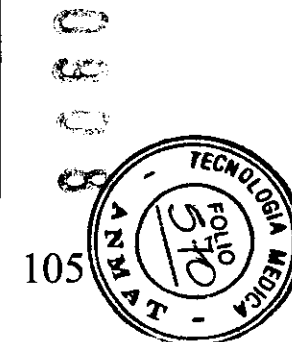


IAPP464G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IAPP472G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IAPP474G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IMAP32G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
IMAP34G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IMPAP32G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
IMPAP34G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
IPAP452G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IPAP454G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAP462G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP464G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP472G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP474G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 4,1MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IPAP552G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IPAP554G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IPAP562G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP564G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP572G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP574G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IPAP662G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IPAP664G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IPAP672G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IPAP674G	POSTE ANGULADO 15° GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IWPP552G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
IWPP554G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
IWPP562G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IWPP564G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DENTISTA TECNICA

8068






IWPP572G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IWPP574G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
IWPP662G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
IWPP664G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
IWPP672G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
IWPP674G	POSTE GINGIHUE CERTAIN 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
MAP32G	POSTE GINGIHUE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
MAP34G	POSTE GINGIHUE 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
MPAP32G	POSTE GINGIHUE PREANGULADO 15° 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 2MM(A)
MPAP34G	POSTE GINGIHUE PREANGULADO 15° 3,4MM(D) X 3,8MM(P) X 4MM(A)
PA154C	PILAR PREANGULADO 15° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA156C	PILAR PREANGULADO 15° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PA254C	PILAR PREANGULADO 25° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA256C	PILAR PREANGULADO 25° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PA352 SCREW	TORNILLO PA352
PA352C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PA354C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PA356C	PILAR PREANGULADO 35° - 4,1MM (D) X 5MM(P) X 6MM(A)
PAP452G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PAP454G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PAP462G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
PAP464G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
PAP472G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP474G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 4MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAP552G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A)
PAP554G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P) X 4MM(A)
PAP562G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)



DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




PAP564G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
PAP572G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP574G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAP662G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A)
PAP664G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P) X 4MM(A)
PAP672G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P) X 2MM(A)
PAP674G	POSTE PREANGULADO 15° GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P) X 4MM(A)
PAW00	ARANDELA PARA PILAR PREANGULADO
PTC345	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC347	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC455	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC457	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC465	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC467	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC475	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC477	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC555	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC557	TAPA PREP-TITE 7MM
PTC665	TAPA PREP-TITE 5MM
PTC667	TAPA PREP-TITE 7MM
WPP552	POSTE PREP-TITE 5MM(D) X 5MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL
WPP552G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P)X 2MM(A)
WPP554G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 5MM(P)X 4MM(A)
WPP562G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P)X 2MM(A)
WPP564G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 6MM(P)X 4MM(A)
WPP572G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P)X 2MM(A)
WPP574G	POSTE GINGIHUE 5MM(D) X 7,5MM(P)X 4MM(A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



SANDRA BROZ  
M.N. 10298  
DIRECTORA TECNICA




WPP662	POSTE PREP-TITE 6MM(D) X 6MM(P) X 2MM(A) CON TORNILLO DE TITANIO HEXAGONAL
WPP662G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P)X 2MM(A)
WPP664G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 6MM(P)X 4MM(A)
WPP672G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P)X 2MM(A)
WPP674G	POSTE GINGIHUE 6MM(D) X 7,5MM(P)X 4MM(A)
AB200	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 2MM (A)
AB200S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 2MM (A)
AB300	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 2MM (A)
AB300S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 3MM (A)
AB400	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 4MM (A)
AB400S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 4MM (A)
AB550	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM (D) X 5,5MM(A)
AB550S	TORNILLO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO 5,5MM(A)
AB700	PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D) X 7MM(A)
AHP72	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 2MM(A)
AHP73	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 3MM(A)
AHP74	POSTE PILAR 4,1MM(D) X 4MM(A)
CGC30	CILINDRO BISELADO ORO PARA PILAR ESTÁNDAR
IAB200	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 2MM (A)
IAB300	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 3MM (A)
IAB400	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 4MM (A)
IAB550	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM(D) X 5,5MM (A)
IAB700	PILAR ESTÁNDAR CERTAIN 4,1MM (D) X 7MM(A)
SGC30	CILINDRO ORO PARA PILAR ESTÁNDAR
SGC34	CILINDRO PLÁSTICO CALCINABLE PARA PILAR ESTÁNDAR
STC30	CILINDRO PARA PILAR ESTÁNDAR DE TITANIO
TC300	CILINDRO PROVISORIO (PILAR ESTÁNDAR)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
N. 10868  
DIRECTORA TECNICA

80608

109 


1

TS250	TORNILLO PROVISORIO PARA PILAR ESTÁNDAR 4,1MM(D)
WAB200	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 2MM (A)
WAB300	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 3MM (A)
WAB400	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 4MM (A)
WAB550	PILAR ESTÁNDAR 5MM (D) X 5,5MM(A)


Fabricante: **BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L - ESPAÑA**

ILPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
ILPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
ILPC341	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC342	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC343	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC344	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC441	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA PROZ  
M.N. 10998  
TORNILLO TECNICA

8060




ILPC442	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC443	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC444	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC541	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC542	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC543	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC544	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)

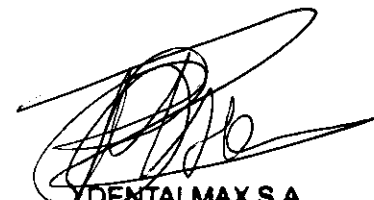
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060




LPC343	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC441	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCAMI	Instrumento de pulido para pilar de perfil bajo
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCDE	Extensión distal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCLA	Análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo
LPCPIC1	Cofia de impresión Pick-up (hexagonal) para pilar de perfil bajo

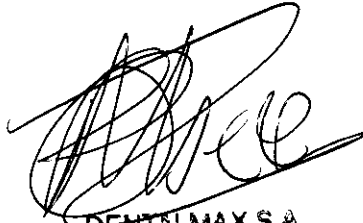
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0908



LPCPIC2	Cofia de impresión Pick-up (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCPP	Protector de pulido para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCRIC	Cofia de impresión para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTIC1	Cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTIC2	Cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo

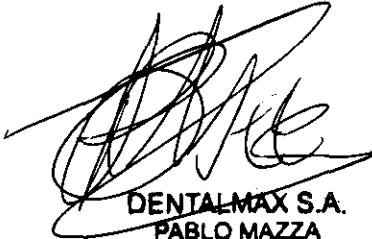
  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

Fabricante: **BIOMET 3i – ESTADOS UNIDOS**

AB550	Pilar estándar 4,1mm (D) x 5,5mm(A)
AB550S	Tornillo de titanio para pilar estándar 5,5mm(A)
AB700	Pilar estándar 4,1mm(D) x 7mm(A)
AC4217	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4225	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4417	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
AC4425	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
ACSCREW	Tornillo p/pilar cónico angulado 17° y 25° - 4,1mm y 5mm(D) x 2mm y 4mm(A)
AHP72	Poste pilar 4,1mm(D) x 2mm(A)
AHP73	Poste pilar 4,1mm(D) x 3mm(A)
AHP74	Poste pilar 4,1mm(D) x 4mm(A)

  
SANDRA PEROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

APP42	Poste Prep-Tite 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A) c/tornillo hexagonal de titanio
APP452G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
APP454G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
APP462G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 2mm (A)
APP464G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
APP472G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
APP474G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
CA001	Pilar cónico 4,1mm (D)x 1mm (A)
CA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 1mm (A)
CA002	Pilar cónico 4,1mm (D)x 2mm (A)
CA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 2mm (A)
CA003	Pilar cónico 4,1mm (D)x 3mm (A)
CA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 3mm (A)
CA004	Pilar cónico 4,1mm (D)x 4mm (A)
CA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 4mm (A)
CA055	Pilar cónico 4,1mm (D)x 5,5mm (A)
CA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 5,5mm (A)
CACC5	Cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1 x 5mm
CAGC5	Cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (D)
CAGC6	Cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (D)
CATC5	Cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (D)
CC300	Cilindro prov. cónico no hexagonal.
CGC30	Cilindro biselado oro para pilar estándar
CSCM05	Barra para 5 Implantes Cam Structure duplicado por fresado
CSCM06	Barra para 6 Implantes Cam Structure duplicado por fresado
CSCM07	Barra para 7 Implantes Cam Structure duplicado por fresado
CSCM08	Barra para 8 Implantes Cam Structure duplicado por fresado

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA



CSCM09	Barra para 9 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM10	Barra para 10 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSD02	Barra Camstructsure Dolder
CSD03	Barra Camstructsure Dolder
CSD04	Barra Camstructsure Dolder
CSD05	Barra Camstructsure Dolder
CSD06	Barra Camstructsure Dolder
CSD07	Barra Camstructsure Dolder
CSD08	Barra Camstructsure Dolder
CSD09	Barra Camstructsure Dolder
CSD10	Barra Camstructsure Dolder
CSH02	Barra Camstructsure Hadar
CSH03	Barra Camstructsure Hadar
CSH04	Barra Camstructsure Hadar
CSH05	Barra Camstructsure Hadar
CSH06	Barra Camstructsure Hadar
CSH07	Barra Camstructsure Hadar
CSH08	Barra Camstructsure Hadar
CSH09	Barra Camstructsure Hadar
CSH10	Barra Camstructsure Hadar
CSHY04	Barra híbrida Camstructsure
CSHY05	Barra híbrida Camstructsure
CSHY06	Barra híbrida Camstructsure
CSHY07	Barra híbrida Camstructsure
CSHY08	Barra híbrida Camstructsure
CSHY09	Barra híbrida Camstructsure
CSHY10	Barra híbrida Camstructsure

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10996  
DIRECTORA TÉCNICA

9060

CSP02	Barra primaria Camstructure
CSP03	Barra primaria Camstructure
CSP04	Barra primaria Camstructure
CSP05	Barra primaria Camstructure
CSP06	Barra primaria Camstructure
CSP07	Barra primaria Camstructure
CSP08	Barra primaria Camstructure
CSP09	Barra primaria Camstructure
CSP10	Barra primaria Camstructure
DRAF	Conector hembra roscado Dal-Ro
DRCS1	Sistema calcinable Dal-Ro
DRFM1	Conector hembra de metal Dal-Ro
DRH20	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 2mm (A)
DRH40	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 4mm (A)
DRH60	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 6mm (A)
DRTH	Conjunto Dal-Ro de capuchón y conector hembra
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
EHA343	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3,0mm (A)
EHA344	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
EHA346	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
EHA348	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
EHA353	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
EHA354	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
EHA356	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
EHA358	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10696  
DIRECTORA TECNICA

0908




EHA576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
EHA578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
EHA663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)
EHA664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
EHA666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
EHA668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
EHA673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
EHA674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
EHA676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
EHA678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
GS200	Tornillo oro c/ranura 2mm
GS300	Tornillo oro c/ranura 3mm
GSH20	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 2mm
GSH30	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 3mm
GSH70	Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 7mm
GUCA1C	Pilar oro-hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA2C	Pilar oro no hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA3	Pilar Minimplant UCLA oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)
GUCA3S	Tomillo para pilar Minimplant UCLA oro (hexagonal interno)
IAB200	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 2mm (A)
IAB300	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 3mm (A)
IAB400	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 4mm (A)
IAB550	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 5,5mm (A)
IAB700	Pilar estándar Certain 4,1mm (D) x 7mm(A)
IAC4217	Pilar Certain cónico angulado 17°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4225	Pilar Certain cónico angulado 25°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4417	Pilar Certain cónico angulado 17°-4,1mm(D) x 4mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0  
3  
0  
7




IAC4425	Pilar Certain cónico angulado 25°-4,1mm(D) x 4mm(A)
IAPP452G	Poste GingiHue Certain 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
IAPP454G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 5mm (P) x 4mm (A)
IAPP462G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 2mm (A)
IAPP464G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IAPP472G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IAPP474G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
ICA001	Pilar cónico 4,1mm (D) x 1mm (A) Certain
ICA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 1mm (A)Certain
ICA002	Pilar cónico 4,1mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA003	Pilar cónico 4,1mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA004	Pilar cónico 4,1mm (D) x 4mm (A) Certain
ICA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 4mm (A)Certain
ICA055	Pilar cónico 4,1mm (D) x 5,5mm (A)Certain
ICA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 5,5mm (A)Certain
ICAP454	Poste ZiReal 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
ICAP464	Poste ZiReal 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode
ICZTIS	Tomillo de prueba de circonio Encode
IEHA343	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3mm (A)
IEHA344	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
IEHA346	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
IEHA348	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)
IEHA353	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
IEHA354	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060



IEHA356	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
IEHA358	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
IEHA443	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)
IEHA444	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)
IEHA446	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)
IEHA448	Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)
IEHA453	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)
IEHA454	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
IEHA456	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
IEHA458	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)
IEHA463	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
IEHA464	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IEHA466	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IEHA468	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
IEHA473	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA474	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA476	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA478	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA553	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA554	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA556	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA558	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA563	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)
IEHA564	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IEHA566	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IEHA568	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


120




IEHA573	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA574	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IEHA663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)
IEHA664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)
IEHA666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)
IEHA668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)
IEHA673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IEHA674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IEHA676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IEHA678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IGUCA1C	Cilindro de pilar hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D)
IGUCA2C	Cilindro de pilar no hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D) con tomillo diámetro ancho
IGUCA2T	Pilar oro-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm con tornillo ancho de titanio
IOL20S	Pilar IOL Certain 2mm
IOL30S	Pilar IOL Certain 3mm
IOL40S	Pilar IOL Certain 4mm
IOL55S	Pilar IOL Certain 5,5mm
IOL70S	Pilar IOL Certain 7mm
IITCS41	Cilindro provisorio hexagonal Certain 4,1mm (D)
IITCS42	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
ILOA001	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILOA002	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILOA003	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILOA004	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA




ILOA005	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILOA006	Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 6mm (A)
ILPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
ILPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
ILPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)
ILPC341	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)
ILPC342	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPC343	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPC344	Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPC441	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
ILPC442	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
ILPC443	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060





ILPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
ILPC444	Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
ILPC541	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)
ILPC542	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)
ILPC543	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)
ILPC544	Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)
ILRGHG	Tornillo Gold -Tite Certain hexagonal de diámetro ancho
ILRGHT	Tornillo de titanio Certain hexagonal de diámetro ancho
IMAP32G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 2mm(A)
IMAP34G	MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMCA31	Pilar cónico 3,4mm (D) x 1mm (A) Certain
IMCA32	Pilar cónico 3,4mm (D)x 2mm (A) Certain
IMCA33	Pilar cónico 3,4mm (D)x 3mm (A) Certain
IMCA34	Pilar cónico 3,4mm (D)x 4mm (A) Certain
IMHA32	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 2mm (A)
IMHA33	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 3mm (A)
IMHA34	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 4mm (A)
IMHA36	Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 6mm (A)
IMLOA001	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 1mm (A)
IMLOA002	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 2mm (A)
IMLOA003	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 3mm (A)
IMLOA004	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 4mm (A)




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO




SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060

123




IMLOA005	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 5mm (A)
IMLOA006	Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 6mm (A)
IMMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal
IMPAP32G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
IMPAP34G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPAPF34	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPAPF36	Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
IMPFP34	Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
IMPFP36	Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
IMPFTC32	Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (no hexagonal)
IMPFTC34	Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (hexagonal)
IMUCC2C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCC2T	Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA Certain 3,4mm(D)
IMUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IMUCG2T	Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)
IOL20T	Pilar con tornillo 2mm IOL 2 piezas
IOL30T	Pilar con tornillo 3mm IOL 2 piezas
IOL40T	Pilar con tornillo 4mm IOL 2 piezas
IOL55T	Pilar con tornillo 5,5mm IOL 2 piezas
IOL70T	Pilar con tornillo 7mm IOL 2 piezas
IOLDE	Extensión distal IOL
IOLGC	Cilindro oro IOL
IOLHC	Capuchón de cicatrización IOL
IOLTC	Cilindro provisorio IOL
IPA4140	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4155	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 5,5mm

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.P. 10998  
DIRECTORA TECNICA


03/07/2016




IPA4240	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4255	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 5,5mm
IPA4340	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4355	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) – Poste 5,5mm
IPA4440	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) – Poste 4,0mm
IPA4455	Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) – Post 5,5mm
IPA5140	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5155	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5240	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5255	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5340	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5355	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
IPA5440	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
IPA5455	Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6140	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6155	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6240	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6255	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6340	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6355	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste 5,5mm
IPA6440	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 4,0mm
IPA6455	Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste 5,5mm
IPAP452G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IPAP454G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAP462G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)



DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



SANDRA POZ  
M.B. 10868  
DIRECTORA TÉCNICA




IPAP464G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAP472G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IPAP474G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAP552G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IPAP554G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAP562G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IPAP564G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAP572G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)
IPAP574G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAP662G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x2mm(A)
IPAP664G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
IPAP672G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)
IPAP674G	Poste GingiHue Certain angulado 15° 6mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAPF454	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF456	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF464	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF466	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF474	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF476	Poste preangulado15° Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF554	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF556	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF564	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF566	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF574	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF576	Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF664	Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 13888  
DIRECTORA TÉCNICA

090  
FOLIO 591  
RECTORIA MEDICA  
ANMB  
12


IPAPF666	Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF674	Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF676	Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPFP454	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPFP456	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPFP464	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPFP466	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPFP474	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPFP476	Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPFTC41	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (hexagonal)
IPFTC42	Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (no hexagonal)
ISHA42	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 2mm(A)
ISHA43	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 3mm(A)
ISHA44	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 4mm(A)
ISHA46	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 6mm(A)
ISHA48	Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x 8mm(A)
ISMHA32	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x 2mm(A)
ISMHA33	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x 3mm(A)
ISMHA34	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 4mm(A)
ISMHA36	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 6mm(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)

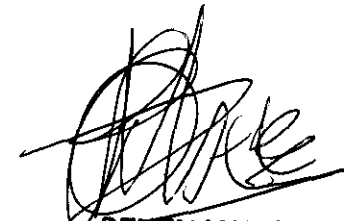  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
APODERADO


  
SANDRA PROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

127

0908




ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITCHO	Cilindro provisorio para implante hexagonal c/ tornillo hexagonal 4,1mm
ITCH1	Cilindro provisorio para implante no hexagonal. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(D)
ITCS41	Cilindro provisorio hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITCS42	Cilindro provisorio no hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITHA52	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 2mm(A)
ITHA53	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 3mm(A)
ITHA54	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 4mm(A)
ITHA56	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 6mm(A)
ITHA58	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 8mm(A)
ITHA63	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 3mm(A)
ITHA64	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 4mm(A)
ITHA66	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 6mm(A)
ITHA68	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 8mm(A)
ITHA73	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 3mm(A)
ITHA74	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 4mm(A)
ITHA76	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 6mm(A)
ITHA78	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x 8mm(A)
ITUCA2C	Pilar de titanio-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IUNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de diámetro ancho Gold-Tite
IUNAB2T	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D) c/tornillo de titanio de diámetro ancho
IUNIHG	Tornillo hexagonal Gold-Tite Certain
IUNIHT	Tornillo hexagonal Certain de titanio
IWCA51	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 1mm (A)
IWCA52	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 2mm (A)

  
DENTALMAX S.A.  
PAOLO MAZZA  
APODERADO


8060


  
SANDRA POZ  
M.M. 10888  
DIRECTORA TECNICA

128




IWCA53	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 3mm (A)
IWCA54	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 4mm (A)
IWCA55	Pilar cónico Certain 5mm (D) x 5mm (A)
IWCA61	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 1mm (A)
IWCA62	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 2mm (A)
IWCA63	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 3mm (A)
IWCA64	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 4mm (A)
IWCA65	Pilar cónico Certain 6mm (D) x 5,5mm (A)
IWCAP564	Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal
IWCAP574	Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A) con tornillos hexagonales ZiReal
IWGA51C	Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D)
IWGA52C	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWGA52T	Pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWGA61C	Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D)
IWGA62C	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWGA62T	Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho de titanio
IWPC52C	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho
IWPC52T	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWPC62C	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho
IWPC62T	Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio
IWFPF554	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IWFPF556	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IWFPF564	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWFPF566	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IWFPF574	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWFPF576	Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IWFPF664	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)


  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
**SANDRA TROZ**  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

129



IWFP666	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IWFP674	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWFP676	Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IWPFTC51	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (hexagonal)
IWPFTC52	Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (no hexagonal)
IWPFTC61	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (hexagonal)
IWPFTC62	Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (no hexagonal)
IWPP552G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
IWPP554G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IWPP562G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IWPP564G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWPP572G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IWPP574G	Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWPP662G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
IWPP664G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IWPP672G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
IWPP674G	Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IWTCS51	Cilindro provisorio hexagonal Certain 5mm (D)
IWTCS52	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWTCS61	Cilindro provisorio hexagonal Certain 6mm (D)
IWTCS62	Cilindro provisorio no hexagonal Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
IWTH52	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x2mm(A)
IWTH53	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x3mm(A)
IWTH54	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x4mm(A)
IWTH56	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x6mm(A)
IWTH562	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x2mm(A)
IWTH563	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x3mm(A)
IWTH564	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x4mm(A)




**DENTALMAX S.A.**  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060



SANDRA BROZ  
M.N. 10298  
DIRECTORA TECNICA





IWTH566	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
IWTH568	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
IWTH572	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IWTH573	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IWTH574	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IWTH576	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IWTH578	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IWTH58	Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 5,6mm (P) x 8mm (A)
IWTH62	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 2mm (A)
IWTH63	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 3mm (A)
IWTH64	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 4mm (A)
IWTH66	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 6mm (A)
IWTH672	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IWTH673	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
IWTH674	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
IWTH676	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
IWTH678	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
IWTH68	Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 8mm (A)
IZSHG	Tornillo para pilar hexagonal Gold-Tite para poste Certain ZiReal
LAELM	Machos de retención extra ligeros Locator - Pack x 4
LAERM	Machos de rango extendido Locator - Pack x 4
LARMS	Machos de repuesto Locator - Pack x 4
LELARM	Machos de repuesto angulados extra ligeros Locator - Pack x4.
LGS30	Tomillo de retención con ranura oro largo
LLRMS	Machos de retención ligera Locator - Pack x 4
LOA001	Pilar Locator 1mm
LOA002	Pilar Locator 2mm


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
N. 10958  
DIRECTORA TECNICA

090


LOA003	Pilar Locator 3mm
LOA004	Pilar Locator 4mm
LOA005	Pilar Locator 5mm
LOA006	Pilar Locator 6mm
LOAB	Accesorio Locator
LOAH	Cazoleta de repuesto Locator
LORHK	Kit de cazoletas de repuesto Locator
LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC343	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)

  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**


  
SANDRA TROZ  
M.N. 10888  
DIRECTORA TECNICA

8060

132



LPC441	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo




DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

7



SANDRA CROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

133



LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
MAP32G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 2mm(A)
MAP34G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 4mm(A)
MCA31	Pilar cónico 3,4mm(D) x 1mm(A)
MCA32	Pilar cónico 3,4mm(D) x 2mm(A)
MCA33	Pilar cónico 3,4mm(D) x 3mm(A)
MCA34	Pilar cónico 3,4mm(D) x 4mm(A)
MCAG1	Cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCAG2	Cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm (D)
MCTC1	Cilindro provisorio para pilar cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCTC2	Cilindro provisorio cónico no hexagonal MicroMiniplant™
MHA32	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MHA33	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MHA34	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MHA36	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MHC33	Capuchón cónico de cicatrización 3,4mm(D)
MITC2	Cilindro cono corto de titanio no hexagonal
MLOA001	Pilar Locator 3,4mm (D) x 1mm (A)
MLOA002	Pilar Locator 3,4mm (D) x 2mm (A)
MLOA003	Pilar Locator 3,4mm (D) x 3mm (A)
MLOA004	Pilar Locator 3,4mm (D) x 4mm (A)
MLOA005	Pilar Locator 3,4mm (D) x 5mm (A)
MLOA006	Pilar Locator 3,4mm (D) x 6mm (A)
MMTC1	Cilindro hexagonal provisorio MicroMini c/tom hexagonal
MMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal con retención 3,4mm (D)
MPAP32G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA CROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


8060

MPAP34G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF34	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF36	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MPFP34	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
MPFP36	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
MPFTC32	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (no hexagonal)
MPFTC34	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (hexagonal)
MT233	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MT236	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MT253	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
MT254	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
MT256	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
MUCC1C	Pilar calcinable hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCC2C	Pilar calcinable no hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal 3,4mm(D)
OSO20	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO20S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO40	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO40S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO60	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSO60S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSOBK	Repuesto O-Ring negro
OSOCA	Sistema calcinable O-Ring
OSODH	Capuchón O-Ring
OSORED	O-Ring de procesamiento
PA154C	Pilar preangulado 15° - 4mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060



PA156C	Pilar preangulado 15° - 6mm(A)
PA254C	Pilar preangulado 25° - 4mm(A)
PA256C	Pilar preangulado 25° - 6mm(A)
PA352 SCREW	Tornillo PA352
PA352C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 2mm(A)
PA354C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 4mm(A)
PA356C	Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 6mm(A)
PAK4140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK4155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK4240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
PAK4255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK4340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK4355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK4440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK4455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAK5140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK5155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK5240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
PAK5255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK5340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK5355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK5440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK5455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAK6140	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
PAK6155	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
PAK6240	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8068


  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

PAK6255	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
PAK6340	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
PAK6355	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
PAK6440	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
PAK6455	Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
PAP452G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 2mm
PAP454G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 4mm
PAP462G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 2mm
PAP464G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 4mm
PAP472G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 2mm
PAP474G	Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 4mm
PAP552G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 2mm
PAP554G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 4mm
PAP562G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 2mm
PAP564G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 4mm
PAP572G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 2mm
PAP574G	Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 4mm
PAP662G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 2mm
PAP664G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 4mm
PAP672G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 2mm
PAP674G	Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 4mm
PAPF454	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF456	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF464	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF466	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF474	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0908




PAPF476	Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAPF554	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm (A)
PAPF556	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm (A)
PAPF564	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF566	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF574	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF576	Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAPF664	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)
PAPF666	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)
PAPF674	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)
PAPF676	Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)
PAW00	Arandela para pilar preangulado
PFP454	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
PFP456	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
PFP464	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
PFP466	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
PFP474	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
PFP476	Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
PFTC41	Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1mm
PFTC42	Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1mm
PPC484	Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 4,0mm
PPC485	Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 5,5mm
PPC654	Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 4,0mm
PPC655	Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 5,5mm
PTC345	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con MAP32G, MAP34G
PTC347	Tapa Prep-Tite 7mm: usar con MAP32G, MAP34G
PTC455	Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP452G, APP454G

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

0908

  
SANDRA CRUZ  
M.N. 10298  
DIRECTORA TECNICA


138







SWCA52	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x2mm (A)
SWCA53	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x3mm (A)
SWCA54	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x4mm (A)
SWCA55	Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x5,5mm (A)
SWCA61	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x1mm (A)
SWCA62	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x2mm (A)
SWCA63	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x3mm (A)
SWCA64	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x4mm (A)
SWCA65	Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x5mm (A)
SWG51C	Cilindro pilar hexagonal ZR estándar oro UCLA 5mm(D)
SWG61C	Cilindro pilar hexagonal ZR oro UCLA 6mm(D)
TC300	Cilindro provisorio (pilar estándar)
TH253	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x3mm(A)
TH253S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x3mm(A)
TH254	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x4mm(A)
TH254S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x4mm(A)
TH256	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x6mm(A)
TH256S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x6mm(A)
TH258	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x8mm(A)
TH258S	Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x8mm(A)
TH263	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x3mm(A)
TH264	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
TH266	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x6mm(A)
TH268	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x8mm(A)
TH273	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x3mm (A)
TH274	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x4mm (A)
TH276	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x6mm (A)

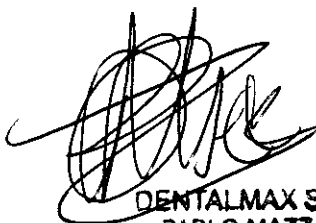


DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO



SANDRA DROZ  
M.C. 10888  
DIRECTORA TÉCNICA


0908




TH278	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x8mm (A)
THA42	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 2mm(A)
THA43	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 3mm(A)
THA44	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 4mm(A)
THA46	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 6mm(A)
THA48	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 8mm(A)
THA52	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
THA53	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
THA54	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
THA56	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
THA58	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 8mm(A)
THA63	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
THA64	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
THA66	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
THA68	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
THA73	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
THA74	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
THA76	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
THA78	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
THRC4	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 4mm (A)
THRC6	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 6mm (A)
TRC30	Cilindro de retención provisorio
TS250	Tomillo provisorio (pilar estándar) 4,1mm(D)
TSH30	Tornillo de titanio hexagonal de 3mm
TUCA2C	Cilindro pilar UCLA de titanio no hexagonal 4,1mm(D)
UNA125	Pack cilindro UCLA calcinable hexagonal x 25
UNA225	Pack cilindro UCLA calcinable no hexagonal x 25

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

8060


  
SANDRA DROZ  
M.T. 10898  
DIRECTORA TÉCNICA

UNAB1C	Cilindro UCLA calcinable (hexagonal)
UNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal)
UNIHG	Tornillo Uniscrew hexagonal Gold-Tite
UNIHT	Tornillo Uniscrew hexagonal de titanio
UNISG	Tornillo Uniscrew cuadrado Gold-Tite
UNIST	Tornillo Uniscrew cuadrado de titanio
WAB200	Pilar estándar 5mm (D) x 2mm (A)
WAB300	Pilar estándar 5mm (D) x 3mm (A)
WAB400	Pilar estándar 5mm (D) x 4mm (A)
WAB550	Pilar estándar 5mm (D) x 5,5mm(A)
WCA51	Pilar cónico 5mm (D) x1mm(A)
WCA52	Pilar cónico 5mm (D) x2mm(A)
WCA53	Pilar cónico 5mm (D) x3mm(A)
WCA54	Pilar cónico 5mm (D) x4mm(A)
WCA55	Pilar cónico 5mm (D) x5,5mm(A)
WCA62	Pilar cónico 6mm (D) x2mm (A)
WCA63	Pilar cónico 6mm(D)x 3mm(A)
WCA65	Pilar cónico 6mm(D)x 5,5mm(A)
WCS66	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 6mm (P)
WCS67	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 7,5mm (P)
WCTC60	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) hexagonal
WCTC61	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) no hexagonal
WGA51C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 5mm (D)
WGA52C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 5mm (D)
WGA61C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 6mm (D)
WGA62C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 6mm (D)
WOSO20	Pilar O-Ring 5mm (D)x 2mm(A)


  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

8060




WOSO40	Pilar O-Ring 5mm (D)x 4mm(A)
WOSO60	Pilar O-Ring 5mm (D)x 6mm(A)
WPC51C	Pilar UCLA calcinable hexagonal 5mm(D)
WPC52C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal 5mm(D)
WPC61C	Pilar UCLA calcinable hexagonal con tornillo hexagonal 6mm(D)
WPC62C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal 6mm(D)
WPF554	Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
WPF556	Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)
WPF564	Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
WPF566	Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
WPF574	Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
WPF576	Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
WPF664	Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
WPF666	Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
WPF674	Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
WPF676	Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
WPFTC51	Cilindro provisorio PreFormance 5mm (hexagonal)
WPFTC52	Cilindro provisorio PreFormance 5mm (no-hexagonal)
WPFTC61	Cilindro provisorio PreFormance 6mm (hexagonal)
WPFTC62	Cilindro provisorio PreFormance 6mm (no-hexagonal)
WPP552	Poste Prep-Tite 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal
WPP552G	Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 2mm(A)
WPP554G	Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 4mm(A)
WPP562G	Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
WPP564G	Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
WPP572G	Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)
WPP574G	Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
WPP662	Poste Prep-Tite 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal

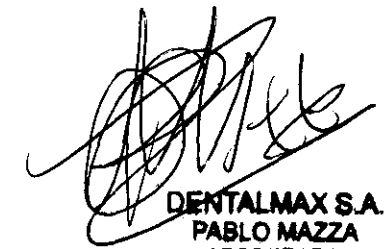
  
**DENTALMAX S.A.**  
**PABLO MAZZA**  
**APODERADO**

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA


8060



WPP662G	Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)
WPP664G	Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)
WPP672G	Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)
WPP674G	Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)
WT2553	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
WT2554	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
WT2556	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
WT2558	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 8mm(A)
WT2563	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
WT2564	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
WT2566	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
WT2568	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
WT2573	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
WT2574	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
WT2576	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
WT2578	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
WT2663	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 3mm(A)
WT2664	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 4mm(A)
WT2666	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 6mm(A)
WT2668	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 8mm(A)
WT2673	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
WT2674	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WT2676	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WT2678	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTC51	Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D)
WTC52	Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D).

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.D. 10898  
DIRECTORA TECNICA




WTC61	Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D)
WTC62	Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D).
WTCS51	Cilindro provisorio hexagonal 5mm(D) con retención
WTCS52	Cilindro provisorio no hexagonal 5mm(D) con retención
WTCS61	Cilindro provisorio hexagonal 6mm(D) con retención
WTCS62	Cilindro provisorio no hexagonal 6mm(D) con retención
WTH52	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 2mm(A)
WTH53	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
WTH54	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
WTH56	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
WTH562	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
WTH563	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
WTH564	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
WTH566	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
WTH568	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
WTH572	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH573	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)
WTH574	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH576	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH578	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH58	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm (P) x 8mm(A)
WTH62	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm(P) x 2mm(A)
WTH63	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 3mm(A)
WTH64	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 4mm(A)
WTH66	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 6mm(A)
WTH672	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH673	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA

0908



WTH674	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH676	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH678	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH68	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 8mm(A)
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZ	Pilar de diseñador de circonio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode / ZiReal Art
ICZTIS	Tornillo de prueba de circonio Encode / ZiReal Art

10. Lote N°

11. Fecha fabricación:

12. fecha Vto:


13. Ver Instrucciones de uso en el interior del envase.

14. Ver Precauciones, Advertencias y Contraindicaciones en instrucciones de uso.

15. Director técnico: Farmaceutica Sandra Broz – MN 10898

16. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-707-20.


17. Condición de venta: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

  
DENTALMAX S.A.  
PABLO MAZZA  
APODERADO

  
SANDRA BROZ  
M.N. 10898  
DIRECTORA TECNICA



8060







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.A.T.*

ANEXO III  
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-6308-11-8

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **0908** y de acuerdo a lo solicitado por DENTALMAX S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: COMPONENTES PROTÉSICOS PARA IMPLANTES DENTALES.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-744 – PRÓTESIS, DENTALES, IMPLANTABLES.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): BIOMET 3i.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Para utilizarse sobre los implantes dentales endoóseos con el fin de servir de soporte para dispositivos protésicos en pacientes parcial o totalmente desdentados, para utilizarse como soportes de prótesis de uno o varios dientes, en el maxilar inferior o en el maxilar superior, Las prótesis pueden atornillarse o cementarse al pilar.

Modelo/s: Fabricante: Changzhou Biomet Medical Devices Co. Ltd - CHINA

CLA20	análogo de laboratorio para pilar cónico 4,1 y 5 mm (d)
CS375	tornillo de cierre – implante 4,1mm(d)
CS500	tornillo de cierre – implante 5mm(d)
CS600	tornillo de cierre – implante 6mm(d)
IIC12	cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC41	cofia pick-up para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC44	cofia twist lock para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)
IIC45	cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)
IIC60	cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)
IILA20	análogo de laboratorio de implante certain 4,1mm(d)
IILAW5	análogo de laboratorio de implante certain 5,0mm(d)

..//

IILAW6	análogo de laboratorio de implante certain 6,0mm(d)
ILA20	análogo de laboratorio de implante 4,1mm(d)
ILAW5	análogo de laboratorio de implante 5,0mm(d)
ILAW6	análogo de laboratorio de implante 6,0mm(d)
IMMILA	análogo de laboratorio certain microminimplant 3,4mm(d)
IOLLAS	análogo de laboratorio iol
IWITSC	tornillo para cofia twist lock ep para implante certain (todos)
IWSU30	pin guía/tornillo de encerado certain
LTX310	implante ltx 3,75 x 10mm
LTX311	implante ltx 3,75 x 11mm
LTX313	implante ltx 3,75 x 13mm
LTX315	implante ltx 3,75 x 15,0mm
LTX3210	implante ltx 3,25 x 10mm
LTX3211	implante ltx 3,25 x 11,5mm
LTX3213	implante ltx 3,25 x 13,0mm
LTX3215	implante ltx 3,25 x 15,0mm
LTX3285	implante ltx 3,25 x 8,5mm
LTX385	implante ltx 3,75 x 8,5mm
LTX410	implante ltx 4,0 x 10,0mm
LTX411	implante ltx 4,0 x 11,5mm
LTX413	implante ltx 4,0 x 13,0mm
LTX415	implante ltx 4,0 x 15,0mm
LTX485	implante ltx 4,0 x 8,5mm
LTX510	implante ltx 5,0 x 10,0mm
LTX511	implante ltx 5,0 x 11,5mm
LTX513	implante ltx 5,0 x 13,0mm
LTX515	implante ltx 5,0 x 15,0mm
LTX585	implante ltx 5,0 x 8,5mm
LTX610	implante ltx 6,0 x 10,0mm
LTX611	implante ltx 6,0 x 11,5mm
LTX613	implante ltx 6,0 x 13,0mm



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

LTX615	implante ltx 6,0 x 15,0mm
LTX685	implante ltx 6,0 x 8,5mm
MMCLA	análogo de laboratorio cónico micromini 3,4mm(d)
MMCS1	tornillo de cierre microminimplant
MMILA	análogo de laboratorio para implante micromini 3,4mm(d)
NTOST3	osteótomo recto osseotite nt 3,25mm
NTOST3A	osteótomo angulado osseotite nt 3,25mm
NTOST4	osteótomo recto osseotite nt 4,0mm
NTOST4A	osteótomo angulado osseotite nt 4,0mm
NTOST5	osteótomo recto osseotite nt 5,0mm
NTOST5A	osteótomo angulado osseotite nt 5,0mm
NTOST6	osteótomo recto osseotite nt 6,0mm
NTOST6A	osteótomo angulado osseotite nt 6,0mm
OST01	osteótomo summers nro.1
OST02	osteótomo summers nro.2
OST03	osteótomo summers nro.3
OST04	osteótomo summers nro.4
OST05	osteótomo summers nro.5
OSTFS	osteótomo summers para emplazamiento futuro
PHD00N	destornillador hexagonal posterior estrecho-17mm
PHD01N	destornillador hexagonal estándar estrecho -24mm
PHD02N	destornillador hexagonal grande posterior estrecho -17mm
PHD03N	destornillador hexagonal grande estándar estrecho - 24mm
PSQD0N	destornillador cuadrado posterior estrecho - 17mm
PSQD1N	destornillador cuadrado estándar estrecho - 24mm
SLA20	análogo de laboratorio de pilar estándar (inoxidable)
WSK30	tornillo de encerado/pin guía 20mm (texturizado)
WSU30	uni-screw de prueba y de laboratorio texturizado
WT2668	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
WT2673	pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)

..//

WT2674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)  
WT2676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)  
WT2678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)  
WTH66 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6mm (p) x 6mm(a)  
WTH672 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
WTH673 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)  
WTH674 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)  
WTH676 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)  
WTH678 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)  
WTH68 pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6mm (p) x 8mm(a)  
CNRIC cofia pick-up ep conica (hexanogal) 4.1 y 5mm (d) x 5mm(p)  
CS275 tornillo de cierre, sin cabeza  
CSQ06 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)  
CSQ17 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)  
DRLAU análogo de laboratorio universal dal-ro  
IOLPIC cofia de impresión pick-up iol  
MIC33 cofia de impresión pick-up 3,4mm(d)  
MUNITS tornillo de prueba cuadrado 3,4mm(d)  
ORLAU análogo de pilar o-ring universal  
OSO20S tornillo para pilar o-ring 4,1mm(d) x 2mm(a)  
OSODH capuchón o-ring  
PAA484 análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 4,0mm  
PAA485 análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 5,5mm  
PAA654 análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 4,0mm  
SQIC7 cofia pick-up para pilar estándar  
UNIST tornillo uniscrew cuadrado de titanio  
WITSC tornillo de cofia twist lock ep para implante (todos)  
WSK10 tornillo de encerado/pin guía texturizado 10mm





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.F.*

..//

WSK15 tornillo de encerado/pin guía texturizado 15mm  
Fabricante: LX Precision (Shanghai) Co. Ltd. CHINA  
CS275 tornillo de cierre, sin cabeza  
CS375 tornillo de cierre – implante 4,1mm(d)  
CS500 tornillo de cierre – implante 5mm(d)  
CS600 tornillo de cierre – implante 6mm(d)  
IMCSF34 tornillo de cierre plano de 3,4mm (d) para implantes certain  
IMMCS1 tornillo de cierre certain 3,4mm(d)  
MMCS1 tornillo de cierre para implante 3,4mm(d)  
GS200 tornillo oro c/ranura -2mm  
GS300 tornillo oro c/ranura -3mm  
GSH20 tornillo de retención hexagonal gold-tite 2mm  
GSH30 tornillo de retención hexagonal gold-tite 3mm  
GSH70 tornillo de retención hexagonal gold-tite 7mm  
ILRGHG tornillo gold -tite certain hexagonal de diámetro ancho  
ILRGHT tornillo de titanio certain hexagonal de diámetro ancho  
IUNIHG tornillo hexagonal gold-tite certain  
IUNIHT tornillo hexagonal certain de titanio  
LGS30 tornillo de retención con ranura oro largo  
TSH30 tornillo de titanio hexagonal de 3mm  
UNIHG tornillo uniscrew hexagonal gold-tite  
UNIHT tornillo uniscrew hexagonal de titanio  
UNISG tornillo uniscrew cuadrado gold-tite  
UNIST tornillo uniscrew cuadrado de titanio  
EHA343 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x  
3,8mm (p) x 3,0mm (a)  
EHA344 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x  
3,8mm (p) x 4mm (a)  
EHA346 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x  
3,8mm (p) x 6mm (a)

..//

EHA348 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 8mm (a)

EHA353 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)

EHA354 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)

EHA356 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)

EHA358 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 3,4mm (d) x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)

EHA443 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 3,0mm (a)

EHA444 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 4,0mm (a)

EHA446 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 6,0mm (a)

U) EHA448 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 4,1mm (p) x 8,0mm (a)

EHA453 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)

EHA454 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)

EHA456 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)

EHA458 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)

EHA463 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)

EHA464 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

- EHA466 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA468 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA473 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA474 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA476 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA478 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 4,1mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 3,0mm (a)
- ✓ EHA554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 5,5mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5mm (d) x 5,5mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)
- EHA564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)
- EHA566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)
- EHA568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)
- EHA573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

..//

EHA574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

EHA576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

EHA578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 5,0mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

EHA663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 3,0mm (a)

EHA664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 4,0mm (a)

EHA666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 6,0mm (a)

U EHA668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 6,6mm (p) x 8,0mm (a)

EHA673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

EHA674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

EHA676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

EHA678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas encode de 6,0mm (d) x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA343 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA344 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA346 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA348 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 8,0mm (a)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

IEHA353 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA354 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA356 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA358 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 3,4mm (d)  
x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA443 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA444 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA446 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 6,0mm (a)

5

IEHA448 pilar de cicatrización de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d) x  
4,1mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA453 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA454 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA456 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA458 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 5,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA463 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA464 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA466 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)

..//

IEHA468 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA473 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA474 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA476 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA478 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 4,1mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 5,5mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 4,0mm (a)

IEHA566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 6,0mm (a)

IEHA568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 6,0mm (p) x 8,0mm (a)

IEHA573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)

IEHA574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)






*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.F.*

..//

- IEHA576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 5,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 6,6mm (p) x 8,0mm (a)
- IEHA673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm  
(d) x 7,5mm (p) x 3,0mm (a)
- IEHA674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 4,0mm (a)
- IEHA676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm  
(d) x 7,5mm (p) x 6,0mm (a)
- IEHA678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas certain encode de 6,0mm (d)  
x 7,5mm (p) x 8,0mm (a)
- IMHA32 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 2mm (a)
- IMHA33 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 3mm (a)
- IMHA34 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 4mm (a)
- IMHA36 pilar de cicatrización certain 3,4mm (d) x 3,8mm (p) 6mm (a)
- ISHA42 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x  
2mm(a)
- ISHA43 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x  
3mm(a)
- ISHA44 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x  
4mm(a)

..//

ISHA46 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x 6mm(a)  
ISHA48 pilar de cicatrización recto certain 4,1mm(d) x 0mm (p) x 8mm(a)  
ISMHA32 pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p)x 2mm(a)  
ISMHA33 pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p)x 3mm(a)  
ISMHA34 pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p) x 4mm(a)  
ISMHA36 pilar de cicatrización recto certain 3,4mm(d) x 3,4mm (p) x 6mm(a)  
ISWHA52 pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 2mm(a)  
ISWHA53 pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 3mm(a)  
ISWHA54 pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 4mm(a)  
ISWHA56 pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 6mm(a)  
ISWHA58 pilar de cicatrización recto certain 5mm(d) x 0mm(p) x 8mm(a)  
ISWHA62 pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 2mm(a)  
ISWHA63 pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 3mm(a)  
ISWHA64 pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 4mm(a)  
ISWHA66 pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 62mm(a)  
ISWHA68 pilar de cicatrización recto certain 6mm(d) x 0mm(p) x 8mm(a)  
ITHA52 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 2mm(a)  
ITHA53 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 3mm(a)  
ITHA54 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 4mm(a)  
ITHA56 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 6mm(a)  
ITHA58 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 5mm (p)x 8mm(a)  
ITHA63 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 3mm(a)  
ITHA64 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 4mm(a)  
ITHA66 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 6mm(a)  
ITHA68 pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 6mm (p)x 8mm(a)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

..//

ITHA73	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 3mm(a)
ITHA74	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 4mm(a)
ITHA76	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 6mm(a)
ITHA78	pilar de cicatrización certain ep 4,1mm (d) x 7,5mm (p)x 8mm(a)
IWTH52	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x2mm(a)
IWTH53	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x3mm(a)
IWTH54	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x4mm(a)
IWTH56	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 5,6mm (p)x6mm(a)
IWTH562	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x2mm(a)
IWTH563	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x3mm(a)
IWTH564	pilar de cicatrización certain ep 5mm(d)x 6mm (p)x4mm(a)
IWTH566	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 6mm (p) x 6mm (a)
IWTH568	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 6mm (p) x 8mm (a)
IWTH572	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 2mm (a)
IWTH573	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 3mm (a)
IWTH574	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 4mm (a)
IWTH576	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 6mm (a)
IWTH578	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 7,5mm (p) x 8mm (a)
IWTH58	pilar de cicatrización certain ep 5mm (d) x 5,6mm (p) x 8mm (a)
IWTH62	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 2mm (a)
IWTH63	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 3mm (a)
IWTH64	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 4mm (a)
IWTH66	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 6mm (a)
IWTH672	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 2mm (a)
IWTH673	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 3mm (a)
IWTH674	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 4mm (a)
IWTH676	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 6mm (a)
IWTH678	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 7,5mm (p) x 8mm (a)
IWTH68	pilar de cicatrización certain ep 6mm (d) x 6,8mm (p) x 8mm (a)
MHA32	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)
MHA33	pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 3mm(a)


5.



..//

MHA34 pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
MHA36 pilar de cicatrización ep 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)  
MHC33 capuchón cónico de cicatrización micromini 3,4mm(d)  
MT233 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
3mm(a)  
MT236 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
6mm(a)  
MT253 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x  
3mm(a)  
MT254 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x  
4mm(a)  
MT256 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 3,4mm(d) x 5mm(p) x  
6mm(a)  
TH253 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x3mm(a)  
TH253S tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x3mm  
TH254 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x4mm(a)  
TH254S tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x4mm  
TH256 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x6mm(a)  
TH256S tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x6mm  
TH258 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 5mm(p)x8mm(a)  
TH258S tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1x5x8mm  
TH263 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x3mm(a)  
TH264 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x4mm(a)  
TH266 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x6mm(a)  
TH268 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 6mm(p)x8mm(a)  
TH273 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x3mm  
(a)  
TH274 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x4mm  
(a)  
TH276 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x6mm  
(a)

5





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

- TH278 pilar de cicatrización de 2 piezas ep 4,1mm(d)x 7,5mm(p)x8mm  
(a)
- THA42 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 2mm(a)
- THA43 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 3mm(a)
- THA44 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 4mm(a)
- THA46 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 6mm(a)
- THA48 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 4,1mm(p) x 8mm(a)
- THA52 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)
- THA53 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 3mm(a)
- THA54 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)
- THA56 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)
- THA58 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 5mm(p) x 8mm(a)
- THA63 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)
- THA64 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
- THA66 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
- THA68 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
- THA73 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)
- THA74 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)
- THA76 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 6mm(a)
- THA78 pilar de cicatrización ep 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 8mm(a)
- THRC4 cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(d) x 4mm  
(a)
- THRC6 cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(d) x 6mm  
(a)
- WT2553 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x  
3mm(a)
- WT2554 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x  
4mm(a)
- WT2556 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x  
6mm(a)

..//

WT2558 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 5,6mm(p) x 8mm(a)  
WT2563 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)  
WT2564 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
WT2566 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)  
WT2568 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)  
WT2573 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)  
WT2574 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
WT2576 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 6mm(a)  
WT2578 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 5mm(d) x 7,5mm(p) x 8mm(a)  
WT2663 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 3mm(a)  
WT2664 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 4mm(a)  
WT2666 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 6mm(a)  
WT2668 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 6,8mm(p) x 8mm(a)  
WT2673 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm(p) x 3mm(a)  
WT2674 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)  
WT2676 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)  
WT2678 pilar de cicatrización ep de 2 piezas 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)  
WTH52 pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 2mm(a)








*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.A.T.*

..//

WTH53	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 3mm(a)
WTH54	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 4mm(a)
WTH56	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm(p) x 6mm(a)
WTH562	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)
WTH563	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 3mm(a)
WTH564	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)
WTH566	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)
WTH568	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 6mm(p) x 8mm(a)
WTH572	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 2mm(a)
WTH573	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)
WTH574	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
WTH576	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
WTH578	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
WTH58	pilar de cicatrización ep 5mm(d) x 5,6mm (p) x 8mm(a)
WTH62	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm(p) x 2mm(a)
WTH63	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 3mm(a)
WTH64	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 4mm(a)
WTH66	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 6mm(a)
WTH672	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)
WTH673	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 3mm(a)
WTH674	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 4mm(a)
WTH676	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 6mm(a)
WTH678	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 7,5mm (p) x 8mm(a)
WTH68	pilar de cicatrización ep 6mm(d) x 6,8mm (p) x 8mm(a)
IIOL20S	pilar iol certain 2mm
IIOL30S	pilar iol certain 3mm
IIOL40S	pilar iol certain 4mm
IIOL55S	pilar iol certain 5,5mm
IIOL70S	pilar iol certain 7mm
IOL20T	pilar con tornillo 2mm iol 2 piezas
IOL30T	pilar con tornillo 3mm iol 2 piezas todos aconsejan no usar

..//

IOL40T pilar con tornillo 4mm iol 2 piezas  
IOL55T pilar con tornillo 5,5mm iol 2 piezas  
IOL70T pilar con tornillo 7mm iol 2 piezas  
IOLDE extensión distal iol  
IOLGC cilindro oro iol  
IOLHC capuchón de cicatrización iol  
IOLTC cilindro provisorio iol  
GUCA1C cilindro pilar oro-hexagonal ucla 4,1mm (d)  
GUCA2C cilindro pilar oro no hexagonal ucla 4,1mm (d)  
GUCA3 pilar miniplant ucla oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)  
GUCA3S tornillo para pilar miniplant ucla oro (hexagonal interno)  
IGUCA1C cilindro pilar hexagonal oro certain ucla 4,1mm (d)  
IGUCA2C cilindro pilar no hexagonal oro certain ucla 4,1mm (d) con tornillo diámetro ancho  
IGUCA2T cilindro oro-no hexagonal ucla certain 4,1mm con tornillo de diámetro ancho de titanio  
IITCS41 cilindro provisorio hexagonal certain 4,1mm (d)  
IITCS42 cilindro provisorio no hexagonal certain 4,1mm (d) con tornillo de diámetro ancho  
IMMTCS1 cilindro provisorio hexagonal certain 3,4mm (d) con tornillo hexagonal  
IMMTCS2 cilindro provisorio de titanio micromini, unidad múltiple certain  
IMUCC2C pilar ucla certain calcinable no hexagonal 3,4mm(d)  
IMUCC2T pilar ucla certain calcinable no hexagonal 3,4mm(d)  
IMUCG1C pilar ucla certain oro hexagonal 3,4mm(d)  
IMUCG2C pilar ucla certain oro no hexagonal 3,4mm(d)  
IMUCG2T pilar ucla certain oro no hexagonal 3,4mm(d)  
IMUCT1 cilindro de titanio ucla micromini, unidad simple certain  
IMUCT2 cilindro de titanio ucla micromini, unidad múltiple certain





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

ITCH0 cilindro hexagonal provisorio para implante c/ tornillo hexagonal 4,1mm (d)  
ITCH1 cilindro no hexagonal provisorio para implante. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(d)  
ITCS41 cilindro hexagonal provisorio 4,1mm (d)  
ITCS42 cilindro no hexagonal provisorio 4,1mm (d) con retención  
ITUCA1 cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad simple certain  
ITUCA2 cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad múltiple certain  
ITUCA2C pilar de titanio-no hexagonal ucla certain 4,1mm (d) con tornillo de diámetro ancho  
IUNAB2C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 4,1mm (d) c/tornillo de diámetro ancho gold-tite  
IUNAB2T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 4,1mm (d) c/tornillo de titanio de diámetro ancho  
IWGA51C cilindro pilar hexagonal oro ucla certain 5mm (d)  
IWGA52C cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 5mm (d) con tornillo de diámetro ancho  
IWGA52T cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 5mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWGA61C cilindro pilar hexagonal oro ucla certain 6mm (d)  
IWGA62C cilindro pilar no hexagonal oro ucla certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho  
IWGA62T cilindro no hexagonal oro ucla certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWPC52C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 5mm (d) c/tornillo gold-tite de diámetro ancho  
IWPC52T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 5mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio  
IWPC62C cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 6mm (d) c/tornillo gold-tite de diámetro ancho

5

..//

IWPC62T cilindro ucla calcinable (no hexagonal) certain 6mm (d) c/tornillo de diámetro ancho de titanio

IWTA51 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad simple certain

IWTA52 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad múltiple certain

IWTCS51 cilindro provisorio hexagonal certain 5mm (d)

IWTCS52 cilindro provisorio no hexagonal certain 5mm (d) con tornillo de diámetro ancho

IWTCS61 cilindro provisorio hexagonal certain 6mm (d)

IWTCS62 cilindro provisorio no hexagonal certain 6mm (d) con tornillo de diámetro ancho

MCAT2 cilindro de titanio cónico micromini, unidad múltiple

MMTC1 cilindro provisorio 3,4mm (d) con tornillo hexagonal

MMTCS1 cilindro hexagonal provisorio 3,4mm(d) con retención

MMTCS2 cilindro de titanio provisorio micromini, hexagonal externo unidad múltiple

MUCC1C pilar calcinable hexagonal ucla 3,4mm(d)

MUCC2C pilar calcinable no hexagonal ucla 3,4mm(d)

MUCG1C pilar hexagonal oro ucla 3,4mm (d)

MUCG2C pilar no hexagonal oro ucla 3,4mm(d)

MUCT1 cilindro de titanio ucla micromini, unidad simple hexagonal externa

MUCT2 cilindro de titanio ucla micromini, unidad múltiple hexagonal externa

SGUCA1C cilindro pilar hexagonal zr ucla oro estándar 4,1mm (d)

SWGA51C cilindro pilar hexagonal zr estándar oro ucla 5mm(d)

SWGA61C cilindro pilar hexagonal zr estándar oro ucla 6mm(d)

TUCA1 cilindro de titanio ucla 4,1mm, unidad simple hexagonal externa

TUCA2C cilindro pilar no hexagonal de titanio ucla 4,1mm(d)

UNA125 cilindro ucla calcinable hexagonal paq. de 25

UNA225 cilindro ucla calcinable no hexagonal paq. de 25

UNAB1C cilindro ucla calcinable (hexagonal)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

UNAB2C cilindro ucla calcinable (no hexagonal)  
WGA51C cilindro pilar ucla oro hexagonal 5mm (d)  
WGA52C cilindro pilar ucla oro no hexagonal 5mm (d)  
WGA61C cilindro pilar ucla oro hexagonal 6mm (d)  
WGA62C cilindro pilar ucla oro no hexagonal 6mm (d)  
WPC51C pilar ucla calcinable hexagonal 5mm(d)  
WPC52C pilar ucla calcinable no hexagonal 5mm(d)  
WPC61C pilar ucla calcinable hexagonal 6mm(d)  
WPC62C pilar ucla calcinable no hexagonal 6mm(d)  
WTA51 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad simple hexagonal externa  
WTA52 cilindro de titanio ucla 5,0mm, unidad múltiple hexagonal externa  
WTC51 cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal  
5mm(d)  
WTC52 cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo  
hexagonal 5mm(d).  
WTC61 cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal  
6mm(d)  
WTC62 cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo  
hexagonal 6mm(d).  
WTCS51 cilindro provisorio hexagonal 5mm(d) con retención  
WTCS52 cilindro provisorio no hexagonal 5mm(d) con retención  
WTCS61 cilindro provisorio hexagonal 6mm(d) con retención  
WTCS62 cilindro provisorio no hexagonal 6mm(d) con retención  
IMPAPF34 poste preangulado 15° certain performance 3,4mm(d) x  
3,8mm(p) x 4mm(a)  
IMPAPF36 poste preangulado 15° certain performance 3,4mm(d) x  
3,8mm(p) x 6mm(a)  
IMPFP34 poste certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
IMPFP36 poste certain performance 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)  
IMPFTC32 cilindro provisorio certain performance 3,4mm (no hexagonal)  
IMPFTC34 cilindro provisorio certain performance 3,4mm (hexagonal)

..//

IPAPF454 poste preangulado15° certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IPAPF456 poste preangulado15° certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)

IPAPF554 poste preangulado15° certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IPAPF556 poste preangulado15° certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)

IPAPF664 poste preangulado15° certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IPAPF666 poste preangulado15° certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)

IPFP454 poste certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IPFP456 poste certain performance 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)

IPFTC41 cilindro provisorio certain performance 4,1mm (hexagonal)

IPFTC42 cilindro provisorio certain performance 4,1mm (no hexagonal)

IWPFP554 poste certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IWPFP556 poste certain performance 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm(a)

IWPFP664 poste certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IWPFP666 poste certain performance 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm(a)

IWPFTC51 cilindro provisorio certain performance 5mm (hexagonal)

IWPFTC52 cilindro provisorio certain performance 5mm (no hexagonal)

IWPFTC61 cilindro provisorio certain performance 6mm (hexagonal)

IWPFTC62 cilindro provisorio certain performance 6mm (no hexagonal)

MPAPF34 poste performance preangulado 15° 3,4mm (d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)

MPAPF36 poste performance preangulado 15° 3,4mm (d) x 3,8mm(p) x 6mm(a)

MPFP34 poste performance de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 4mm (a)

MPFP36 poste performance de 3,4mm (d) x 3,8mm (p) x 6mm (a)

MPFTC32 cilindro provisorio performance de 3,4mm (no hexagonal)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

MPFTC34	cilindro provisorio performance de 3,4mm (hexagonal)
PAPF454	poste performance preangulado 15° 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm (a)
PAPF456	poste performance preangulado 15° 4,1mm(d) x 5mm(p) x 6mm (a)
PAPF554	poste performance preangulado 15° 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm (a)
PAPF556	poste performance preangulado 15° 5mm(d) x 5mm(p) x 6mm (a)
PAPF664	poste performance preangulado 15° 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm (a)
PAPF666	poste performance preangulado 15° 6mm(d) x 6mm(p) x 6mm (a)
PFP454	poste performance de 4,1mm (d) x 5mm (p) x 4mm (a)
PFP456	poste performance de 4,1mm (d) x 5mm (p) x 6mm (a)
PFTC41	cilindro provisorio performance (hexagonal) de 4,1mm
PFTC42	cilindro provisorio performance (no hexagonal) de 4,1mm
WFPF554	poste performance de 5mm (d) x 5mm (p) x 4mm (a)
WFPF556	poste performance de 5mm (d) x 5mm (p) x 6mm (a)
WFPF664	poste performance de 6mm (d) x 6mm (p) x 4mm (a)
WFPF666	poste performance de 6mm (d) x 6mm (p) x 6mm (a)
WPFTC51	cilindro provisorio performance 5mm (hexagonal)
WPFTC52	cilindro provisorio performance 5mm (no hexagonal)
WPFTC61	cilindro provisorio performance 6mm (hexagonal)
WPFTC62	cilindro provisorio performance 6mm (no hexagonal)
AC4217	pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(d) x 2mm(a)
AC4225	pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(d) x 2mm(a)
AC4417	pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(d) x 4mm(a)
AC4425	pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(d) x 4mm(a)
CA001	pilar cónico 4,1mm (d)x 1mm (a)
CA001S	tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 1mm (a)

..//

CA002 pilar cónico 4,1mm (d)x 2mm (a)  
CA002S tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 2mm (a)  
CA003 pilar cónico 4,1mm (d)x 3mm (a)  
CA003S tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 3mm (a)  
CA004 pilar cónico 4,1mm (d)x 4mm (a)  
CA004S tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 4mm (a)  
CA055 pilar cónico 4,1mm (d)x 5,5mm (a)  
CA055S tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (d) x 5,5mm (a)  
CACC5 cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1mm y 5mm  
CAGC5 cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (d)  
CAGC6 cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (d)  
CATC5 cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (d)  
CC300 cilindro provisorio cónico no hexagonal  
CNC30 cilindro cónico provisorio hexagonal.  
✓ CNRC5 cilindro cónico calcinable hexagonal 4,1mm y 5mm(d)  
- CNRG5 cilindro oro cónico hexagonal 4,1 y 5mm (d)  
CNRG6 cilindro oro cónico hexagonal 6mm (d)  
CS250 tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 5mm (p)  
CS260 tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 6mm (p)  
CS270 tapa de cicatrización ep cónica de 4,1 y 5mm (d) x 7,5mm (p)  
IAC4217 pilar certain cónico angulado 17° 4,1mm(d) x 2mm(a)  
IAC4225 pilar certain cónico angulado 25° 4,1mm(d) x 2mm(a)  
IAC4417 pilar certain cónico angulado 17° 4,1mm(d) x 4mm(a)  
IAC4425 pilar certain cónico angulado 25° 4,1mm(d) x 4mm(a)  
ICA001 pilar cónico certain 4,1mm (d) x 1mm (a)  
ICA001S tornillo para pilar cónico certain 4,1 y 5mm (d) x 1mm (a)  
ICA002 pilar cónico certain 4,1mm (d) x 2mm (a)  
ICA002S tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 2mm (a)  
ICA003 pilar cónico certain 4,1mm (d) x 3mm (a)  
ICA003S tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 3mm (a)  
ICA004 pilar cónico certain 4,1mm (d) x 4mm (a)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

ICA004S	tornillo para pilar cónico certain 4,1 y 5mm (d) x 4mm (a)
ICA055	pilar cónico certain 4,1mm (d) x 5,5mm (a)
ICA055S	tornillo para pilar cónico certain 4,1mm y 5mm (d) x 5,5mm (a)
IMCA31	pilar cónico certain 3,4mm (d) x 1mm (a)
IMCA32	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 2mm (a)
IMCA33	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 3mm (a)
IMCA34	pilar cónico certain 3,4mm (d)x 4mm (a)
IWCA51	pilar cónico certain 5mm (d) x 1mm (a)
IWCA52	pilar cónico certain 5mm (d) x 2mm (a)
IWCA53	pilar cónico certain 5mm (d) x 3mm (a)
IWCA54	pilar cónico certain 5mm (d) x 4mm (a)
IWCA55	pilar cónico certain 5mm (d) x 5,5mm (a)
IWCA61	pilar cónico certain 6mm (d) x 1mm (a)
IWCA62	pilar cónico certain 6mm (d) x 2mm (a)
IWCA63	pilar cónico certain 6mm (d) x 3mm (a)
IWCA64	pilar cónico certain 6mm (d) x 4mm (a)
IWCA65	pilar cónico certain 6mm (d) x 5,5mm (a)
MCA31	pilar cónico 3,4mm(d) x 1mm(a)
MCA32	pilar cónico 3,4mm(d) x 2mm(a)
MCA33	pilar cónico 3,4mm(d) x 3mm(a)
MCA34	pilar cónico 3,4mm(d) x 4mm(a)
MCAG1	cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm(d)
MCAG2	cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm(d)
MCTC1	cilindro provisorio cónico hexagonal
MCTC2	cilindro provisorio cónico no hexagonal
MITC2	cilindro de titanio cono corto no hexagonal
QBCAP	tapa quickbridge
QKBRG	cilindro y tapa quickbridge
SCA001	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 1mm (a)
SCA002	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 2mm (a)
SCA003	pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 3mm (a)

5.

..//

SCA004 pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 4mm (a)  
SCA055 pilar cónico oro estándar zr 4,1mm (d) x 5,5mm (a)  
SWCA51 pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x1mm (a)  
SWCA52 pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x2mm (a)  
SWCA53 pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x3mm (a)  
SWCA54 pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x4mm (a)  
SWCA55 pilar cónico oro estándar zr tm 5mm (d)x5,5mm (a)  
SWCA61 pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x1mm (a)  
SWCA62 pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x2mm (a)  
SWCA63 pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x3mm (a)  
SWCA64 pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x4mm (a)  
SWCA65 pilar cónico oro estándar zr tm 6mm (d)x5,5mm (a)  
TRC30 cilindro de retención provisorio  
WCA51 pilar cónico 5mm (d) x1mm(a)  
WCA52 pilar cónico 5mm (d) x2mm(a)  
WCA53 pilar cónico 5mm (d) x3mm(a)  
WCA54 pilar cónico 5mm (d) x4mm(a)  
WCA55 pilar cónico 5mm (d) x5,5mm(a)  
WCA62 pilar cónico 6mm (d) x2mm (a)  
WCA63 pilar cónico 6mm(d)x 3mm(a)  
WCA65 pilar cónico 6mm(d)x 5,5mm(a)  
WCS66 tapa de cicatrización ep cónica de 6mm (d) x 6mm (p)  
WCS67 tapa de cicatrización ep cónica de 6mm (d) x 7,5mm (p)  
WCTC60 cilindro provisorio cónico ep 6mm(d)x6mm(p) hexagonal  
WCTC61 cilindro provisorio cónico ep 6mm(d)x6mm(p) no hexagonal  
AG900 kit de guías anguladas (set de 9 piezas)  
BB001 caja organizadora esterilizable  
BPAKTB caja organizadora para kit de perfilador óseo de diametro ancho  
BPGUIDE guía para perfilador óseo  
BPKITB caja organizadora para kit de perfilador óseo de diámetro estándar





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

..//

CADD1	controlador de mando directo contra ángulo
CATC1	controlador de torque contra ángulo 10ncm
CATC2	controlador de torque contra ángulo 20ncm
CATC3	controlador de torque contra ángulo 32ncm
CATDH	mango de destornillador de torque contra ángulo
CDI4500	indicador de profundidad de avellanado para cd4500
CDI5600	indicador de profundidad de avellanado para cd5600
CLA20	análogo de laboratorio para pilar cónico 4,1 y 5 mm (d)
CW100	llave de boca
DI100	indicador de dirección
DI200	indicador de dirección - largo
DI2310	indicador de dirección 2,3mm(d) x 10mm(l)
DI2315	indicador de dirección 2,3mm(d) x 15mm(l)
DP020	sonda de profundidad para implante
DRFAT1	herramienta de ajuste de la hembra dal-ro
DRLAU	análogo de laboratorio universal dal-ro
DSB100	bloque para corte de topes de fresas
DU1IT	tubería de irrigación du100
DU1ITP	pin de tubo de irrigación
IBPGP	guía certain para perfilador óseo (paq. de 3) 4,1; 5,0; 6mm(d)
IBPMGP	pin guía de perfilador óseo 3,4mm certain (paq. de 3)
IC015	montura de implante 15mm
ICD00	transportador de cofias de impresión estrecho
ICDI100	indicador de profundidad de avellanado para icd100
IDI001	indicador de dirección certain 10mm(l)
IDIKT	kit indicador de dirección certain
IDIM01	indicador de dirección certain para implante 3,25mm(d) x 10mm(l)
IH300	pieza de inserción de agarradera de implante
IILA20	análogo de laboratorio de implante certain 4,1mm(d)
IILAW5	análogo de laboratorio de implante certain 5,00mm(d)

5

..//

IILAW6 análogo de laboratorio de implante certain 6,00mm(d)  
ILA20 análogo de laboratorio de implante 4,1mm(d)  
ILAW5 análogo de laboratorio de implante 5,0mm(d)  
ILAW6 análogo de laboratorio de implante 6,0mm(d)  
ILT150 pulidor y guía certain ucla  
ILTAH57 agarradera de pilar de laboratorio certain  
IMBP4 perfilador óseo manual certain 4,1mm(d)/5mm(p)  
IMBP5 perfilador óseo manual certain 5,0mm(d)/6,0mm(p)  
IMLT150 pulidor 3,4mm(d) certain con guía  
IMMBP perfilador óseo manual certain, 3,4mm(d) x 4,1mm(p)  
IMMILA análogo de laboratorio certain 3,4mm(d)  
IMRE100 extensor certain corto para llave de carraca, 3,4mm(d)  
IMRE200 extensor certain largo para llave de carraca, 3,4mm(d)  
IOLLAS análogo de laboratorio recto iol  
IOLPP protector de pulido iol  
IPPIA3 protector de pulido certain ucla 4,1mm(d)  
IPPIA5 protector de pulido certain ucla 5mm(d)  
IPPIA6 protector de pulido certain ucla 6mm(d)  
IPPM1 protector de pulido certain ucla 3,4mm(d)  
IQSA01 activador quickseat certain  
IRE100 extensor certain para llave de carraca corto 4,1; 5,0; 6,0mm(d)  
IRE200 extensor certain para llave de carraca largo 4,1; 5,0; 6,0mm(d)  
IRH600 escariador con manija certain  
IRH600RMR escariador calcinable ucla certain  
IRORDR o rings de repuesto para destornillador certain, cant: 10  
ISRT01 terraja manual certain  
ISRT05 manija guía certain  
ISRT06 herramienta para remoción de tornillo certain  
ISRT07 fresa reversible manual  
IWITSC tornillo twist lock certain  
IWSU30 pin guía/tornillo de encerado certain





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

LA200	análogo de laboratorio pilar estándar (latón)
LALA1	análogo de laboratorio pilar locator
LOA8397	herramienta para remoción de macho locator
LOAD	fresa para conector de barra locator para rosca de 2mm
LOAT	terraja para barra locator para rosca de 2mm
LPCAMI	pulidor para pilar de perfil bajo
LPCLA	análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo
LPCPP	protector de pulido para pilar de perfil bajo
LPCWS	tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
LT150	pulidor para pilar ucla de plástico calcinable
LTAH5	agarradera para pilar de laboratorio para 3,4mm(d)
LTAH7	agarradera de laboratorio para 4,1; 5,0; 6,0mm(d)
MALL1	martillo, acero inoxidable
MBP4	perfilador óseo manual 4,1mm(d) x 5mm(p)
MBP5	perfilador óseo manual 5mm(d) x 6mm(p)
MDR10H	adaptador para llave de carraca tg
ME100	elevador de membranas pequeño
ME200	elevador de membranas mediano
ME300	elevador de membranas grande
MIDTH	mango para punta transportadora intercambiable manual
MLT150	pulidor con guía para 3,4mm(d)
MMBP	perfilador óseo manual 3,4mm(d) x 4,1mm(p)
MMC03	montura de implante 3,4mm(d) x 3mm(l)
MMC15	montura de implante 3,4mm(d) x 15mm(l)
MMCLA	análogo de laboratorio cónico 3,4mm(d)
MMILA	análogo de laboratorio 3,4mm(d)
MMKIT	kit de montura de implante 3,4mm(d)
MSGIAM1	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 1(l)
MSGIAM2	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 2(l)
MSGIAM3	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 3(l)
MSGIAM4	montura para análogo navigator certain, 3,4mm(d) x 4(l)



..//

MSGIAML montura para análogo navigator 3,4mm(d) largo  
MSGIAMS montura para análogo navigator 3,4mm(d) corto  
MSGIIM1 montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 1(l)  
MSGIIM2 montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 2(l)  
MSGIIM3 montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 3(l)  
MSGIIM4 montura para implante navigator certain, 3,4mm(d) x 4(l)  
MSGIIML montura para implante navigator certain 3,4mm(d) largo  
MSGIIMS montura para implante navigator certain 3,4mm(d) corto  
MUNITS tornillo de prueba cuadrado 3,4mm(d)  
MWS15 tornillo de encerado a nivel del implante para 3,4mm(d)  
NTDI3210 indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm(d) x 10mm(l)  
NTDI3211 indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm(d) x 11,5mm(l)  
NTDI3213 indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 13mm(l)  
NTDI3215 indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 15mm(l)  
NTDI3285 indicador de profundidad osseotite nt 3,25mm (d) x 8,5mm(l)  
NTDI410 indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 10mm(l)  
NTDI411 indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 11,5mm(l)  
NTDI413 indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 13mm(l)  
NTDI415 indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 15mm(l)  
NTDI485 indicador de profundidad osseotite nt 4mm(d) x 8,5mm(l)  
NTDI510 indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 10mm(l)  
NTDI511 indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 11,5mm(l)  
NTDI513 indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 13mm(l)  
NTDI515 indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 15mm(l)  
NTDI585 indicador de profundidad osseotite nt 5mm(d) x 8,5mm(l)  
NTDI610 indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 10mm(l)  
NTDI611 indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 11,5mm(l)  
NTDI613 indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 13mm(l)  
NTDI615 indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 15mm(l)  
NTDI685 indicador de profundidad osseotite nt 6mm(d) x 8,5mm(l)  
NTDIKT bandeja para indicador de profundidad osseotite nt

5,





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.N.M.S.P.*

..//

NTOST0 kit de sistema de osteótomo cónico natural – recto  
NTOST0A kit de sistema de osteótomo cónico natural – angulado  
NTOST3 osteótomo recto osseotite nt 3,25mm  
NTOST3A osteótomo angulado osseotite nt 3,25mm  
NTOST4 osteótomo recto osseotite nt 4,0mm  
NTOST4A osteótomo angulado osseotite nt 4,0mm  
NTOST5 osteótomo recto osseotite nt 5,0mm  
NTOST5A osteótomo angulado osseotite nt 5,0mm  
NTOST6 osteótomo recto osseotite nt 6,0mm  
NTOST6A osteótomo angulado osseotite nt 6,0mm  
NTOSTTRA bandeja para osteótomo osseotite nt - angulado  
NTOSTTRS bandeja para osteótomo osseotite nt - recto  
NTT300S arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño gris paq. x 2  
NTT301 arandelas aislantes para ntt300, diámetro mediano gris paq. x 2  
NTT302 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño violeta paq. x  
2  
NTT303 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño verde paq. x  
2  
NTT304 arandelas aislantes para ntt300, diámetro pequeño amarillo paq.  
x 2  
ORCG1 clip tipo hader oro  
ORCY1 clip tipo hader plástico  
ORLAU análogo de pilar o-ring universal  
OST00 kit de osteótomos summers nros. 1-4  
OST01 osteótomo summers nro.1  
OST02 osteótomo summers nro.2  
OST03 osteótomo summers nro.3  
OST04 osteótomo summers nro.4  
OST05 osteótomo summers nro.5  
OST10 kit de osteótomos summers nros.1-5  
OST20 kit de osteótomos summers nros.1-5 y emplazamiento futuro

..//

OSTFS	osteótomo summers para emplazamiento futuro
OSTTR	bandeja para sistema de osteótomo
PAA484	análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 4,0mm
PAA485	análogo de pilar provide 4,8mm(p) – poste 5,5mm
PAA654	análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 4,0mm
PAA655	análogo de pilar provide 6,5mm(p) – poste 5,5mm
PAAP48	análogo de pilar provide con pin 4,8mm(p)
PAAP65	análogo de pilar provide con pin 6,5mm(p)
PAD00	transportador para pilares posterior 17mm
PAD01	transportador para pilares dalro/o-ring
PAD03	transportador para pilares dal-ro
PAD24	transportador para pilares estándar 24mm(l)
PHD00N	destornillador hexagonal posterior estrecho-17mm
PHD01N	destornillador hexagonal estándar estrecho -24mm
PHD02N	destornillador hexagonal grande posterior estrecho -17mm
PHD03N	destornillador hexagonal grande estándar estrecho - 24mm
PMKIT	kit de guía de medición preangulada
PPCA3	pilar cónico protector de pulido
PPIA3	pilar ucla protector de pulido 4,1mm(d)
PPMC1	pilar cónico 3,4mm(d), protector de pulido
PPMM1	pilar ucla 3,4mm(d), protector de pulido
PPSA3	pilar estándar protector de pulido
PSD00	destornillador para tornillos posteriores -17mm
PSD01	destornillador estándar -24mm
PSDT1	bandeja para destornillador de sistema protésico
PSQD0N	destornillador cuadrado posterior estrecho – 17mm
PSQD1N	destornillador cuadrado estándar estrecho – 24mm
PTT100	bandeja organizadora de plástico
PTT300G	arandelas aislantes para ptt300 (paq. x 2)
PTT300GS	arandelas aislantes para ptt300, diámetro pequeño (paq. x 2)
PTT300I	bandeja quirúrgica certain para implantes rectos








*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.A.T.*

..//

PTT300UI	pieza de inserción moldeada certain para actualización de kit pskt30u
PWS48M	manguito de encerado provide 4,8mm(p) – unidad múltiple
PWS48S	manguito de encerado provide 4,8mm(p) – unidad simple
PWS65M	manguito de encerado provide 6,8mm(p) – unidad múltiple
PWS65S	manguito de encerado provide 6,8mm(p) – unidad simple
QNTSKI	pieza de inserción moldeada para kit quirúrgico de fresa quad
QNTSKT	base, pieza de inserción moldeada y cubierta ahumada liviana para el kit quirúrgico de fresas quad
RE100	extensor de llave de carraca de 6mm de largo
RE200	extensor de llave de carraca de 15mm de largo
RH600	escariador con mango para hex. externo
RMB30	bolas de marcación radiográfica (paq. de 30)
RTI2035	indicador de torque para restauración
RTI2035TR	bandeja de indicador de torque para restauración
SEKT1	kit de elevación de senos
SEKTR	bandeja de elevación de senos (sola)
SGDPH1	tutor de posicionamiento de fresas navigator, 1
SGDPH2	tutor de posicionamiento de fresas navigator, 2
SGDPH3	tutor de posicionamiento de fresas navigator, 3
SGDPH4	tutor de posicionamiento de fresas navigator, 4
SGDPH5	tutor de posicionamiento de fresas navigator, 5
SGFT24	tubo de fijación navigator (paq. de 25) 2mm(d) x 4mm(l)
SGIAM41	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 1 (l)
SGIAM42	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 2 (l)
SGIAM43	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 3 (l)
SGIAM44	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) x 4 (l)
SGIAM4L	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) larga
SGIAM4S	montura de análogo certain navigator, 4,1mm(d) corta
SGIAM51	montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 1 (l)
SGIAM52	montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 2 (l)



..//

SGIAM53 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 3 (l)  
SGIAM54 montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) x 4 (l)  
SGIAM5L montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) larga  
SGIAM5S montura de análogo certain navigator, 5,0mm(d) corta  
SGIIM41 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 1 (l)  
SGIIM42 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 2 (l)  
SGIIM43 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 3 (l)  
SGIIM44 montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) x 4 (l)  
SGIIM4L montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) larga  
SGIIM4S montura de implante certain navigator, 4,1mm(d) corta  
SGIIM51 montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 1 (l)  
SGIIM52 montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 2 (l)  
SGIIM53 montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 3 (l)  
SGIIM54 montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) x 4 (l)  
SGIIM5L montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) larga  
SGIIM5S montura de implante certain navigator, 5,0mm(d) corta  
SGLKIT kit de laboratorio navigator  
SGLTRAY bandeja de laboratorio navigator  
SGMT44 tubo maestro navigator (paq. de 25) 4,1mm(d) x 4mm(a)  
SGMT54 tubo maestro navigator (paq. de 25) 5,0mm(d) x 4mm(a)  
SGT25 tubo guía para férula (paq. de 25)  
SGTDPHR tutor de posicionamiento para fresa de reducción navigator  
cónico  
SGTDPHT tutor de posicionamiento para fresa espiral twist drill navigator  
cónica  
SGTILKIT kit de laboratorio certain navigator cónico  
SGTLTRAY bandeja de laboratorio navigator cónico  
SGTRAY bandeja quirúrgica navigator  
SGTTAPT bandeja de terraja ósea navigator cónica  
SGTTRAY bandeja quirúrgica navigator cónica  
SLA20 análogo de laboratorio de pilar estándar (inoxidable)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

..//

SRT01 terraja manual para srt10  
SRT02 fresa manual 1,04mm(d) fresa de bronce para srt10  
SRT03 fresa manual 1,18mm(d) fresa de plata para srt10  
SRT05 tutor guía para srt10  
STLA5 análogo de laboratorio pilar sta 4,1mm y 5mm(d)  
TE003 elevador de titanio  
TF002 pinzas de titanio  
TIBC1 transportador de hueso revestido de nitruro de titanio para sekt1  
TIPL1 taponador de titanio grande  
TIPS1 taponador de titanio pequeño  
TMP80 poste de medición de tejidos  
TP001 bisturí circular para tejido 4,1mm(d)  
TP005 bisturí circular para tejido 5mm(d)  
TP006 bisturí circular para tejido 6mm(d)  
TT150 bandeja para entrega de implante  
UNITS tornillo cuadrado de prueba universal (paq. de 5)  
WCLA6 análogo de laboratorio pilar cónico 6mm(d)  
WCPP6 protector de pulido 6mm cónico  
WITSC tornillo de cofia twist lock ep para implante (todos)  
WLT10 pulidor para implante de diámetro ancho  
WPP50 protector de pulido 5mm(d)  
WPP60 protector de pulido 6mm(d)  
WR150 llave de carraca  
WSK10 tornillo de encerado/pin guía texturizado 10mm  
WSK15 tornillo de encerado/pin guía texturizado 15mm  
WSK30 tornillo de encerado/pin guía texturizado 20mm  
WSU30 pin guía/tornillo de encerado para implante texturizado  
XDG00 kit de sondas de profundidad para rayos x gelb  
XDG01 kit de sondas de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d)  
XDG13 sonda de profundidad para rayos x gelb 13mm  
XDG20 sonda de profundidad para rayos x gelb 20mm

5-

..//

XDG2313 sonda de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d) x 13mm(l)  
XDG2320 sonda de profundidad para rayos x gelb 2,3mm(d) x 20mm(l)  
CIC55 cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)  
CIC56 cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)  
CIC57 cofia twist lock ep cónica 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)  
CNRIC cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)  
CSQ06 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)  
CSQ07 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)  
CSQ17 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 5mm(p)  
CSQN6 cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 6mm(p)  
CSQN7 cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 4,1 y 5mm(d) x 7,5mm(p)  
IC100 cofia de impresión quirúrgica  
ICZTIS tornillo de prueba encode zircon  
IIC12 cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC41 cofia pick-up para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC44 cofia twist lock para implante 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC45 cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC46 cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)  
IIC47 cofia twist lock ep para implante 4,1mm(d) x 7,5mm(p)  
IIC60 cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 6mm(p)  
IIC75 cofia pick-up ep para implante 4,1mm(d) x 7,5mm(p)  
IIC12 cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC41 cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC42 cofia pick-up para implante no hexagonal certain 4,1mm(d) x  
4,1mm(p)  
IIC44 cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 4,1mm(p)  
IIC45 cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 5mm(p)  
IIC46 cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 6mm(p)  
IIC47 cofia twist lock certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p)  
IIC60 cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 6mm(p)  
IIC75 cofia pick-up certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

..//

IMIC30	cofia pick up recta certain 3,4mm(d) x 0mm(p)
IMIC33	cofia pick up certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p)
IOLPIC	cofia de impresión pick-up iol
IOLTIC	cofia de impresión de transferencia iol
IUNITS	tornillo de prueba hexagonal certain (paq. de 5) 3,4; 4,1; 5,0; 6,0mm(d)
IWIP50	cofia pick-up recta certain 5,0mm(d) x 0mm(p)
IWIP55	cofia pick-up certain 5mm(d) x 5mm(p)
IWIP56	cofia pick-up certain 5mm(d) x 6mm(p)
IWIP57	cofia pick-up certain 5mm(d) x 7,5mm(p)
IWIP60	cofia pick-up recta certain 6,0mm(d) x 0mm(p)
IWIP66	cofia pick-up certain 6,0mm(d) x 6mm(p)
IWIP67	cofia pick-up certain 6,0mm(d) x 7,5mm(p)
IWIT50	cofia de transferencia recta twist lock certain 5,0mm(d) x 0mm(p)
IWIT55	cofia twist lock certain 5mm(d) x 5mm(p)
IWIT56	cofia twist lock certain 5mm(d) x 6mm(p)
IWIT57	cofia twist lock certain 5mm(d) x 7,5mm(p)
IWIT60	cofia de transferencia recta twist lock certain 6,0mm(d) x 0mm(p)
IWIT66	cofia twist lock certain 6mm(d) x 6mm(p)
IWIT67	cofia twist lock ep para implante certain 6mm(d) x 7,5mm(p)
IZIRTS	tornillo de prueba hexagonal zireal certain
LAIC1	cofia de impresión para pilar locator
LPCPIC1	cofia de impresión pick-up para pilar de perfil bajo (hexagonal)
LPCPIC2	cofia de impresión pick-up para pilar de perfil bajo (no hexagonal)
LPCRIC	cofia de impresión quickbridge para pilar de perfil bajo
LPTIC1	cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo

..//

LPCTIC2 cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo

MEC33 cofia pick-up para pilar cónico 3,4mm(d)

MIC33 cofia de impresión pick-up 3,4mm(d)

PIC484 cofia de impresión provide 4,8mm(d) – poste de 4,0mm

PIC484H cofia de impresión provide con orificios 4,8mm(d) – poste de 4,0mm

PIC485 cofia de impresión provide 4,8mm(d) – poste de 5,5mm

PIC485H cofia de impresión provide con orificios 4,8mm(d) – poste de 5,5mm

PIC654 cofia de impresión provide 6,5mm(d) – poste de 4,0mm

PIC654H cofia de impresión provide con orificios 6,5mm(d) – poste de 4,0mm

PIC655 cofia de impresión provide 6,5mm(d) – poste de 5,5mm

PIC655H cofia de impresión provide con orificios 6,5mm(d) – poste de 5,5mm

SIC70 cofia de transferencia para pilar estándar

SQIC7 cofia pick-up para pilar estándar

WCP661 cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)

WCP662 cofia pick-up ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)

WCP671 cofia pick-up ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)

WCT661 cofia twist lock ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)

WCT662 cofia twist lock ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 6mm(p)

WCT671 cofia twist lock ep cónica (hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)

WCT672 cofia twist lock ep cónica (no hexagonal) 6mm(d) x 7,5mm(p)

WIP55 cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 5mm(p)

WIP56 cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 6mm(p)

WIP57 cofia pick-up ep para implante 5mm(d) x 7,5mm(p)

WIP66 cofia pick-up ep para implante 6mm(d) x 6mm(p)

WIP67 cofia pick-up ep para implante 6mm(d) x 7,5mm(p)

WIT55 cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 5mm(p)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.A.T.*

..//

WIT56 cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 6mm(p)  
WIT57 cofia twist lock ep para implante 5mm(d) x 7,5mm(p)  
WIT66 cofia twist lock ep para implante 6mm(d) x 6mm(p)  
WIT67 cofia twist lock ep para implante 6mm(d) x 7,5mm(p)  
APP42 poste prep-tite 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a) con tornillo hexagonal de titanio  
APP452G poste gingihue 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
APP454G poste gingihue 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
APP462G poste gingihue 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
APP464G poste gingihue 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
APP472G poste gingihue 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
APP474G poste gingihue 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
IAPP452G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
IAPP454G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
IAPP462G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
IAPP464G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
IAPP472G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
IAPP474G poste gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
IMAP32G poste gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)  
IMAP34G poste gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
IMPAP32G poste angulado 15° gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 2mm(a)  
IMPAP34G poste angulado 15° gingihue certain 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x 4mm(a)  
IPAP452G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
IPAP454G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
IPAP462G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

5 -

..//

IPAP464G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IPAP472G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)

IPAP474G poste angulado 15° gingihue certain 4,1mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)

IPAP552G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)

IPAP554G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IPAP562G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

IPAP564G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IPAP572G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d)x 7,5mm(p)x2mm(a)

IPAP574G poste angulado 15° gingihue certain 5mm(d)x 7,5mm(p)x4mm(a)

IPAP662G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 6mm(p)x2mm(a)

IPAP664G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 6mm(p)x4mm(a)

IPAP672G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 7,5mm(p)x2mm(a)

IPAP674G poste angulado 15° gingihue certain 6mm(d)x 7,5mm(p)x4mm(a)

IWPP552G poste gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)

IWPP554G poste gingihue certain 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)

IWPP562G poste gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

IWPP564G poste gingihue certain 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

IWPP572G poste gingihue certain 5mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)

IWPP574G poste gingihue certain 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)

IWPP662G poste gingihue certain 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)

8





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

IWPP664G poste gingihue certain 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
IWPP672G poste gingihue certain 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
IWPP674G poste gingihue certain 6mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
MAP32G poste gingihue 3,4mm(d) x3,8mm(p)x 2mm(a)  
MAP34G poste gingihue 3,4mm(d) x3,8mm(p)x 4mm(a)  
MPAP32G poste gingihue preangulado 15° 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
2mm(a)  
MPAP34G poste gingihue preangulado 15° 3,4mm(d) x 3,8mm(p) x  
4mm(a)  
PA154C pilar preangulado 15° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA156C pilar preangulado 15° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PA254C pilar preangulado 25° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA256C pilar preangulado 25° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PA352 SCREW tornillo pa352  
PA352C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PA354C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PA356C pilar preangulado 35° - 4,1mm (d) x 5mm(p) x 6mm(a)  
PAP452G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PAP454G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PAP462G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP464G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
PAP472G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
PAP474G poste preangulado 15° gingihue 4mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
PAP52G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a)  
PAP54G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 5mm(p) x 4mm(a)  
PAP562G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP564G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)  
PAP572G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
PAP574G poste preangulado 15° gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
PAP662G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a)  
PAP664G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 6mm(p) x 4mm(a)

5.

..//

PAP672G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p) x 2mm(a)  
PAP674G poste preangulado 15° gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p) x 4mm(a)  
PAW00 arandela para pilar preangulado  
PTC345 tapa prep-tite 5mm  
PTC347 tapa prep-tite 7mm  
PTC455 tapa prep-tite 5mm  
PTC457 tapa prep-tite 7mm  
PTC465 tapa prep-tite 5mm  
PTC467 tapa prep-tite 7mm  
PTC475 tapa prep-tite 5mm  
PTC477 tapa prep-tite 7mm  
PTC555 tapa prep-tite 5mm  
PTC557 tapa prep-tite 7mm  
PTC665 tapa prep-tite 5mm  
PTC667 tapa prep-tite 7mm  
WPP552 poste prep-tite 5mm(d) x 5mm(p) x 2mm(a) con tornillo de titanio hexagonal  
WPP552G poste gingihue 5mm(d) x 5mm(p)x 2mm(a)  
WPP554G poste gingihue 5mm(d) x 5mm(p)x 4mm(a)  
WPP562G poste gingihue 5mm(d) x 6mm(p)x 2mm(a)  
WPP564G poste gingihue 5mm(d) x 6mm(p)x 4mm(a)  
WPP572G poste gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p)x 2mm(a)  
WPP574G poste gingihue 5mm(d) x 7,5mm(p)x 4mm(a)  
WPP662 poste prep-tite 6mm(d) x 6mm(p) x 2mm(a) con tornillo de titanio hexagonal  
WPP662G poste gingihue 6mm(d) x 6mm(p)x 2mm(a)  
WPP664G poste gingihue 6mm(d) x 6mm(p)x 4mm(a)  
WPP672G poste gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p)x 2mm(a)  
WPP674G poste gingihue 6mm(d) x 7,5mm(p)x 4mm(a)  
AB200 pilar estándar 4,1mm(d) x 2mm (a)  
AB200S tornillo para pilar estándar de titanio 2mm (a)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.N.M.S.T.*

..//

AB300	pilar estándar 4,1mm(d) x 2mm (a)
AB300S	tornillo para pilar estándar de titanio 3mm (a)
AB400	pilar estándar 4,1mm(d) x 4mm (a)
AB400S	tornillo para pilar estándar de titanio 4mm (a)
AB550	pilar estándar 4,1mm (d) x 5,5mm(a)
AB550S	tornillo para pilar estándar de titanio 5,5mm(a)
AB700	pilar estándar 4,1mm(d) x 7mm(a)
AHP72	poste pilar 4,1mm(d) x 2mm(a)
AHP73	poste pilar 4,1mm(d) x 3mm(a)
AHP74	poste pilar 4,1mm(d) x 4mm(a)
CGC30	cilindro biselado oro para pilar estándar
IAB200	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 2mm (a)
IAB300	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 3mm (a)
IAB400	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 4mm (a)
IAB550	pilar estándar certain 4,1mm(d) x 5,5mm (a)
IAB700	pilar estándar certain 4,1mm (d) x 7mm(a)
SGC30	cilindro oro para pilar estándar
SGC34	cilindro plástico calcinable para pilar estándar
STC30	cilindro para pilar estándar de titanio
TC300	cilindro provisorio (pilar estándar)
TS250	tornillo provisorio para pilar estándar 4,1mm(d)
WAB200	pilar estándar 5mm (d) x 2mm (a)
WAB300	pilar estándar 5mm (d) x 3mm (a)
WAB400	pilar estándar 5mm (d) x 4mm (a)
WAB550	pilar estándar 5mm (d) x 5,5mm(a)

Fabricante: BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L - ESPAÑA

ILPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
ILPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
ILPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
ILPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
ILPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)

..//

ILPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)  
ILPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)  
ILPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)  
ILPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)  
ILPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)  
ILPC341 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)  
ILPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)  
ILPC342 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)  
ILPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)  
ILPC343 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)  
ILPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)  
ILPC344 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)  
ILPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)  
ILPC441 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)  
ILPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)  
ILPC442 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)  
ILPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)  
ILPC443 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)  
ILPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)  
ILPC444 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)  
ILPC444U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)  
ILPC541 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)  
ILPC541U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)  
ILPC542 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPC542U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPC543 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPC543U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPC544 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)  
ILPC544U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

..//

LPAC3217 Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)  
LPAC3330 Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)  
LPAC3417 Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)  
LPAC3530 Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)  
LPAC4217 Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)  
LPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)  
LPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)  
LPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)  
LPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)  
LPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)  
LPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)  
LPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)  
LPC341 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)  
LPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)  
LPC342 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)  
LPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)  
LPC343 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)  
LPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)  
LPC344 Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)  
LPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)  
LPC441 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)  
LPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)  
LPC442 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)  
LPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)  
LPC443 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)  
LPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)  
LPC444 Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)  
LPC444U Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)  
LPC541 Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)  
LPC541U Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)  
LPC542 Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)

..//

LPC542U Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)  
LPC543 Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)  
LPC543U Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)  
LPC544 Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)  
LPC544U Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)  
LPCAMI Instrumento de pulido para pilar de perfil bajo  
LPCCC1 Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCCC2 Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCDE Extensión distal para pilar de perfil bajo  
LPCGC1 Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCGC2 Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCGSH Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo  
LPCHC Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo  
LPCLA Análogo de laboratorio para pilar de perfil bajo  
LPCPIC1 Cofia de impresión Pick-up (hexagonal) para pilar de perfil bajo  
LPCPIC2 Cofia de impresión Pick-up (no hexagonal) para pilar de perfil bajo  
LPCPP Protector de pulido para pilar de perfil bajo  
LPCPTC1 Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCPTC2 Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCQB Pilar de perfil bajo QuickBridge  
LPCQBCAP Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge  
LPCRIC Cofia de impresión para pilar de perfil bajo QuickBridge  
LPCTC1 Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCTC2 Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo  
LPCTIC1 Cofia de impresión de transferencia (hexagonal) para pilar de perfil bajo  
LPCTIC2 Cofia de impresión de transferencia (no hexagonal) para pilar de perfil bajo






*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo
LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
FABRICANTE: BIOMET 3i - ESTADOS UNIDOS	
AB550	Pilar estándar 4,1mm (D) x 5,5mm(A)
AB550S	Tornillo de titanio para pilar estándar 5,5mm(A)
AB700	Pilar estándar 4,1mm(D) x 7mm(A)
AC4217	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4225	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 2mm(A)
AC4417	Pilar cónico angulado 17° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
AC4425	Pilar cónico angulado 25° - 4,1mm(D) x 4mm(A)
ACSCREW	Tornillo p/pilar cónico angulado 17° y 25° - 4,1mm y 5mm(D) x 2mm y 4mm(A)
AHP72	Poste pilar 4,1mm(D) x 2mm(A)
AHP73	Poste pilar 4,1mm(D) x 3mm(A)
AHP74	Poste pilar 4,1mm(D) x 4mm(A)
APP42	Poste Prep-Tite 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A) c/tornillo hexagonal de titanio
APP452G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
APP454G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)
APP462G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 2mm (A)
APP464G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)
APP472G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
APP474G	Poste GingiHue 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
CA001	Pilar cónico 4,1mm (D)x 1mm (A)
CA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 1mm (A)
CA002	Pilar cónico 4,1mm (D)x 2mm (A)
CA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 2mm (A)
CA003	Pilar cónico 4,1mm (D)x 3mm (A)
CA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 3mm (A)
CA004	Pilar cónico 4,1mm (D)x 4mm (A)

..//

CA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 4mm (A)
CA055	Pilar cónico 4,1mm (D)x 5,5mm (A)
CA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1mm y 5mm (D) x 5,5mm (A)
CACC5	Cilindro cónico calcinable no hexagonal 4,1 x 5mm
CAGC5	Cilindro oro cónico no hexagonal 4,1mm y 5mm (D)
CAGC6	Cilindro oro cónico no hexagonal 6mm (D)
CATC5	Cilindro cónico de titanio no-hexagonal 4,1mm y 5,0mm (D)
CC300	Cilindro prov. cónico no hexagonal.
CGC30	Cilindro biselado oro para pilar estándar
CSCM05	Barra para 5 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM06	Barra para 6 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM07	Barra para 7 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM08	Barra para 8 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM09	Barra para 9 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSCM10	Barra para 10 Implantes Cam Structsure duplicado por fresado
CSD02	Barra Camstructsure Dolder
CSD03	Barra Camstructsure Dolder
CSD04	Barra Camstructsure Dolder
CSD05	Barra Camstructsure Dolder
CSD06	Barra Camstructsure Dolder
CSD07	Barra Camstructsure Dolder
CSD08	Barra Camstructsure Dolder
CSD09	Barra Camstructsure Dolder
CSD10	Barra Camstructsure Dolder
CSH02	Barra Camstructsure Hadar
CSH03	Barra Camstructsure Hadar
CSH04	Barra Camstructsure Hadar
CSH05	Barra Camstructsure Hadar
CSH06	Barra Camstructsure Hadar
CSH07	Barra Camstructsure Hadar
CSH08	Barra Camstructsure Hadar







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

CSH09	Barra Camstructure Hadar
CSH10	Barra Camstructure Hadar
CSHY04	Barra híbrida Camstructure
CSHY05	Barra híbrida Camstructure
CSHY06	Barra híbrida Camstructure
CSHY07	Barra híbrida Camstructure
CSHY08	Barra híbrida Camstructure
CSHY09	Barra híbrida Camstructure
CSHY10	Barra híbrida Camstructure
CSP02	Barra primaria Camstructure
CSP03	Barra primaria Camstructure
CSP04	Barra primaria Camstructure
CSP05	Barra primaria Camstructure
CSP06	Barra primaria Camstructure
CSP07	Barra primaria Camstructure
CSP08	Barra primaria Camstructure
CSP09	Barra primaria Camstructure
CSP10	Barra primaria Camstructure
DRAF	Conector hembra roscado Dal-Ro
DRCS1	Sistema calcinable Dal-Ro
DRFM1	Conector hembra de metal Dal-Ro
DRH20	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 2mm (A)
DRH40	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 4mm (A)
DRH60	Pilar Dal-Ro de 4,1mm (D) x 6mm (A)
DRTH	Conjunto Dal-Ro de capuchón y conector hembra
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
EHA343	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3,0mm (A)

..//

EHA344 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)

EHA346 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)

EHA348 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)

EHA353 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)

EHA354 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

EHA356 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

EHA358 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)

EHA443 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)

EHA444 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)

EHA446 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)

EHA448 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)

EHA453 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)

EHA454 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

EHA456 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

EHA458 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

EHA463 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)

EHA464 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

EHA466 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

EHA468 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

EHA473 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

EHA474 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

EHA476 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

EHA478 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

EHA553 Pilar de cicatrización Ep de -piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 3mm (A)

EHA554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 4mm (A)

EHA556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 6mm (A)

EHA558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)

EHA563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)

EHA564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

EHA566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

5

..//

EHA568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

EHA573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

EHA574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

EHA576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

EHA578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

EHA663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)

EHA664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)

EHA666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)

EHA668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)

EHA673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

EHA674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

EHA676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

EHA678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

GS200 Tornillo oro c/ranura 2mm

GS300 Tornillo oro c/ranura 3mm

GSH20 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 2mm

GSH30 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 3mm

GSH70 Tornillo de retención hexagonal Gold-Tite 7mm





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

GUCA1C	Pilar oro-hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA2C	Pilar oro no hexagonal UCLA con tornillo hexagonal 4,1mm (D)
GUCA3	Pilar Minimplant UCLA oro con tornillo hexagonal (hexagonal interno)
GUCA3S	Tornillo para pilar Minimplant UCLA oro (hexagonal interno)
IAB200	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 2mm (A)
IAB300	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 3mm (A)
IAB400	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 4mm (A)
IAB550	Pilar estándar Certain 4,1mm(D) x 5,5mm (A)
IAB700	Pilar estándar Certain 4,1mm (D) x 7mm(A)
IAC4217	Pilar Certain cónico angulado 17°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4225	Pilar Certain cónico angulado 25°- 4,1mm(D) x 2mm(A)
IAC4417	Pilar Certain cónico angulado 17°-4,1mm(D) x 4mm(A)
IAC4425	Pilar Certain cónico angulado 25°-4,1mm(D) x 4mm(A)
IAPP452G	Poste GingiHue Certain 4,1mm (D) x 5mm (P) x 2mm (A)
IAPP454G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 5mm (P) x 4mm (A)
IAPP462G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 2mm (A)
IAPP464G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 6mm (P) x 4mm (A)
IAPP472G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
IAPP474G	Poste GingiHue Certain 4,1mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)
ICA001	Pilar cónico 4,1mm (D) x 1mm (A) Certain
ICA001S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 1mm (A)Certain
ICA002	Pilar cónico 4,1mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA002S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 2mm (A)Certain
ICA003	Pilar cónico 4,1mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA003S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 3mm (A)Certain
ICA004	Pilar cónico 4,1mm (D) x 4mm (A) Certain
ICA004S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 4mm (A)Certain
ICA055	Pilar cónico 4,1mm (D) x 5,5mm (A)Certain
ICA055S	Tornillo para pilar cónico 4,1 y 5mm (D) x 5,5mm (A)Certain



..//

ICAP454 Poste ZiReal 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal

ICAP464 Poste ZiReal 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A) Certain c/tornillos hexagonales ZiReal

ICZGS Tornillo Gold-Tite de circonio Encode

ICZTIS Tornillo de prueba de circonio Encode

IEHA343 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 3mm (A)

IEHA344 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)

IEHA346 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)

IEHA348 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 8mm (A)

U7 IEHA353 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 3mm (A)

IEHA354 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

IEHA356 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

IEHA358 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 3,4mm (D) x 5mm (P) x 8mm (A)

IEHA443 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 3mm (A)

IEHA444 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 4mm (A)

IEHA446 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 6mm (A)

IEHA448 Pilar de cicatrización de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm (D) x 4,1mm (P) x 8mm (A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

IEHA453 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 5mm (P) x 3mm (A)

IEHA454 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 5mm (P) x 4mm (A)

IEHA456 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 5mm (P) x 6mm (A)

IEHA458 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 5mm (P) x 8mm (A)

IEHA463 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 6mm (P) x 3mm (A)

IEHA464 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 6mm (P) x 4mm (A)

IEHA466 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 6mm (P) x 6mm (A)

U  
-

IEHA468 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 6mm (P) x 8mm (A)

IEHA473 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA474 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

IEHA476 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

IEHA478 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 4,1mm  
(D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA553 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x  
5,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x  
5,5mm (P) x 4mm (A)

IEHA556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x  
5,5mm (P) x 6mm (A)

..//

IEHA558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 5,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 3mm (A)

IEHA564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

IEHA566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

IEHA568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)

IEHA573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

IEHA576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

IEHA578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)

IEHA663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 3mm (A)

IEHA664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 4mm (A)

IEHA666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 6mm (A)

IEHA668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 6,6mm (P) x 8mm (A)

IEHA673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)

IEHA674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

- IEHA676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)
- IEHA678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas Certain Encode de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm (A)
- IGUCA1C Cilindro de pilar hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D)
- IGUCA2C Cilindro de pilar no hexagonal oro Certain UCLA 4,1mm (D) con tornillo diámetro ancho
- IGUCA2T Pilar oro-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm con tornillo ancho de titanio
- IIOL20S Pilar IOL Certain 2mm
- IIOL30S Pilar IOL Certain 3mm
- IIOL40S Pilar IOL Certain 4mm
- IIOL55S Pilar IOL Certain 5,5mm
- IIOL70S Pilar IOL Certain 7mm
- IITCS41 Cilindro provisorio hexagonal Certain 4,1mm (D)
- IITCS42 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 4,1mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- ILOA001 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)
- ILOA002 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILOA003 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILOA004 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILOA005 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)
- ILOA006 Pilar Locator Certain 4,1mm (D) x 6mm (A)
- ILPAC3217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC3330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC3417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC3530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 5mm (A)
- ILPAC4217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)
- ILPAC4330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)
- ILPAC4417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)
- ILPAC4530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 5mm (A)

..//

ILPAC5217 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPAC5330 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPAC5417 Pilar 17° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)  
ILPAC5530 Pilar 30° de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 5mm (A)  
ILPC341 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)  
ILPC341U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 1mm (A)  
ILPC342 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)  
ILPC342U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 2mm (A)  
ILPC343 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)  
ILPC343U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 3mm (A)  
ILPC344 Pilar de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)  
ILPC344U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 3,4mm (D) x 4mm (A)  
ILPC441 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)  
ILPC441U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 1mm (A)  
ILPC442 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)  
ILPC442U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 2mm (A)  
ILPC443 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)  
ILPC443U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 3mm (A)  
ILPC444 Pilar de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)  
ILPC444U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 4,1mm (D) x 4mm (A)  
ILPC541 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)  
ILPC541U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 1mm (A)  
ILPC542 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPC542U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 2mm (A)  
ILPC543 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPC543U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 3mm (A)  
ILPC544 Pilar de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)  
ILPC544U Pilar de una pieza de perfil bajo Certain 5,0mm (D) x 4mm (A)  
ILRGHG Tornillo Gold -Tite Certain hexagonal de diámetro ancho  
ILRGHT Tornillo de titanio Certain hexagonal de diámetro ancho





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

IMAP32G MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 2mm(A)

IMAP34G MicroMinimplant GingiHue Certain 3,4mm(D)x 3,8mm(P) x 4mm(A)

IMCA31 Pilar cónico 3,4mm (D) x 1mm (A) Certain

IMCA32 Pilar cónico 3,4mm (D)x 2mm (A) Certain

IMCA33 Pilar cónico 3,4mm (D)x 3mm (A) Certain

IMCA34 Pilar cónico 3,4mm (D)x 4mm (A) Certain

IMHA32 Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 2mm (A)

IMHA33 Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 3mm (A)

IMHA34 Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 4mm (A)

IMHA36 Pilar de cicatrización Ep Certain 3,4mm (D) x 3,8mm (P) 6mm (A)

IMLOA001 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 1mm (A)

IMLOA002 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 2mm (A)

IMLOA003 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 3mm (A)

IMLOA004 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 4mm (A)

IMLOA005 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 5mm (A)

IMLOA006 Pilar Locator Certain de 3,4mm (D) x 6mm (A)

IMMTCS1 Cilindro provisorio hexagonal Certain 3,4mm (D) con tornillo hexagonal


IMPAP32G Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)

IMPAP34G Poste GingiHue Certain angulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)

IMPAPF34 Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)

..//

IMPAPF36 Poste preangulado 15° Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)  
IMPFP34 Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)  
IMPFP36 Poste Certain PreFormance 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)  
IMPFTC32 Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (no hexagonal)  
IMPFTC34 Cilindro provisorio Certain PreFormance 3,4mm (hexagonal)  
IMUCC2C Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCC2T Pilar UCLA calcinable no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCG1C Pilar hexagonal oro UCLA Certain 3,4mm(D)  
IMUCG2C Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IMUCG2T Pilar UCLA oro no hexagonal Certain 3,4mm(D)  
IOL20T Pilar con tornillo 2mm IOL 2 piezas  
IOL30T Pilar con tornillo 3mm IOL 2 piezas  
IOL40T Pilar con tornillo 4mm IOL 2 piezas  
IOL55T Pilar con tornillo 5,5mm IOL 2 piezas  
IOL70T Pilar con tornillo 7mm IOL 2 piezas  
IOLDE Extensión distal IOL  
IOLGC Cilindro oro IOL  
IOLHC Capuchón de cicatrización IOL  
IOLTC Cilindro provisorio IOL  
IPA4140 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 4,0mm  
IPA4155 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 1mm(A) – Poste 5,5mm  
IPA4240 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 4,0mm  
IPA4255 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 2mm(A) – Poste 5,5mm  
IPA4340 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) – Poste 4,0mm





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

IPA4355 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 3mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA4440 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA4455 Pilar Certain Provide 4,1mm(D) x 4,8mm(P) x 4mm(A) - Post  
5,5mm

IPA5140 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA5155 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA5240 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA5255 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA5340 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA5355 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA5440 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA5455 Pilar Certain Provide 5,0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA6140 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA6155 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 1mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA6240 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA6255 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 2mm(A) - Poste  
5,5mm

5

..//

IPA6340 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA6355 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 3mm(A) - Poste  
5,5mm

IPA6440 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste  
4,0mm

IPA6455 Pilar Certain Provide 6.0mm(D) x 6,5mm(P) x 4mm(A) - Poste  
5,5mm

IPAP452G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x  
2mm(A)

IPAP454G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 5mm(P) x  
4mm(A)

IPAP462G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x  
2mm(A)

IPAP464G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 6mm(P) x  
4mm(A)

IPAP472G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x  
2mm(A)

IPAP474G Poste GingiHue Certain angulado 15° 4mm(D) x 7,5mm(P) x  
4mm(A)

IPAP552G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x  
2mm(A)

IPAP554G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x  
4mm(A)

IPAP562G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x  
2mm(A)

IPAP564G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x  
4mm(A)

IPAP572G Poste GingiHue Certain angulado 15° 5mm(D)x  
7,5mm(P)x2mm(A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.I.*

..//

IPAP574G	Poste	GingiHue	Certain	angulado	15°	5mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAP662G	Poste	GingiHue	Certain	angulado	15°	6mm(D)x 6mm(P)x2mm(A)
IPAP664G	Poste	GingiHue	Certain	angulado	15°	6mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
IPAP672G	Poste	GingiHue	Certain	angulado	15°	6mm(D)x 7,5mm(P)x2mm(A)
IPAP674G	Poste	GingiHue	Certain	angulado	15°	6mm(D)x 7,5mm(P)x4mm(A)
IPAPF454	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF456	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF464	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF466	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF474	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF476	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF554	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
IPAPF556	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
IPAPF564	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
IPAPF566	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
IPAPF574	Poste	preangulado	15°	Certain	PreFormance	5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

..//

IPAPF576 Poste preangulado15° Certain PreFormance 5mm(D) x  
7,5mm(P) x 6mm(A)

IPAPF664 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P)  
x 4mm(A)

IPAPF666 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P)  
x 6mm(A)

IPAPF674 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x  
7,5mm(P) x 4mm(A)

IPAPF676 Poste preangulado15° Certain PreFormance 6mm(D) x  
7,5mm(P) x 6mm(A)

IPFP454 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)

IPFP456 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)

IPFP464 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IPFP466 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IPFP474 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IPFP476 Poste Certain PreFormance 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IPFTC41 Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (hexagonal)

IPFTC42 Cilindro provisorio Certain PreFormance 4,1mm (no hexagonal)

ISHA42 Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x  
2mm(A)

ISHA43 Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x  
3mm(A)

ISHA44 Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x  
4mm(A)

ISHA46 Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x  
6mm(A)

ISHA48 Pilar de cicatrización recto Certain 4,1mm(D) x 0mm (P) x  
8mm(A)

ISMHA32 Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x  
2mm(A)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

ISMHA33	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P)x 3mm(A)
ISMHA34	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 4mm(A)
ISMHA36	Pilar de cicatrización recto Certain 3,4mm(D) x 3,4mm (P) x 6mm(A)
ISWHA52	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA53	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA54	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA56	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA58	Pilar de cicatrización recto Certain 5mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ISWHA62	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 2mm(A)
ISWHA63	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 3mm(A)
ISWHA64	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 4mm(A)
ISWHA66	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 6mm(A)
ISWHA68	Pilar de cicatrización recto Certain 6mm(D) x 0mm(P) x 8mm(A)
ITCH0	Cilindro provisorio para implante hexagonal c/ tornillo hexagonal 4,1mm
ITCH1	Cilindro provisorio para implante no hexagonal. c/ tornillo hexagonal 4,1mm(D)
ITCS41	Cilindro provisorio hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITCS42	Cilindro provisorio no hexagonal 4,1mm (D) con retención
ITHA52	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 2mm(A)
ITHA53	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 3mm(A)
ITHA54	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 4mm(A)
ITHA56	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 6mm(A)
ITHA58	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 5mm (P)x 8mm(A)
ITHA63	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 3mm(A)
ITHA64	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 4mm(A)
ITHA66	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 6mm(A)
ITHA68	Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 6mm (P)x 8mm(A)

..//

ITHA73 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x  
3mm(A)

ITHA74 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x  
4mm(A)

ITHA76 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x  
6mm(A)

ITHA78 Pilar de cicatrización Certain Ep 4,1mm (D) x 7,5mm (P)x  
8mm(A)

ITUCA2C Pilar de titanio-no hexagonal UCLA Certain 4,1mm (D) con  
tornillo de diámetro ancho

IUNAB2C Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D)  
c/tornillo de diámetro ancho Gold-Tite

IUNAB2T Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 4,1mm (D)  
c/tornillo de titanio de diámetro ancho

IUNIHG Tornillo hexagonal Gold-Tite Certain

IUNIHT Tornillo hexagonal Certain de titanio

IWCA51 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 1mm (A)

IWCA52 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 2mm (A)

IWCA53 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 3mm (A)

IWCA54 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 4mm (A)

IWCA55 Pilar cónico Certain 5mm (D) x 5mm (A)

IWCA61 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 1mm (A)

IWCA62 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 2mm (A)

IWCA63 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 3mm (A)

IWCA64 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 4mm (A)

IWCA65 Pilar cónico Certain 6mm (D) x 5,5mm (A)

IWCAP564 Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A) con tornillos  
hexagonales ZiReal

IWCAP574 Poste ZiReal Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A) con tornillos  
hexagonales ZiReal

IWGA51C Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

IWGA52C Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho

IWGA52T Pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio

IWGA61C Cilindro pilar hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D)

IWGA62C Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho

IWGA62T Cilindro pilar no hexagonal oro UCLA para Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho de titanio

IWPC52C Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho

IWPC52T Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 5mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio

IWPC62C Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo Gold-Tite de diámetro ancho

IWPC62T Pilar UCLA calcinable (no hexagonal) Certain 6mm (D) c/tornillo de diámetro ancho de titanio

U

IWFPF554 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)

IWFPF556 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)

IWFPF564 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IWFPF566 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IWFPF574 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IWFPF576 Poste Certain PreFormance 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IWFPF664 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)

IWFPF666 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)

IWFPF674 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)

IWFPF676 Poste Certain PreFormance 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)

IWPFTC51 Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (hexagonal)

IWPFTC52 Cilindro provisorio Certain PreFormance 5mm (no hexagonal)

IWPFTC61 Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (hexagonal)

IWPFTC62 Cilindro provisorio Certain PreFormance 6mm (no hexagonal)

..//

- IWPP552G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP554G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP562G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- IWPP564G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP572G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP574G Poste GingiHue Certain 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWPP662G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- IWPP664G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- IWPP672G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
- IWPP674G Poste GingiHue Certain 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- IWTCS51 Cilindro provisorio hexagonal Certain 5mm (D)
- IWTCS52 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 5mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- IWTCS61 Cilindro provisorio hexagonal Certain 6mm (D)
- IWTCS62 Cilindro provisorio no hexagonal Certain 6mm (D) con tornillo de diámetro ancho
- IWTH52 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x2mm(A)
- IWTH53 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x3mm(A)
- IWTH54 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x4mm(A)
- IWTH56 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 5,6mm (P)x6mm(A)
- IWTH562 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x2mm(A)
- IWTH563 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x3mm(A)
- IWTH564 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm(D)x 6mm (P)x4mm(A)
- IWTH566 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)
- IWTH568 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 6mm (P) x 8mm (A)
- IWTH572 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm (A)
- IWTH573 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm (A)
- IWTH574 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

- IWTH576 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm  
(A)
- IWTH578 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm  
(A)
- IWTH58 Pilar de cicatrización Certain Ep 5mm (D) x 5,6mm (P) x 8mm  
(A)
- IWTH62 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 2mm  
(A)
- IWTH63 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 3mm  
(A)
- IWTH64 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 4mm  
(A)
- IWTH66 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 6mm  
(A)
- IWTH672 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 2mm  
(A)
- 01 - IWTH673 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 3mm  
(A)
- IWTH674 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm  
(A)
- IWTH676 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm  
(A)
- IWTH678 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 7,5mm (P) x 8mm  
(A)
- IWTH68 Pilar de cicatrización Certain Ep 6mm (D) x 6,8mm (P) x 8mm  
(A)
- IZSHG Tornillo para pilar hexagonal Gold-Tite para poste Certain ZiReal
- LAELM Machos de retención extra ligeros Locator - Pack x 4
- LAERM Machos de rango extendido Locator - Pack x 4
- LARMS Machos de repuesto Locator - Pack x 4
- LELARM Machos de repuesto angulados extra ligeros Locator - Pack x4.

..//

LGS30	Tornillo de retención con ranura oro largo
LLRMS	Machos de retención ligera Locator - Pack x 4
LOA001	Pilar Locator 1mm
LOA002	Pilar Locator 2mm
LOA003	Pilar Locator 3mm
LOA004	Pilar Locator 4mm
LOA005	Pilar Locator 5mm
LOA006	Pilar Locator 6mm
LOAB	Accesorio Locator
LOAH	Cazoleta de repuesto Locator
LORHK	Kit de cazoletas de repuesto Locator
LPAC3217	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPAC3330	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPAC3417	Pilar 17° de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPAC3530	Pilar 30° de perfil bajo 3,4mm (D) x 5mm (A)
LPAC4217	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPAC4330	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPAC4417	Pilar 17° de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPAC4530	Pilar 30° de perfil bajo 4,1mm (D) x 5mm (A)
LPAC5217	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPAC5330	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPAC5417	Pilar 17° de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPAC5530	Pilar 30° de perfil bajo 5,0mm (D) x 5mm (A)
LPC341	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC341U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 1mm (A)
LPC342	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC342U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 2mm (A)
LPC343	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC343U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 3mm (A)
LPC344	Pilar de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)
LPC344U	Pilar de una pieza de perfil bajo 3,4mm (D) x 4mm (A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

LPC441	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC441U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 1mm (A)
LPC442	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC442U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 2mm (A)
LPC443	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC443U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 3mm (A)
LPC444	Pilar de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC444U	Pilar de una pieza de perfil bajo 4,1mm (D) x 4mm (A)
LPC541	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC541U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 1mm (A)
LPC542	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC542U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 2mm (A)
LPC543	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC543U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 3mm (A)
LPC544	Pilar de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPC544U	Pilar de una pieza de perfil bajo 5,0mm (D) x 4mm (A)
LPCCC1	Cilindro calcinable hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCCC2	Cilindro calcinable no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC1	Cilindro oro hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGC2	Cilindro oro no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCGSH	Tornillo de retención GoldTite para pilar de perfil bajo
LPCHC	Tapa de cicatrización para pilar de perfil bajo
LPCPTC1	Cilindro provisorio PreFormance hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCPTC2	Cilindro provisorio PreFormance no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCQB	Pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCQBCAP	Tapa de repuesto para pilar de perfil bajo QuickBridge
LPCTC1	Cilindro provisorio hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTC2	Cilindro provisorio no hexagonal para pilar de perfil bajo
LPCTSH	Tornillo de retención de titanio para pilar de perfil bajo

5.

..//

LPCTUCA	Cilindro soldado con láser para pilar de perfil bajo
LPCWS	Tornillo de encerado para pilar de perfil bajo
MAP32G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 2mm(A)
MAP34G	Poste GingiHue 3,4mm(D) x3,8mm(P)x 4mm(A)
MCA31	Pilar cónico 3,4mm(D) x 1mm(A)
MCA32	Pilar cónico 3,4mm(D) x 2mm(A)
MCA33	Pilar cónico 3,4mm(D) x 3mm(A)
MCA34	Pilar cónico 3,4mm(D) x 4mm(A)
MCAG1	Cilindro oro cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCAG2	Cilindro oro cónico no hexagonal 3,4mm (D)
MCTC1	Cilindro provisorio para pilar cónico hexagonal 3,4mm (D)
MCTC2	Cilindro provisorio cónico no hexagonal MicroMiniplant™
MHA32	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MHA33	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MHA34	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MHA36	Pilar de cicatrización Ep 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MHC33	Capuchón cónico de cicatrización 3,4mm(D)
MITC2	Cilindro cono corto de titanio no hexagonal
MLOA001	Pilar Locator 3,4mm (D) x 1mm (A)
MLOA002	Pilar Locator 3,4mm (D) x 2mm (A)
MLOA003	Pilar Locator 3,4mm (D) x 3mm (A)
MLOA004	Pilar Locator 3,4mm (D) x 4mm (A)
MLOA005	Pilar Locator 3,4mm (D) x 5mm (A)
MLOA006	Pilar Locator 3,4mm (D) x 6mm (A)
MMTc1	Cilindro hexagonal provisorio MicroMini c/torn hexagonal
MMTCS1	Cilindro provisorio hexagonal con retención 3,4mm (D)
MPAP32G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 2mm(A)
MPAP34G	Poste GingiHue preangulado 15° 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

MPAPF34	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 4mm(A)
MPAPF36	Poste PreFormance preangulado 15° 3,4mm (D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MPFP34	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 4mm (A)
MPFP36	Poste PreFormance de 3,4mm (D) x 3,8mm (P) x 6mm (A)
MPFTC32	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (no hexagonal)
MPFTC34	Cilindro provisorio PreFormance de 3,4mm (hexagonal)
MT233	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 3mm(A)
MT236	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 3,8mm(P) x 6mm(A)
MT253	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
MT254	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
MT256	Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 3,4mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
MUCC1C	Pilar calcinable hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCC2C	Pilar calcinable no hexagonal UCLA 3,4mm(D)
MUCG1C	Pilar hexagonal oro UCLA 3,4mm (D)
MUCG2C	Pilar UCLA oro no hexagonal 3,4mm(D)
OSO20	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO20S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 2mm(A)
OSO40	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO40S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 4mm(A)
OSO60	Pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSO60S	Tornillo para pilar O-Ring 4,1mm(D) x 6mm(A)
OSOBLK	Repuesto O-Ring negro
OSOCA	Sistema calcinable O-Ring
OSODH	Capuchón O-Ring

5.

..//

OSORED O-Ring de procesamiento

PA154C Pilar preangulado 15° - 4mm(A)

PA156C Pilar preangulado 15° - 6mm(A)

PA254C Pilar preangulado 25° - 4mm(A)

PA256C Pilar preangulado 25° - 6mm(A)

PA352 SCREW Tornillo PA352

PA352C Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 2mm(A)

PA354C Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 4mm(A)

PA356C Pilar preangulado 35° - 4,1mm (D) x 5mm(P) x 6mm(A)

PAK4140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm

PAK4155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm

PAK4240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm

PAK4255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm

PAK4340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm

PAK4355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm

PAK4440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm

PAK4455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 4,1mm (D) x 4,8mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm

PAK5140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm

PAK5155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm

PAK5240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm






*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

- PAK5255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
- PAK5340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
- PAK5355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
- PAK5440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
- PAK5455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 5mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6140 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 4mm
- PAK6155 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 1mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6240 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 4mm
- PAK6255 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 2mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6340 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 4mm
- PAK6355 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 3mm (A), poste de 5,5mm
- PAK6440 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 4mm
- PAK6455 Kit de colocación de pilar Certain Provide de 6mm (D) x 6,5mm (P) x 4mm (A), poste de 5,5mm
- PAP452G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 2mm
- PAP454G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 5mm x 4mm
- PAP462G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 2mm
- PAP464G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 6mm x 4mm
- PAP472G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 2mm

..//

PAP474G Poste pretallado GingiHue angulado 4mm x 7,5mm x 4mm  
PAP552G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 2mm  
PAP554G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 5mm x 4mm  
PAP562G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 2mm  
PAP564G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 6mm x 4mm  
PAP572G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 2mm  
PAP574G Poste pretallado GingiHue angulado 5mm x 7,5mm x 4mm  
PAP662G Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 2mm  
PAP664G Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 6mm x 4mm  
PAP672G Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 2mm  
PAP674G Poste pretallado GingiHue angulado 6mm x 7,5mm x 4mm  
PAPF454 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x  
4mm (A)  
PAPF456 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 5mm(P) x  
6mm (A)  
PAPF464 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x  
4mm (A)  
PAPF466 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 6mm(P) x  
6mm (A)  
PAPF474 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x  
4mm (A)  
PAPF476 Poste PreFormance preangulado 15° 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x  
6mm (A)  
PAPF554 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 4mm  
(A)  
PAPF556 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 5mm(P) x 6mm  
(A)  
PAPF564 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm  
(A)  
PAPF566 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm  
(A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.J.*

..//

PAPF574 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)  
PAPF576 Poste PreFormance preangulado 15° 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)  
PAPF664 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 4mm (A)  
PAPF666 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 6mm(P) x 6mm (A)  
PAPF674 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm (A)  
PAPF676 Poste PreFormance preangulado 15° 6mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm (A)  
PAW00 Arandela para pilar preangulado  
PFP454 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)  
PFP456 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)  
PFP464 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)  
PFP466 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)  
PFP474 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)  
PFP476 Poste PreFormance de 4,1mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)  
PFTC41 Cilindro provisorio PreFormance (hexagonal) de 4,1mm  
PFTC42 Cilindro provisorio PreFormance (no hexagonal) de 4,1mm  
PPC484 Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 4,0mm  
PPC485 Capuchón protector Provide 4,8mm (P) - Poste de 5,5mm  
PPC654 Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 4,0mm  
PPC655 Capuchón protector Provide 6,5mm (P) - Poste de 5,5mm  
PTC345 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con MAP32G, MAP34G  
PTC347 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con MAP32G, MAP34G  
PTC455 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP452G, APP454G  
PTC457 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP452G, APP454G  
PTC465 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G,  
WPP564G

..//

PTC467 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP462G, APP464G, WPP562G, WPP564G

PTC475 Tapa Prep-Tite 5mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G

PTC477 Tapa Prep-Tite 7mm: usar con APP472G, APP474G, WPP572G, WPP574G, WPP672G, WPP674G

PTC555 Tapa Prep-Tite 5mm: WPP552G, WPP554G

PTC557 Tapa Prep-Tite 7mm: WPP552G, WPP554G

PTC665 Tapa Prep-Tite 5mm: WPP662G, WPP664G

PTC667 Tapa Prep-Tite 7mm: WPP662G, WPP664G

PUA48M Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) - Unidad múltiple

PUA48S Cilindro provisorio Provide TM 4,8mm(P) - Unidad simple

PUA65M Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad múltiple

PUA65S Cilindro provisorio Provide TM 6,5mm(P) - Unidad simple

QBCAP Tapa Quick Bridge

QKBRG Cilindro y tapa Quick Bridge

SCA001 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 1mm (A)

SCA002 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 2mm (A)

SCA003 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 3mm (A)

SCA004 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 4mm (A)

SCA055 Pilar cónico oro estándar ZR 4,1mm (D) x 5,5mm (A)

SGC30 Cilindro oro para pilar estándar

SGC34 Cilindro plástico calcinable para pilar estándar

SGUCA1C Cilindro pilar hexagonal ZR UCLA oro estándar 4,1mm (D)

STC30 Cilindro pilar estándar de titanio

STGC5 Cilindro oro Sta 4,1mm y 5,0mm (D)

STGC6 Cilindro oro Sta 6mm (D)

SWCA51 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x1mm (A)

SWCA52 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x2mm (A)

SWCA53 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x3mm (A)

SWCA54 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x4mm (A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

..//

- SWCA55 Pilar cónico oro estándar ZR 5mm (D)x5,5mm (A)
- SWCA61 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x1mm (A)
- SWCA62 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x2mm (A)
- SWCA63 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x3mm (A)
- SWCA64 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x4mm (A)
- SWCA65 Pilar cónico oro estándar ZR 6mm (D)x5mm (A)
- SWGA51C Cilindro pilar hexagonal ZR estándar oro UCLA 5mm(D)
- SWGA61C Cilindro pilar hexagonal ZR oro UCLA 6mm(D)
- TC300 Cilindro provisorio (pilar estándar)
- TH253 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x3mm(A)
- TH253S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x3mm(A)
- TH254 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x4mm(A)
- TH254S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x4mm(A)
- TH256 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x6mm(A)
- TH256S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x6mm(A)
- TH258 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 5mm(P)x8mm(A)
- TH258S Tornillo para pilar de cicatrización de 2 piezas Ep® 4,1mm (D) x 5mm(P)x8mm(A)
- TH263 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x3mm(A)
- TH264 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x4mm(A)
- TH266 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x6mm(A)
- TH268 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 6mm(P)x8mm(A)
- TH273 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x3mm (A)
- TH274 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x4mm (A)
- TH276 Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x6mm (A)

..//

TH278	Pilar de cicatrización de 2 piezas Ep 4,1mm(D)x 7,5mm(P)x8mm
(A)	
THA42	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 2mm(A)
THA43	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 3mm(A)
THA44	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 4mm(A)
THA46	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 6mm(A)
THA48	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 4,1mm(P) x 8mm(A)
THA52	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A)
THA53	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 3mm(A)
THA54	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 4mm(A)
THA56	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 6mm(A)
THA58	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 5mm(P) x 8mm(A)
THA63	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
THA64	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
THA66	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
THA68	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
THA73	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
THA74	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
THA76	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
THA78	Pilar de cicatrización Ep 4,1mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
THRC4	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 4mm
(A)	
THRC6	Cilindro de retención de cicatrización provisorio 4,1mm(D) x 6mm
(A)	
TRC30	Cilindro de retención provisorio
TS250	Tornillo provisorio (pilar estándar) 4,1mm(D)
TSH30	Tornillo de titanio hexagonal de 3mm
TUCA2C	Cilindro pilar UCLA de titanio no hexagonal 4,1mm(D)
UNA125	Pack cilindro UCLA calcinable hexagonal x 25
UNA225	Pack cilindro UCLA calcinable no hexagonal x 25
UNAB1C	Cilindro UCLA calcinable (hexagonal)







*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

UNAB2C	Cilindro UCLA calcinable (no hexagonal)
UNIHG	Tornillo Uniscrew hexagonal Gold-Tite
UNIHT	Tornillo Uniscrew hexagonal de titanio
UNISG	Tornillo Uniscrew cuadrado Gold-Tite
UNIST	Tornillo Uniscrew cuadrado de titanio
WAB200	Pilar estándar 5mm (D) x 2mm (A)
WAB300	Pilar estándar 5mm (D) x 3mm (A)
WAB400	Pilar estándar 5mm (D) x 4mm (A)
WAB550	Pilar estándar 5mm (D) x 5,5mm(A)
WCA51	Pilar cónico 5mm (D) x1mm(A)
WCA52	Pilar cónico 5mm (D) x2mm(A)
WCA53	Pilar cónico 5mm (D) x3mm(A)
WCA54	Pilar cónico 5mm (D) x4mm(A)
WCA55	Pilar cónico 5mm (D) x5,5mm(A)
WCA62	Pilar cónico 6mm (D) x2mm (A)
WCA63	Pilar cónico 6mm(D)x 3mm(A)
WCA65	Pilar cónico 6mm(D)x 5,5mm(A)
WCS66	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 6mm (P)
WCS67	Tapa de cicatrización Ep cónica de 6mm (D) x 7,5mm (P)
WCTC60	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) hexagonal
WCTC61	Cilindro provisorio cónico Ep 6mm(D)x6mm(P) no hexagonal
WGA51C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 5mm (D)
WGA52C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 5mm (D)
WGA61C	Pilar UCLA oro hexagonal unidad simple 6mm (D)
WGA62C	Pilar UCLA oro no hexagonal unidad múltiple 6mm (D)
WOSO20	Pilar O-Ring 5mm (D)x 2mm(A)
WOSO40	Pilar O-Ring 5mm (D)x 4mm(A)
WOSO60	Pilar O-Ring 5mm (D)x 6mm(A)
WPC51C	Pilar UCLA calcinable hexagonal 5mm(D)
WPC52C	Pilar UCLA calcinable no hexagonal 5mm(D)
WPC61C	Pilar UCLA calcinable hexagonal con tornillo hexagonal 6mm(D)

..//

WPC62C Pilar UCLA calcinable no hexagonal 6mm(D)

WPP554 Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 4mm (A)

WPP556 Poste PreFormance de 5mm (D) x 5mm (P) x 6mm (A)

WPP564 Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

WPP566 Poste PreFormance de 5mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

WPP574 Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

WPP576 Poste PreFormance de 5mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

WPP664 Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 4mm (A)

WPP666 Poste PreFormance de 6mm (D) x 6mm (P) x 6mm (A)

WPP674 Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 4mm (A)

WPP676 Poste PreFormance de 6mm (D) x 7,5mm (P) x 6mm (A)

WPFTC51 Cilindro provisorio PreFormance 5mm (hexagonal)

WPFTC52 Cilindro provisorio PreFormance 5mm (no-hexagonal)

WPFTC61 Cilindro provisorio PreFormance 6mm (hexagonal)

WPFTC62 Cilindro provisorio PreFormance 6mm (no-hexagonal)

WPP552 Poste Prep-Tite 5mm(D) x 5mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal

WPP552G Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 2mm(A)

WPP554G Poste GingiHue 5mm(D) x 5mm(P)x 4mm(A)

WPP562G Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)

WPP564G Poste GingiHue 5mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)

WPP572G Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)

WPP574G Poste GingiHue 5mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)

WPP662 Poste Prep-Tite 6mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A) con tornillo de titanio hexagonal

WPP662G Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 2mm(A)

WPP664G Poste GingiHue 6mm(D) x 6mm(P)x 4mm(A)

WPP672G Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 2mm(A)

WPP674G Poste GingiHue 6mm(D) x 7,5mm(P)x 4mm(A)

WT2553 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)






*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

- WT2554 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
- WT2556 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
- WT2558 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 5,6mm(P) x 8mm(A)
- WT2563 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
- WT2564 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- WT2566 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
- WT2568 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
- WT2573 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
- WT2574 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 4mm(A)
- WT2576 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 6mm(A)
- WT2578 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 5mm(D) x 7,5mm(P) x 8mm(A)
- WT2663 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 3mm(A)
- WT2664 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 4mm(A)
- WT2666 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 6mm(A)
- WT2668 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 6,8mm(P) x 8mm(A)

..//

- WT2673 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm(P) x 3mm(A)
- WT2674 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
- WT2676 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
- WT2678 Pilar de cicatrización Ep de 2 piezas 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
- WTC51 Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D)
- WTC52 Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 5mm(D).
- WTC61 Cilindro para implante hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D)
- WTC62 Cilindro para implante no hexagonal provisorio c/tornillo hexagonal 6mm(D).
- WTCS51 Cilindro provisorio hexagonal 5mm(D) con retención
- WTCS52 Cilindro provisorio no hexagonal 5mm(D) con retención
- WTCS61 Cilindro provisorio hexagonal 6mm(D) con retención
- WTCS62 Cilindro provisorio no hexagonal 6mm(D) con retención
- WTH52 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 2mm(A)
- WTH53 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 3mm(A)
- WTH54 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 4mm(A)
- WTH56 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm(P) x 6mm(A)
- WTH562 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 2mm(A)
- WTH563 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 3mm(A)
- WTH564 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 4mm(A)
- WTH566 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 6mm(A)
- WTH568 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 6mm(P) x 8mm(A)
- WTH572 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
- WTH573 Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.N.M.S.F.*

..//

WTH574	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH576	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH578	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH58	Pilar de cicatrización Ep 5mm(D) x 5,6mm (P) x 8mm(A)
WTH62	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm(P) x 2mm(A)
WTH63	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 3mm(A)
WTH64	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 4mm(A)
WTH66	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 6mm(A)
WTH672	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm(P) x 2mm(A)
WTH673	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 3mm(A)
WTH674	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 4mm(A)
WTH676	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 6mm(A)
WTH678	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 7,5mm (P) x 8mm(A)
WTH68	Pilar de cicatrización Ep 6mm(D) x 6,8mm (P) x 8mm(A)
EDA	Pilar de diseñador Encode
EDAX	Pilar diseñado en laboratorio Encode
EDAZ	Pilar de diseñador de circonio Encode
EDAZX	Pilar de circonio diseñado en laboratorio Encode
ICZGS	Tornillo Gold-Tite de circonio Encode / ZiReal Art
ICZTIS	Tornillo de prueba de circonio Encode / ZiReal Art

Período de vida útil: 5 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) BIOMET 3i.

2) BIOMET SPAIN ORTHOPAEDICS S.L

3) CHANGZHOU BIOMET MEDICAL DEVICES CO. LTD.

4) LX Precision (Shanghai) Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: 1) 4555 Riverside Drive, Palm Beach Gardens, Florida, ESTADOS UNIDOS.

2) Islas Baleares, 50 Poligono Fuente Del Jarro Paterna, 46988, ESPAÑA.


3) N° 235 Chuangxin Road, Epz Xinbei District, Changzhou City, 213031, CHINA.

4) Bldg. 8, Lane 88; Yuan Shan Road, Minhang Dist. Shanghai - 201108, CHINA.

Se extiende a DENTALMAX S.A. el Certificado PM-707-20, en la Ciudad de Buenos Aires, a ...**13 FEB 2012**..., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

**0908**



Dr. OTTO A. VORSINGHER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.