



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº **7583**

BUENOS AIRES, **11 JUL 2017**

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-003035-17-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones DEPLAMED S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

E. *1*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N°

7 5 8 13

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Kangyuan, nombre descriptivo Catéter de succión de PVC de uso único y nombre técnico catéteres de succión, de acuerdo con lo solicitado por DEPLAMED S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorícense los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 5 a 6 y 7 a 10 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-179-33, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

E

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

"2017 - AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

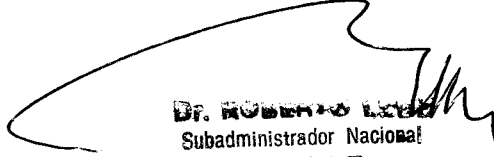
DISPOSICIÓN N° 7583

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-003035-17-5

DISPOSICIÓN N°

7583


Dr. Roberto López
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T

7583

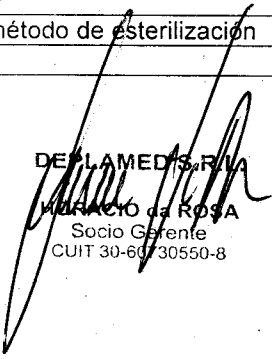
5

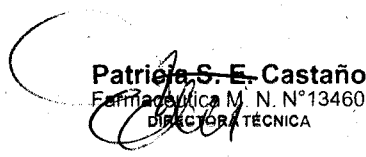
MODELO DE ROTULO

| |
|--|
| 2.1 La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde |
| Razón Social: Deplamed S.R.L. Dirección: Calle 127 n° 2673, (1650) San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
| 2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase. |
| Nombre del fabricante: Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd Dirección (incluyendo Ciudad y País): Songpodong Road, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang 314311, China Nombre del Importador: DEPLAMED S.R.L. Dirección: Calle 127 n° 2673, (1650) San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina MARCA: Kangyuan NOMBRE GENÉRICO: Catéter de succión de PVC de uso único MODELOS: (*) |
| 2.3. Si corresponde, la palabra "estéril" |
| Producto médico estéril |
| 2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda |
| Lote N°: |
| 2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad. |
| Fecha de Vencimiento: |
| 2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso |
| Producto médico de un solo uso. Prohibido reutilizar |
| 2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto. |
| No almacenar bajo luz directa o temperaturas extremas. Almacenar a resguardo del agua. No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado |
| 2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos. |
| 2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse; |
| No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado. Usar una única vez. |
| 2.10. Si corresponde, el método de esterilización |

11 JUL 2017


E

DEPLAMED S.R.L.

MARIANO de ROSA
 Socio Gerente
 CUIT 30-60730550-8

Patriela S. E. Castaño

 Farmacéutica M. N. N°13460
 DIRECTORA TÉCNICA

E


7583




| |
|---|
| Esterilizado por Óxido de Etileno |
| 2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función |
| Director técnico: FARM. PATRICIA SANDRA ETELVINA CASTAÑO - M.N. N° 13.460 |
| 2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente |
| Autorizado por ANMAT PM N° 179-33 |
| Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias |
| Nota Aclaratoria (*) |
| A continuación se declaran la totalidad de los modelos 5, Fr 6 Fr 7Fr 8Fr 10Fr 12Fr 14Fr 16Fr 18Fr 20Fr 22Fr 24Fr |

E.


DEPLAMED S.R.L.
HORACIO da ROSA
Socio Gerente
CUIT 30-90730550-8


Patricia S. E. Castaño
Farmacéutica M. N. N° 13460
DIRECTORA TÉCNICA

7583

**INSTRUCCIONES DE USO**

| |
|---|
| 3.1 Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de este reglamento (Rótulo, salvo las del ítem 2.4 y 2.5) |
| La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde |
| Razón Social: Deplamed S.R.L. Dirección: Calle 127 n° 2673, (1650) San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
| La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase. |
| Nombre del fabricante: Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd Dirección (incluyendo Ciudad y País): Songpodong Road, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang 314311, China Nombre del Importador: DEPLAMED S.R.L. Dirección: CALLE 127 N° 2673 (ex Castro), SAN MARTIN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA MARCA: Kangyuan NOMBRE GENÉRICO: Catéter de succión de PVC de uso único |
| MODELOS: (*) |
| Si corresponde, la palabra "estéril" |
| Estéril |
| La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso |
| De un solo uso. |
| Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto. |
| No almacenar bajo luz directa o temperaturas extremas. Almacenar a resguardo del agua. No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado |
| Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos. |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la integridad del producto. 2. Cuando sea posible, explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. 3. Colocar al paciente en posición semisentado, si no existe contraindicación. 4. Lavarse manos e utilizar guantes. 5. Disponer el material que se va a utilizar manteniendo las normas de asepsia y antisepsia. 6. Lubricar la punta distal del tubo. 7. Introducir en una de las fosas nasales durante la inspiración del paciente. 8. Pedir al paciente que tosa con el fin de ayudar a eliminar sus secreciones. 9. Durante la succión realizar movimientos giratorios con el dedo pulgar e índice. 10. Pedir al paciente que realce varias respiraciones profundas. 11. Repetir el procedimiento en base a lo necesario y tolerado por el paciente. 12. Auscultar el tórax y valorar los ruidos respiratorios. |

DEPLAMED S.R.L.
HORACIO BA ROSA
Socio Gerente
CUIT 30-60730550-8

Patricia S. E. Castaño
Farmacéutica M. N. N° 13460
DIRECTORA TÉCNICA

F

7583

8

| |
|--|
| 13. Desechar las secreciones respiratorias succionadas siguiendo las normas de seguridad e higiene. |
| Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse; |
| No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado. Usar una única vez. |
| Si corresponde, el método de esterilización |
| Esterilizado por: óxido de etileno. |
| Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función |
| Director técnico: FARM. PATRICIA SANDRA ETELVINA CASTAÑO - M.N. N° 13.460 |
| Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente |
| Autorizado por ANMAT PM N° 179-33 |
| Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias |
| 3.2 Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados. |
| (Detallados en sección aparte de Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia) |
| 3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener combinación segura. |
| Información detallada en el Rótulo |
| 3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos. |
| No aplica. |
| 3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico. |
| No aplica. |
| 3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos. |
| No aplica. |
| 3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización. |


DEPLAMED S.R.L.
HORACIO de ROSA
Socio Gerente
CUIT 37-60730550-8

Patricia S. E. Castaño
Farmacéutica M. N. N° 13460
DIRECTORA TÉCNICA

| |
|---|
| No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado. |
| 3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones. |
| No aplica. |
| En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formulados de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos. |
| No aplica. |
| 3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros) |
| Antes de proceder a la apertura del envoltorio, verificar que se encuentre intacto. |
| 3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad, y distribución de dicha radiación debe ser descripta. |
| No aplica. |
| 3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico. |
| No aplica. |
| 3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración, a fuentes térmicas de ignición, entre otras. |
| No almacenar bajo luz directa o temperaturas extremas. Almacenar a resguardo del agua. No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado |
| 3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate este destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar |
| No aplica. |
| 3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación. |
| No aplica. |
| 3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos. |
| No aplica. |

DEPLAMED S.R.L.

 HORACIO da ROSA
 Socio Gerente
 CUIT 30.60730550-8


 Patricia S. E. Castaño
 Farmacéutica M.N. N° 13460
 DIRECTORA TÉCNICA

| |
|---|
| 3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición |
| No aplica. |
| Nota aclaratoria: (*) |
| A continuación se declaran la totalidad de los modelos |
| 5, Fr |
| 6 Fr |
| 7Fr |
| 8Fr |
| 10Fr |
| 12Fr |
| 14Fr |
| 16Fr |
| 18Fr |
| 20Fr |
| 22Fr |
| 24Fr |

E

DEPLAMED S.R.L.
HORACIO G. ROSA
Socio Gerente
CUIT 30-60730550-8

Patricia S. E. Castaño
Farmacéutica M. N. N°13460
DIRECTORA TÉCNICA



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T*

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-003035-17-5

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **7.583**, y de acuerdo con lo solicitado por DEPLAMED S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Catéter de succión de PVC de uso único

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-749, catéteres de succión

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Kangyuan

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: conducir secreciones aspiradas desde el paciente.

Modelo/s: 5 Fr;

6 Fr;

7 Fr;

8 Fr;

10 Fr;

12 Fr;

14 Fr;

16 Fr;

18 Fr;

20 Fr;

22 Fr;

24 Fr;

Período de vida útil: un solo uso, vence luego de 5 años desde la fecha de fabricación.

Forma de presentación: unitaria

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración: Songpodong Road, Shendang Town, Haiyan, Zhejiang 314311, China.

Se extiende a DEPLAMED S.R.L. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-179-33, en la Ciudad de Buenos Aires, a **1 JUL 2017**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

7583

Dr. Roberto Eche
Subadministrador Nacional
A. N. M. S. P.