



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 3688

BUENOS AIRES, 11 JUN 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-22462/12-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que la firma Praxair Argentina S.R.L. solicita la revalidación y modificación del certificado de inscripción del Producto Médico N° PM 1094-19, denominado: Unidades de Presión Continua Positiva en las Vías Respiratorias, Respirationics.

§ - Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Departamento de Registro y la Dirección de Tecnología Médica han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 425/10.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Insititutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **3688**

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta del Producto Médico Nº PM 1094-19, denominado: Unidades de Presión Continua Positiva en las Vías Respiratorias, Respironics y Revalídese la fecha de vigencia del certificado propiedad de la firma Praxair Argentina S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT 3493 de fecha 20 de junio de 2007 y sus rectificatorias y modificatorias, según lo establecido en el anexo que forma parte de la presente disposición.

ARTICULO 2º.- Aceptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y deberá agregarse al Certificado PM 1094-19.

ARTICULO 3º.- Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición y anexo. Gírese al Departamento de Registro a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.


Dr. OTTO M. G. SINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Expediente Nº 1-47-22462/12-9

DISPOSICION Nº **3688**



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
S.A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° ~~3698~~ **3698**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM-1094-19 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Praxair Argentina S.R.L., la modificación de los datos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre comercial / Genérico aprobado: Unidades de Presión Continua Positiva en las Vías Respiratorias / Respironics

Autorizado por Disposición ANMAT N° 3493, de fecha 20 de Junio de 2007

Tramitado por expediente N° 1-47-25212/06-9

Clase de Riesgo: II

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACION AUTORIZADA
Vigencia del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos	20 de Junio de 2012	20 de Junio de 2017
Modelos:	BiPAP Synchrony BiPAP Auto M Series BiPAP Plus M Series BiPAP Harmony	- BiPAP® Auto Bi-Flex - BiPAP® Pro Bi-Flex - BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System - BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
S.A.N.M.S.I.T

		<u>Accesorio:</u> - System One Heated Humidifier
Tiempo de Vida Útil	-	5 años
Indicaciones Autorizadas	-	Los dispositivos BiPAP® de Respironics están diseñados para ofrecer presión positiva de las vías respiratorias para el tratamiento de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) e insuficiencia respiratoria en adultos con un peso superior a 30 kg. BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System: está indicado su uso en pacientes pediátricos mayor de 7 años y con un peso superior a 18 Kg y en pacientes adultos con un peso superior a 30 kg. Estos equipos pueden usarse en el hospital o domicilio del paciente. El humidificador térmico es un accesorio para los dispositivos de terapia REMstar y BiPAP de Respironics cuya función es aportar humedad al circuito

3



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
S.A.R.I.

		del paciente. Está indicado para utilizarse en pacientes que respiran espontáneamente de más de 30 kg de peso, en casa o en el hospital/centro, que utilizan terapia de ventilación con presión positiva aplicada mediante mascarilla.
Fabricantes y Dirección	Respironics Inc., 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668-8550, Estados Unidos	<ul style="list-style-type: none">- Respironics Inc., 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, Estados Unidos- Respironics Inc., 312 Alvin Drive, New Kensington, PA 15068, Estados Unidos.- Respironics Inc., 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, Estados Unidos.
Rótulos e Instrucciones de uso	Según Anexo II de Disposición 3493/07	Fs. 6-7 y 8-31 respectivamente

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Inspección
A.N.M.A.T.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma Praxair Argentina S.R.L., Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 1094-30, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **11 JUN 2013**.....


Expediente N° 1-47-22462/12-9

DISPOSICIÓN N°

3688

DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

3608



ROTULO
RESPIRONICS BIPAP
PM: 1094-19

RESPIRONICS

**BiPAP Auto Bi-Flex - BiPAP Pro Bi-Flex - BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System
- BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System**

Fabricado por:

- 1- Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, Estados Unidos.
- 2- Respironics Inc. 312 Alvin Drive, New Kensington, PA 15068, Estados Unidos.
- 3- Respironics Inc. 175 chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, Estados Unidos.

Importado por: Praxair Argentina SRL

Saavedra 2593, El Talar, provincia de Buenos Aires

Marca: Respironics

Modelos:

- BiPAP® Auto Bi-Flex
- BiPAP® Pro Bi-Flex
- BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System
- BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System

Accesorio:

System One Heated Humidifier

Número de Serie:

Fecha de Fabricación:




IPX1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Firma: DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627

	<p style="text-align: center;">ROTULO</p> <p style="text-align: center;">RESPIRONICS BIPAP</p> <p style="text-align: right;">PM: 1094-19</p> <div style="text-align: right;"></div>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentación:

De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1,2 A


12 VCC, 5,0 A (Batería externa)

24 VCC, 4,2 A (Fuente de alimentación)

Condición de Venta:

Responsable Técnico: Farmaceutico Dario Lanfranchi

Producto Autorizado por la ANMAT PM: 1094-19




Farm. DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

7688



PM: 1094-19

RESPIRONICS

**BiPAP Auto Bi-Flex - BiPAP Pro Bi-Flex - BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System
- BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System**

3.1

Fabricado por:

- 1- Respironics Inc. 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, Estados Unidos.
- 2- Respironics Inc. 312 Alvin Drive, New Kensington, PA 15068, Estados Unidos.
- 3- Respironics Inc. 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, Estados Unidos.

Importado por: Praxair Argentina SRL

Saavedra 2593, El Talar, provincia de Buenos Aires

Marca: Respironics

Modelos:

- BiPAP® Auto Bi-Flex
- BiPAP® Pro Bi-Flex
- BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System
- BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System

Accesorio:

System One Heated Humidifier



IPX1



Alimentación:

De 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 1,2 A.


12 VCC, 5,0 A (Batería externa)

24 VCC, 4,2 A (Fuente de alimentación)

Condición de Venta:

Responsable Técnico: Farmaceutico Dario Lanfranchi

Producto Autorizado por la ANMAT PM: 1094-19



Farm. DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627

Contenido del Envase:

- 1- BiPAP Auto Bi-Flex y BiPAP Pro Bi-Flex
- 2- Humidificador térmico System One

Piezas y contenido del sistema


IMPORTANTE: Lea y entienda el manual de su dispositivo de terapia en su totalidad antes de intentar utilizar este humidificador.

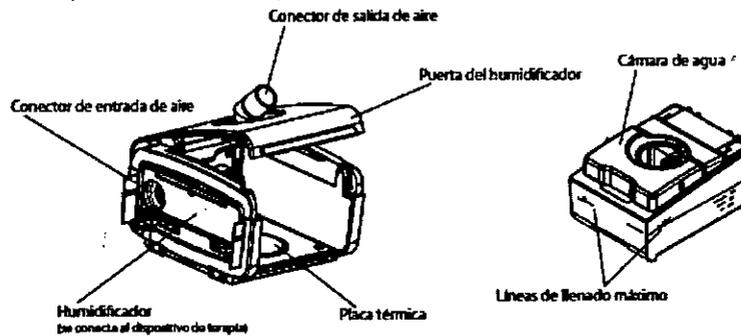

Su sistema BiPAP incluye los elementos siguientes:

- Dispositivo
- Panel de la cubierta lateral
- Manual del usuario • Tarjeta SD
- Maletín/bolsa portátil • Filtro de espuma gris reutilizable
- Tubo flexible • Filtro ultrafino desechable (opcional)
- Cable de alimentación y fuente de alimentación • Humidificador (opcional)


- 3- BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System y BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System

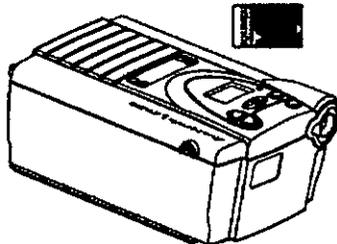

Unidad con tarjeta SmartCard™ de Encore® Pro



Tubo flexible
1,83 m x 22 mm D.I.





Farm. DARIO LAX FRANCHI
M.P. 18.627


PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO **3688**
RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



Fuente externa de alimentación de CA



Cable de alimentación



Manual del usuario



Filtros de espuma gris reutilizables



Filtro ultrafino desechable



Tapa del filtro

Condiciones de almacenamiento y manipulación:

1- Equipos BiPAP

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y firme en un lugar que pueda alcanzar fácilmente desde donde lo vaya a utilizar y a un nivel inferior al de la posición en la que usted vaya a dormir. Asegúrese de que la zona de los filtros de la parte trasera del dispositivo no esté bloqueada por ropa de cama, cortinas u otras cosas. Para que el dispositivo funcione correctamente, el aire debe fluir libremente alrededor del sistema. Asegúrese de que el dispositivo este alejado de todo aparato calefactor o refrigeradores (es decir, salidas de ventilación, radiadores y aire acondicionado).

Precaución: No coloque el dispositivo directamente sobre alfombras, moquetas, telas u otros materiales inflamables.

Precaución: No ponga el dispositivo en recipientes que puedan recoger o almacenar agua, ni encima de dichos recipientes.

2- Humidificador térmico System One

Coloque el dispositivo de terapia conectado con el humidificador sobre una superficie plana a un nivel inferior al de la posición en la que usted vaya a dormir.

PRECAUCIÓN: No coloque el humidificador directamente sobre alfombras, moquetas, telas u otros materiales inflamables.

PRECAUCIÓN: No ponga el dispositivo en recipientes que puedan recoger o almacenar agua, ni encima de dichos recipientes.


Tome precauciones para proteger el mobiliario de daños producidos por agua.

Farm. DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

31600



PM: 1094-19

PRECAUCIÓN: No encienda el humidificador sin la cámara de agua instalada. Si no hay agua en la cámara, el ajuste numérico del humidificador debe ser 0.

PRECAUCIÓN: No intente llenar la cámara mientras esté dentro del humidificador.

ADVERTENCIA: Antes de quitar la cámara de agua, deje que la placa térmica del humidificador y el agua se enfríen durante unos 15 minutos. Es posible que se sufra una quemadura al: tocar la placa térmica, entrar en contacto con el agua calentada o tocar la cubeta de la cámara.

Equipos BiPAP

Conexión del circuito respiratorio

Para utilizar el sistema necesitara los siguientes accesorios a fin de montar el circuito recomendado:

- Interfaz de Respironics (mascarilla nasal o mascarilla facial completa) con conector espiratorio integrado, o interfaz de Respironics con un dispositivo espiratorio independiente (como el Whisper Swivel II)
- Tubo flexible de 1,83 m de Respironics
- Arnés de Respironics (para la mascarilla)

ADVERTENCIA: Si el dispositivo lo utilizan varias personas (p. ej., en servicios de alquiler), deberá instalarse un filtro antibacteriano de flujo principal y baja resistencia entre el dispositivo y el tubo del circuito para prevenir la contaminación.

Para conectar el circuito respiratorio al dispositivo, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Conecte el tubo flexible a la salida de aire que hay en el lateral del dispositivo.

Nota: Si es necesario, conecte un filtro antibacteriano a la salida de aire del dispositivo y, a continuación, conecte el tubo flexible a la salida del filtro antibacteriano.

Nota: El filtro antibacteriano está recomendado para proteger al paciente, al proveedor de servicios médicos y al equipo de la transferencia de virus o bacterias a través del circuito respiratorio.

Nota: El rendimiento del dispositivo podría verse afectado si se utiliza el filtro antibacteriano. No obstante, el dispositivo seguirá funcionando y suministrando terapia.


2. Conecte el tubo a la mascarilla. Consulte las instrucciones suministradas con la mascarilla.

Fam. DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3080



PM: 1094-19

3. Fije el arnés a la mascarilla si es necesario. Consulte las instrucciones suministradas con el arnés.

Lleve a cabo los siguientes pasos para utilizar el dispositivo con alimentación de CA:

1. Enchufe el extremo con el conector hembra del cable de alimentación de CA (incluido) en la fuente de alimentación (también incluida).
2. Enchufe el extremo con clavijas del cable de alimentación de CA en una toma de corriente que no esté controlada por un interruptor de pared.
3. Enchufe el conector del cable de la fuente de alimentación en la entrada de alimentación de la parte trasera del dispositivo.
4. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmemente fijadas.

IMPORTANTE: Para retirar la alimentación de CA, desconecte el cable de la fuente de alimentación de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Inspeccione periódicamente los cables eléctricos para ver si presentan danos o señales de desgaste. Si están dañados, deje de utilizarlos y sustitúyalos.

PRECAUCION: No utilice cables alargadores con este dispositivo. Navegación por las pantallas

Gire la rueda para alternar entre las opciones y los ajustes en la pantalla. Pulse la rueda para elegir la opción o el ajuste que aparece resaltado. Si selecciona Back (Atrás) o el icono  en cualquier pantalla, volverá a la pantalla anterior.

Nota: Las pantallas que se muestran a lo largo de este manual son solo ejemplos. Las pantallas reales podrían variar ligeramente. Los ejemplos se proporcionan solo a modo de referencia.

Precauciones de Empleo:


Las precauciones indican la posibilidad de que el dispositivo resulte dañado.

- No toque las patillas de los conectores. No deben hacerse conexiones a estos conectores si no se utilizan procedimientos preventivos de descargas electrostáticas. Los procedimientos preventivos incluyen métodos para evitar la acumulación de carga electrostática (p. ej., aire acondicionado, humidificación, coberturas conductoras de suelos,

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



ropa no sintética), descargar el propio cuerpo entrando en contacto con el bastidor del equipo o sistema, con tierra o con objetos metálicos de gran tamaño, y la unión de uno mismo al equipo, al sistema o a tierra mediante una correa de muñeca.

- Antes de utilizar el dispositivo, compruebe que este instalada la cubierta de la tarjeta SD si no está instalado ninguno de los accesorios (como el MODEM o el modulo de conexión). Consulte las instrucciones suministradas con el accesorio.

- La condensación puede dañar el dispositivo. Si este dispositivo se ha expuesto a temperaturas muy altas o muy bajas, deje que alcance la temperatura ambiente (temperatura de funcionamiento) antes de iniciar la terapia. No utilice el dispositivo fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento indicado en el apartado Especificaciones.

- No utilice cables alargadores con este dispositivo.

- No coloque el dispositivo directamente sobre alfombras, moquetas, telas u otros materiales inflamables.

- No ponga el dispositivo en recipientes que puedan recoger o almacenar agua, ni encima de dichos recipientes.

- El funcionamiento correcto requiere que haya instalado adecuadamente un filtro de entrada de espuma reutilizable que no esté dañado.

- El humo de tabaco puede producir acumulación de alquitrán en el interior del dispositivo, lo que puede hacer que el dispositivo funcione incorrectamente.

- Los filtros de entrada sucios pueden provocar altas temperaturas de funcionamiento que pueden afectar al rendimiento del dispositivo.

Examine periódicamente los filtros de entrada según sea necesario para comprobar que están en buen estado y limpios.

- Nunca instale un filtro mojado en el dispositivo. Tras limpiar el filtro, deberá asegurarse de dejar transcurrir tiempo suficiente para que se seque.


- Cuando la alimentación de CC se obtiene de la batería de un vehículo, no debe utilizarse el dispositivo mientras el motor del vehículo está en marcha. El dispositivo podría resultar dañado.



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688

PM: 1094-19



- Utilice únicamente un cable de alimentación de CC y un cable adaptador de batería de Respironics. El uso de cualquier otro sistema podría dañar al dispositivo.

Humidificador térmico System One

Las precauciones indican la posibilidad de que el dispositivo resulte dañado.

- No coloque el humidificador directamente sobre alfombras, moquetas, telas u otros materiales inflamables.
- No ponga el dispositivo en recipientes que puedan recoger o almacenar agua, ni encima de dichos recipientes. Tome precauciones para proteger el mobiliario de daños producidos por agua.
- No llene la cámara de agua por encima de la línea de llenado máximo. El dispositivo terapéutico o el humidificador podrían resultar dañados. Si la cámara de agua está a rebosar, al poner la tapadera de la cámara podría salir agua por la entrada de la cámara (localizada en la parte trasera de la cámara).
- Utilice sólo agua destilada a temperatura ambiente en la cámara. No ponga productos químicos ni aditivos en el agua. Podría producirse irritación en las vías respiratorias o daño a la cámara de agua.
- Retire la cámara, vacíe toda el agua y vuelva a colocar la cámara vacía antes de mover la base del humidificador.
- No intente llenar la cámara de agua mientras esté dentro del humidificador.
- Para evitar los derrames, no desconecte el humidificador del dispositivo de terapia con agua en la cámara. Extraiga la cámara de agua del humidificador antes de desconectar el dispositivo de terapia.
- No encienda el humidificador sin la cámara de agua instalada. Si no hay agua en la cámara, el ajuste numérico del humidificador debe ser 0.
- La puerta del humidificador debe fijarse en la posición abierta antes de extraer la cámara de agua. No extraiga la cámara de agua sin asegurarse de que la puerta del humidificador esté bloqueada en la posición abierta.



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688

PM: 1094-19



- No mueva el humidificador mientras haya agua en la cámara de agua.
- Sólo los procedimientos de limpieza de hospitales y centros indicados en este manual están recomendados por Respironics. El uso de otros procesos de limpieza y desinfección no especificados por Respironics, podría afectar al rendimiento del producto.

3.2

Finalidad de uso:

Los dispositivos BiPAP® de Respironics están diseñados para ofrecer presión positiva de las vías respiratorias para el tratamiento de Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) e insuficiencia respiratoria) en adultos con un peso superior a 30 Kg.

BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System: está indicado su uso en pacientes pediátricos mayor de 7 años y con un peso superior a 18 Kg, y en pacientes adultos con un peso superior a 30 Kg.

Estos equipos pueden usarse en el hospital o domicilio del paciente.

Contraindicaciones

Efectos secundarios:


A continuación, se indican los posibles efectos secundarios de la terapia de presión positiva no invasiva:


- Molestia en los oídos
- Conjuntivitis
- Escoriación cutánea debida a mascarillas no invasivas
- Distensión gástrica (aerofagia)

3.3

Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para los sistemas (p. ej., un humidificador o módem). Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para obtener más información





sobre los accesorios disponibles. Al emplear accesorios opcionales, siga siempre las instrucciones suministradas con ellos.


Adición de un humidificador:

Puede utilizar el humidificador térmico o el humidificador ambiental con su dispositivo. Estos se pueden solicitar al proveedor de servicios médicos. Un humidificador puede reducir la sequedad y la irritación nasales al añadir humedad al flujo de aire.


Humidificador térmico System One

Conexión del dispositivo de terapia


1. Cuando se utilice un humidificador, el circuito del paciente se conecta al conector de salida de aire del humidificador.
2. Para conectar el dispositivo de terapia al humidificador, primero debe quitar la cubierta lateral del dispositivo de terapia. Presione hacia dentro la presilla en la cubierta lateral y retire la cubierta de la unidad.

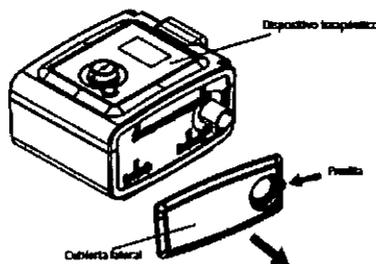

3. A continuación, alinee los componentes lado a lado. Asegúrese de que las guías en el humidificador encajen en las ranuras en el dispositivo de terapia y de que el conector de salida de aire en el dispositivo de terapia encaje en el conector de entrada de aire en el humidificador.

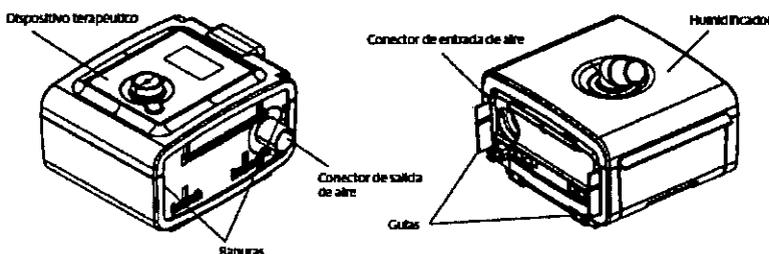


4. Simplemente presione juntas las dos unidades hasta que encajen. Compruebe que el dispositivo de terapia y el humidificador estén totalmente asentados uno en el otro.

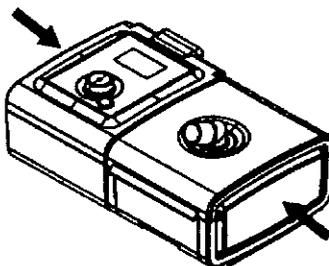

Desconexión del dispositivo de terapia

PRECAUCIÓN: Para evitar los derrames, no desconecte el humidificador del dispositivo de terapia con agua en la cámara. Extraiga la cámara de agua del humidificador antes de desconectar el dispositivo de terapia.

1. Agarre el tirador de apertura en la parte inferior del humidificador.
2. Mientras sujeta el dispositivo de terapia y el humidificador, tire del tirador de apertura y separe las dos unidades.

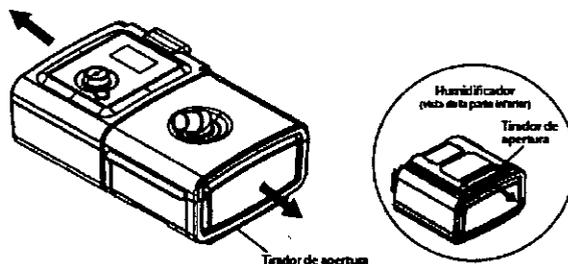


3. Si va a utilizar el dispositivo de terapia sin el humidificador, vuelva a colocar la cubierta lateral en el dispositivo de terapia. Adición de oxígeno suplementario.



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688



PM: 1094-19

Puede añadirse oxígeno en la conexión de la mascarilla. Tenga en cuenta las advertencias siguientes al utilizar oxígeno con el dispositivo.

ADVERTENCIAS:

- Cuando se utilice oxígeno con este sistema, el suministro de oxígeno debe cumplir la normativa local sobre oxígeno médico.
- Cuando se utilice oxígeno con este sistema, deberá conectarse una válvula de presión de Respironics al circuito del paciente después de la fuente de oxígeno. Si no se utiliza la válvula de presión, puede haber peligro de incendio.
- Al utilizar oxígeno con este sistema, encienda el dispositivo antes de activar el oxígeno. Desactive el flujo de oxígeno antes de apagar el dispositivo. Esto evitará la acumulación de oxígeno en el dispositivo.
- No conecte el dispositivo a una fuente de oxígeno no regulada o de alta presión. Suministro de alimentación de CC al dispositivo. El cable de alimentación de CC de Respironics puede utilizarse para hacer funcionar el dispositivo en un barco, una caravana o un vehículo similar detenido. El cable adaptador de batería de CC de Respironics, cuando se utiliza con el cable de alimentación de CC, permite accionar el dispositivo con una batería autónoma de 12 V de CC.

PRECAUCION: Cuando la alimentación de CC se obtiene de la batería de un vehículo, no debe utilizarse el dispositivo mientras el motor del vehículo está en marcha. El dispositivo podría resultar dañado.

PRECAUCION: Utilice únicamente un cable de alimentación de CC y un cable adaptador de batería de Respironics. El uso de cualquier otro sistema podría dañar al dispositivo.

Consulte las instrucciones suministradas con el cable de alimentación de CC y el cable adaptador para ver cómo funciona el dispositivo con alimentación de CC.

3.4

Configuración del Dispositivo BiPAP

Instalación de los filtros de aire

PRECAUCION: El funcionamiento correcto requiere que haya instalado adecuadamente un filtro de espuma gris reutilizable que no esté dañado.


El dispositivo utiliza un filtro de espuma gris lavable y reutilizable, y un filtro ultrafino


FIRM. DARIO ESFRANCHI
M.P. 18.627



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



blanco opcional desechable. El filtro reutilizable impide la entrada del polvo y el polen normales de entornos domésticos, mientras que el filtro ultrafino opcional ofrece una filtración más completa de partículas muy finas. El filtro reutilizable gris debe estar instalado en todo momento cuando el dispositivo este funcionando. El filtro ultrafino está recomendado para personas sensibles al humo de tabaco o a otras partículas pequeñas.

Con el dispositivo se suministra un filtro de espuma gris reutilizable. El filtro ultrafino desechable está disponible como accesorio. Si no recibe su dispositivo con el filtro ya instalado, deberá instalar al menos el filtro de espuma gris reutilizable antes de utilizar el dispositivo. Para instalar el filtro o los filtros:

1. Si utiliza el filtro ultrafino blanco desechable, insértelo primero en el área de filtros con el lado de la rejilla orientado hacia el interior del dispositivo.
2. Introduzca el filtro de espuma gris requerido en la zona de los filtros después del filtro ultrafino.

Nota: Si no está utilizando el filtro desechable blanco, solamente tiene que introducir el filtro de espuma gris en la zona de los filtros.


Ubicación del Dispositivo

Humidificador térmico System One

Coloque el dispositivo de terapia conectado con el humidificador sobre una superficie plana a un nivel inferior al de la posición en la que usted vaya a dormir.

Equipos BiPAP

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y firme en un lugar que pueda alcanzar fácilmente desde donde lo vaya a utilizar y a un nivel inferior al de la posición en la que usted vaya a dormir. Asegúrese de que la zona de los filtros de la parte trasera del dispositivo no esté bloqueada por ropa de cama, cortinas u otras cosas. Para que el dispositivo funcione correctamente, el aire debe fluir libremente alrededor del sistema. Asegúrese de que el dispositivo este alejado de todo aparato calefactor o refrigeradores (es decir, salidas de




DANIEL L. ANIBRANCHI
M.P. 18.627



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



ventilación, radiadores y aire acondicionado).

Precaución: No coloque el dispositivo directamente sobre alfombras, moquetas, telas u otros materiales inflamables.

Precaución: No ponga el dispositivo en recipientes que puedan recoger o almacenar agua, ni encima de dichos recipientes.

3.6


No existe interferencia recíproca entre el empleo del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos, sin embargo se indican las siguientes:

- Al utilizar este producto en combinación con algún otro producto electromédico, se deben satisfacer los requisitos de la normativa IEC 60601-1-1 (requisitos de seguridad para sistemas médicos eléctricos).

Precauciones Adicionales:

No deberá utilizar el dispositivo si padece paro respiratorio grave y no puede iniciar espontáneamente la respiración. Si padece cualquiera de las siguientes afecciones, consulte con el médico antes de utilizar el dispositivo:

- Incapacidad para mantener las vías respiratorias despejadas o para eliminar adecuadamente las secreciones.
- Riesgo de aspiración del contenido gástrico.
- Diagnóstico de sinusitis aguda o de otitis media.
- Alergias o hipersensibilidad a los materiales de la mascarilla cuando el riesgo de una reacción alérgica sea mayor que los beneficios de la asistencia ventilatoria.
- Aspiración pulmonar de sangre debida a epistaxis
- Hipotensión
- Informe inmediatamente acerca de cualquier molestia inusual en el pecho, si se encuentra sin aliento o siente un dolor de cabeza intenso.
- Si presenta irritación cutánea o la piel se reseca debido al uso de la mascarilla,



consulte las instrucciones de la mascarilla para consultar las medidas convenientes.

A continuación, se indican los posibles efectos secundarios de la terapia de presión positiva no invasiva:

- Molestia en los oídos
- Conjuntivitis
- Escoriación cutánea debida a mascarillas no invasivas
- Distensión gástrica (aerofagia)

3.8

Limpieza y mantenimiento

- Humidificador térmico System One Limpie la base y el orificio de salida del humidificador según se describe en el apartado Limpieza en casa anterior.
- Limpie y desinfecte la cámara de agua del humidificador siguiendo los procedimientos indicados a continuación.

1. Desmonte la cámara separando la tapadera y la base.

2. Con las piezas de la cámara en remojo en un detergente para lavavajillas suave, utilice un cepillo de cerdas blandas para limpiar cada una de ellas. Preste mucha atención a todas las esquinas y hendiduras.

3. Enjuague cada pieza con agua dos veces. Asegúrese de agitar la pieza energicamente en agua durante el enjuague, y dejarla secar al aire, sin exponerla a la luz directa del sol.

Desinfección

Se pueden utilizar los procesos siguientes para desinfectar la cámara de agua durante un máximo de 60 ciclos:

- Desinfección térmica: Inmersión en un baño de agua (corriente) a $75\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 30 minutos
- Control III
- Cidex

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688

PM: 1094-19



• Cidex OPA

Después de la desinfección, examine visualmente cada pieza. Deseche y sustituya las piezas dañadas.

Mantenimiento

El humidificador no requiere mantenimiento regular. Si cualquier pieza del humidificador está gastada o dañada, póngase en contacto con Respironics o con su proveedor de servicios médicos.

Equipos BiPAP

ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente de pared antes de limpiar el dispositivo. NO sumerja el dispositivo en ningún líquido.

1. Desenchufe el dispositivo y limpie su exterior con un paño ligeramente humedecido con agua y un detergente suave. Deje que el dispositivo se seque por completo antes de enchufar el cable de alimentación.
2. Después de la limpieza, inspeccione el dispositivo y todas las piezas del circuito para comprobar si han sufrido daños. Sustituya las piezas dañadas.

Limpieza o sustitución de los filtros

Con un uso normal, deberá limpiar el filtro de espuma gris al menos una vez cada dos semanas y sustituirlo por uno nuevo cada seis meses. El filtro ultrafino blanco es desechable y deberá sustituirse después de 30 noches de uso, o antes si está sucio. NO limpie el filtro ultrafino.

PRECAUCION: Los filtros de entrada sucios pueden provocar altas temperaturas de funcionamiento que pueden afectar al rendimiento del dispositivo. Examine periódicamente los filtros de entrada según sea necesario para comprobar que están en buen estado y limpios.


1. Si el dispositivo está funcionando, detenga el flujo de aire. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688

PM: 1094-19



2. Retire el filtro o los filtros de la carcasa apretándolos suavemente por su parte central y desprendiéndolos del dispositivo.
3. Examine el filtro o los filtros para comprobar si están limpios y en buen estado.
4. Lave el filtro de espuma gris en agua caliente con un detergente suave. Enjuáguelo bien para retirar todos los restos de detergente. Deje que el filtro se seque por completo al aire antes de reinstalarlo. Si el filtro de espuma esta rasgado, sustitúyalo. (Como filtros de repuesto solamente deberán utilizarse filtros suministrados por Respironics).
5. Si el filtro ultrafino blanco está sucio o rasgado, sustitúyalo.
6. Vuelva a instalar los filtros, colocando primero el filtro ultrafino blanco, si corresponde.

PRECAUCION: Nunca instale un filtro mojado en el dispositivo. Tras limpiar el filtro, deberá asegurarse de dejar transcurrir tiempo suficiente para que se seque.

Limpieza del tubo

Limpie el tubo diariamente. Desconecte el tubo flexible del dispositivo. Lave el tubo con cuidado en una solución de agua caliente y un detergente suave. Enjuáguelo a fondo. Séquelo al aire.

Mantenimiento

El dispositivo no requiere mantenimiento regular.

ADVERTENCIA: Si observa cambios inexplicables en el funcionamiento del dispositivo, si escucha ruidos extraños o fuertes, si el dispositivo se ha caído o ha sido manipulado incorrectamente, si ha entrado agua en la carcasa o está rota, desconecte el cable de alimentación y deje de utilizar el dispositivo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

3.10

Alarmas


Alertas del dispositivo BiPAP

- Prioridad alta: Estas alertas requieren la respuesta inmediata del operador. La señal de



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

368 0



PM: 1094-19

alerta consiste en un sonido de alta prioridad, que es un patrón continuo de dos pitidos (indicado en la tabla siguiente como: • • • •). Además, las luces de retroiluminación de los botones emiten un patrón parpadeante de prioridad alta formado por un patrón continuo de dos destellos de brillantes a apagados (indicado en la tabla siguiente como: ♦♦ ♦♦).

• Prioridad media: Estas alertas requieren la rápida respuesta del operador. La señal de alerta consiste en un sonido de prioridad media, que es un patrón continuo de un pitido (indicado como: • •). Además, las luces de retroiluminación de los botones emiten un patrón parpadeante de prioridad media formado por un patrón continuo de un destello de brillante atenuado (indicado en la tabla siguiente como: ♦♦).

FARM. DANIO LAMERANCHI
M.P. 16.627



INSTRUCCIONES DE USO

RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



ALERTA	INDICADOR ACUSTICO	INDICADOR VISUAL	ACCION DEL DISPOSITIVO	CAUSA POSIBLE	ACCION DEL PACIENTE
Alerta del humidificador	ninguno	 El icono LED del humidificador parpadeará en el dispositivo.	Aparece sólo cuando el humidificador está encendido y la terapia está activada.	Fallo del humidificador.	La alerta aparece durante 12 minutos o hasta que la situación se corrija. Apague el flujo de aire y vuelva a conectar el humidificador al dispositivo de acuerdo con las instrucciones del humidificador. Si la alerta persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
Mensaje instantáneo	un solo pitido	El proveedor de servicios médicos suministrará el texto que debe mostrarse.	Aparece sólo cuando la terapia está desactivada.	Mensaje del proveedor.	Su proveedor de servicios médicos podría enviar un mensaje instantáneo. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos si tiene alguna pregunta.
Recordatorio del paciente	un solo pitido	En la pantalla aparece el mensaje del proveedor o el símbolo siguiente.	Aparece sólo cuando la terapia pasa de estar activada a estar desactivada. La alerta aparece durante 6 minutos o hasta que el usuario la confirme.	Mensaje del proveedor.	Su proveedor de servicios médicos podría definir un recordatorio de paciente programado para aparecer en un momento particular para recordarle que se cambie la mascarilla, que cambie los filtros, etc. El mensaje predeterminado es: «Check your mask, a new one may be available. Call your provider.» (Compruebe su mascarilla; puede que haya una nueva disponible. Llame a su proveedor.) El proveedor podría cambiar el mensaje.
Tarjeta SD: prescripción aceptada	un solo pitido	En la pantalla aparece «SD card inserted, prescription accepted» (Tarjeta SD insertada, prescripción aceptada) o el símbolo siguiente.	La alerta aparece durante 30 segundos o hasta que el usuario la confirme.	-	El estado de la tarjeta puede comprobarse en el menú Status (Estado).
Tarjeta SD: prescripción rechazada	un solo pitido	En la pantalla aparece «SD card inserted, prescription rejected» (Tarjeta SD insertada, prescripción rechazada) o el símbolo siguiente.	La alerta aparece durante 30 segundos o hasta que el usuario la confirme.	Falta prescripción o es incorrecta.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para obtener la prescripción correcta.
Tarjeta SD: insertada incorrectamente	..	En la pantalla aparece «SD card inserted incorrectly» (Tarjeta SD incorrectamente insertada) o el símbolo siguiente.	La alerta aparece hasta que se tomen medidas.	La tarjeta SD no está insertada correctamente.	La alerta aparece hasta que se extraiga la tarjeta. Extraiga la tarjeta SD y vuelva a insertarla correctamente. Si la alerta persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
Tarjeta SD: llena	..	En la pantalla aparece «SD card full» (Tarjeta SD llena) o el siguiente símbolo animado.	La alerta aparece hasta que se tomen medidas.	La tarjeta SD está llena.	La alerta aparece hasta que se extraiga la tarjeta. El estado de la tarjeta puede comprobarse en el menú Status (Estado). Extraiga la tarjeta SD y cámbiela.

ALERTA	INDICADOR ACUSTICO	INDICADOR VISUAL	ACCION DEL DISPOSITIVO	CAUSA POSIBLE	ACCION DEL PACIENTE
Se requiere mantenimiento	 En la pantalla aparece «Service required» (Se requiere mantenimiento) o el siguiente símbolo animado.	El dispositivo entra en el «estado seguro», en el que la alimentación permanece encendida, pero el flujo de aire está deshabilitado.	Fallo del dispositivo.	Presione la rueda o el botón Rampa para silenciar la alerta. Retire el cable de la fuente de alimentación del dispositivo para apagarlo. Enchufe el cable de nuevo a la entrada de alimentación del dispositivo para encenderlo otra vez. Si la alerta persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
Alerta de mascarilla	..	 En la pantalla aparece «Mask alert» (Alerta de mascarilla) o el siguiente símbolo animado.	La alerta aparece hasta que se tomen medidas.	El circuito respiratorio está desconectado o hay una fuga de aire grande.	Apague el flujo de aire. Compruebe las conexiones del circuito respiratorio y reconecte el tubo si está suelto. Asegúrese de tener la mascarilla bien puesta antes de reiniciar el flujo de aire. Si la alerta persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para que revise la mascarilla. Puede que necesite volver a ajustar la mascarilla.
Desactivación automática	un solo pitido	En la pantalla aparece «Auto off» (Desactivación automática) o el siguiente símbolo animado.	El flujo de aire se apaga y el dispositivo entra en el estado en espera aproximadamente 45-60 segundos después de la detección. La alerta aparece durante 30 segundos o hasta que el usuario la confirme.	La mascarilla se ha quitado.	Vuelva a ponerse la mascarilla y active el flujo de aire para reanudar la terapia.

Farm. Dario LANERANCHI
M.P. 18.627




INSTRUCCIONES DE USO

RESPIRONICS BIPAP

3688



PM: 1094-19

ALERTA	INDICADOR ACÚSTICO	INDICADOR VISUAL	ACCIÓN DEL DISPOSITIVO	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN DEL PACIENTE
Tarjeta SD: extraer	un solo pitido	 En la pantalla aparece «SD card removed» (Tarjeta SD extraída) o el siguiente símbolo. 	La alerta aparece durante 30 segundos o hasta que el usuario la confirme.	La tarjeta SD se ha extraído.	No es necesario hacer nada.
Tarjeta SD: actividad de datos	un solo pitido	En la pantalla aparece «Data activity: Do not remove card» (Actividad de datos: no extraer la tarjeta) o el siguiente símbolo animado. 	La alerta aparece hasta que el usuario la confirme o hasta que termine la actividad con los datos.	--	Aparece sólo nada más desactivarse la terapia, cuando se están transfiriendo datos a la tarjeta.
Tarjeta SD: dañada	. .	 En la pantalla aparece «Corrupt card inserted reformat card?» (Tarjeta dañada Insertada. ¿Reformatear tarjeta?) o el siguiente símbolo. 	La alerta aparece hasta que se tomen medidas.	Existe un problema con la tarjeta SD. Los datos podrían estar dañados.	Seleccione «yes» (sí), o el icono con la marca de verificación, para reformatear la tarjeta. En la pantalla aparece «Reformatting... do not remove card» (Reformateando... no extraiga la tarjeta) o el siguiente símbolo animado.  Si selecciona «no», la alerta desaparecerá y la tarjeta no se reformateará. Nota: Al reformatearse la tarjeta, se perderá toda la información contenida en ella. Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos si tiene alguna pregunta.
Tarjeta SD: extraer y volver a insertar	. .	 En la pantalla aparece «SD card error: remove and reinsert» (Error de tarjeta SD: extraer y volver a insertar) o el siguiente símbolo animado. 	La alerta aparece hasta que se tomen medidas.	El dispositivo no puede leer la tarjeta SD. Puede que exista un problema con la tarjeta SD o que esté insertada incorrectamente.	Extraiga la tarjeta SD y vuelva a insertarla. Si la alerta persiste, cambie la tarjeta o póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.
Módem: marcando	un solo pitido	El módem mostrará su propio icono en el dispositivo. Consulte el manual de instrucciones del módem.	La alerta aparece durante 30 segundos después de la secuencia de llamada o hasta que el usuario la confirme.	Consulte el manual de instrucciones del módem.	Si el módem está marcando mientras la terapia está activa, no aparece la alerta de la secuencia de llamada.
Módem: sin respuesta	un solo pitido	 El módem mostrará su propio icono en el dispositivo. Consulte el manual de instrucciones del módem.	La alerta aparece durante 30 segundos o hasta que el usuario la confirme.	Consulte el manual de instrucciones del módem.	No es necesario hacer nada.


3.11 - 3.12

Precauciones Adicionales:

Contraindicaciones

No deberá utilizar el dispositivo si padece paro respiratorio grave y no puede iniciar espontáneamente la respiración. Si padece cualquiera de las siguientes afecciones, consulte con el médico antes de utilizar el dispositivo:

- Incapacidad para mantener las vías respiratorias despejadas o para eliminar adecuadamente las secreciones



Familiares con el paciente
M.P. 18.627




3688

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

PM: 1094-19



- Riesgo de aspiración del contenido gástrico
- Diagnóstico de sinusitis aguda o de otitis media
- Alergias o hipersensibilidad a los materiales de la mascarilla cuando el riesgo de una reacción alérgica sea mayor que los beneficios de la asistencia ventilatoria
- Aspiración pulmonar de sangre debida a epistaxis
- Hipotensión
- Informe inmediatamente acerca de cualquier molestia inusual en el pecho, si se encuentra sin aliento o siente un dolor de cabeza intenso.
- Si presenta irritación cutánea o la piel se reseca debido al uso de la mascarilla, consulte las instrucciones de la mascarilla para consultar las medidas convenientes.
- Si utiliza oxígeno con el dispositivo, el flujo de oxígeno se debe cerrar cuando el dispositivo no esté en uso.
- Si utiliza oxígeno, el dispositivo se debe equipar con la válvula de presión de Respironics (número de pieza 302418). La omisión de la válvula de presión podría ser causa de peligro de incendio.
- El oxígeno facilita la combustión. No se debe utilizar oxígeno cuando se está fumando ni en presencia de una llama desprotegida.
- No utilice el dispositivo en presencia de una mezcla de anestésicos inflamables con aire o con oxígeno u óxido nitroso.
- No utilice el dispositivo si la temperatura ambiente es superior a 35 °C. Si el dispositivo se utiliza a temperaturas ambiente por encima de los 35 °C, la temperatura del flujo de aire podría sobrepasar los 41 °C y causar irritación en las vías respiratorias. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni lo utilice cerca de un radiador o aparato de calefacción, ya que ello puede aumentar la temperatura del aire que sale de éste.
- Para un uso correcto, la fuente de alimentación se debe colocar derecha y sobre la base.
- Cuando use el dispositivo con un humidificador, coloque el humidificador de manera que el nivel de agua del humidificador esté a una altura menor que la suya y que el humidificador esté al mismo nivel o a uno inferior que el dispositivo.

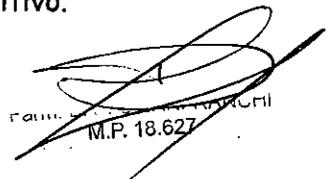

M.P. 18.627

PRAXAIR

INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688

PM: 1094-19



Presión atmosférica: de 77 kPa a 101 kPa (0-2286 m)

Físicas

Dimensiones: 18 cm. x 14 cm. x 10 cm. (largo x ancho x alto)

Peso:

- Humidificador térmico System One aproximadamente 0,89 Kg.
- BiPAP Auto Bi-Flex y BiPAP Pro Bi-Flex (dispositivo con fuente de alimentación):
Aproximadamente 1,53 Kg.
- BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System y BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System: 1,8 Kg.

Capacidad de agua Humidificador térmico System One: 325 ml al nivel de agua recomendado.

Cumplimiento de normas Humidificador térmico System One

Este dispositivo está diseñado para cumplir las siguientes normas:

IEC 60601-1 Requisitos generales de seguridad para equipo eléctrico médico

EN ISO 8185:2007 Requisitos generales de sistemas de humidificación

Eléctricas Humidificador térmico System One

(Cuando el humidificador térmico se utiliza con un dispositivo de terapia de Respironics):

Consumo de energía de CA: de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2,1 A

Consumo de energía de CC: 12 V CC, 5,0 A

Tipo de protección contra descargas eléctricas: equipo de clase II

Grado de protección contra descargas eléctricas: pieza aplicada de tipo BF Grado de protección contra la entrada de agua: a prueba de goteo, IPX1

Modo de funcionamiento: continuo


Compatibilidad electromagnética: El dispositivo cumple los requisitos de la 2ª edición de la norma EN 60601-1-2.

Farm. DARIO LANFRANCHI
M.P. 18.027



INSTRUCCIONES DE USO
RESPIRONICS BIPAP

3688



PM: 1094-19

Eléctricas BiPAP Auto Bi-Flex y BiPAP Pro Bi-Flex

Consumo de energía de CA: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 2,1 A

Consumo de energía de CC: 12 V CC, 5,0 A

Fusibles: No hay fusibles que pueda sustituir el usuario.

Placa térmica

Temperatura máxima: 70 °C

Caída de presión con el humidificador

Máxima: 0,3 cm. H₂O a un flujo de 60 lpm

Humedad: Salida de humedad min.: 10 mg H₂O/l

Medida con el flujo máximo, a 35 °C y 15% de HR.

Ruido: Nivel de presión sonora: < 30 dB(A)

Esta medida se aplica al dispositivo de terapia con o sin el humidificador opcional. Nivel de potencia sonora: < 38 dB(A)

Información sobre CEM (compatibilidad electromagnética)

FUERA DE EMISIONES	CUMPLIMIENTO	ENTORNO ELECTROMAGNETICO - GUIA
Emisiones de radiofrecuencias: CISPR 11	Grupo I	El dispositivo utiliza energía de radiofrecuencia solamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencias son muy bajas y no es probable que produzcan interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de radiofrecuencias: CISPR 11	Clase B	El dispositivo es adecuado para utilizarse en todo tipo de establecimientos, incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de bajo voltaje.
Emisiones armónicas: IEC 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones del voltaje y emisiones de escintillas: IEC 61000-3-3	Cumple:	

Eléctricas BiPAP® Harmony® Ventilatory Support System y BiPAP® Synchrony™ 2 Ventilatory Support System

Consumo de energía de CA: De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,25 A


Consumo de energía de CC: 24 V CC, 3,0 A

Fusibles: No hay fusibles que pueda sustituir el usuario.



FARM. BARIO LANFRANCHI
M.P. 18.627

3688



	INSTRUCCIONES DE USO RESPIRONICS BIPAP PM: 1094-19
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

3.14

Eliminación de Dispositivo

Directrices de Reciclado RAEE/RUSP

Si debe cumplir con los requisitos de las directivas de reciclado RAEE/RUSP, consulte la página www.respironics.com para obtener información sobre cómo reciclar este producto.

Con objeto de preservar el medio ambiente, la eliminación del dispositivo debe realizarse de acuerdo con las normativas locales.

3.16

Precisión del Parámetro medido

Exactitud de la presión

Incrementos de presión: De 4,0 a 25,0 cm. H₂O (en incrementos de 0,5 cm. H₂O)

Estabilidad de la presión:

	Estática	Dinámica < 10 cm H ₂ O	Dinámica ≥ 10,0 a 25 cm H ₂ O
Dispositivo	± 0,5 cm H ₂ O	≤ 0,5 cm H ₂ O	≤ 1,0 cm H ₂ O
Dispositivo con humidificador	± 0,5 cm H ₂ O	≤ 0,5 cm H ₂ O	≤ 1,0 cm H ₂ O

Flujo máximo:

	Presiones de prueba (cm H ₂ O)				
	4,0	9,0	14,5	20,0	25,0
Presión medida en el orificio de conexión del paciente (cm H ₂ O)	3,9	8,7	14,2	19,6	24,0
Flujo promedio en el orificio de conexión del paciente (l/min)	61,0	102,7	137,5	167,4	146,9

FABR. DARIO LANFRANCHI
M.P. 48.627