



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. A. T.*

**DISPOSICIÓN N° 7 9 3 1**

BUENOS AIRES, 23 NOV 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-14119-11-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones CHEMA IMPLANTES S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.


Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

5, Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

**DISPOSICIÓN Nº 7931**

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca COVISION, nombre descriptivo SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN DE CADERA y nombre técnico PRÓTESIS, DE ARTICULACIÓN, PARA CADERA, de acuerdo a lo solicitado por CHEMA IMPLANTES S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 17 a 18 y 22 a 26 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2000-1, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. A. T.*

**DISPOSICIÓN N° 7 9 3 1**

presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-14119-11-4

DISPOSICIÓN N° **7 9 3 1**

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **7931**.....

Nombre descriptivo: SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN DE CADERA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 – PRÓTESIS, DE ARTICULACIÓN, PARA CADERA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COVISION.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Las indicaciones de uso de la artroplastía total y parcial de cadera incluyen:

- 1) Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria incluyendo osteoartritis y necrosis avascular.
- 2) Artritis reumatoide.
- 3) Corrección de deformidades funcionales.
- 4) Procedimientos de revisión donde otros tratamientos o prótesis han fracasado; y
- 5) tratamiento de falta de unión, fracturas del cuello femoral y fracturas trocantéricas del fémur proximal con inclusión de la cabeza, que no pueden resolverse por medio de otras técnicas.

Modelo/s: IMPLANTES

TALLOS CEMENTADOS

TROY PULIDO

- |         |  |
|---------|--|
| 02.9001 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 8  |
| 02.9002 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 9  |
| 02.9003 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 10 |
| 02.9004 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 11 |
| 02.9005 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 12 |
| 02.9006 | TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 13 |



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S. S. S. S.*

**7931**

..//

02.9007 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 14  
TALLO CON COLLAR TROY

02.9058 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 8

02.9059 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 9

02.9060 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 10

02.9061 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 11

02.9062 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 12

02.9063 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 13

02.9064 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 14

TALLOS RECTOS (ACERO INOXIDABLE)

02.0007 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 7.50 MM

02.0010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 10.0 MM

02.0011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 11.25 MM

02.0012 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 12.50 MM

02.0013 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 13.75 MM

02.0015 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 15.0 MM

TALLO RECTOS (CR.CO.)

02.9008 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 7.5 MM

02.9009 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 10 MM

02.9010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 11.25 MM

02.9011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 12.5 MM

02.9012 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 13.75 MM

02.9013 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 15 MM

TALLO FEMORAL CRP (CR.CO)

02.5001 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM

02.5002 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM

02.5003 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM

02.5004 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM

02.5005 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM

02.5006 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM

51



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. S. M. S. T.*

**7931**

..//

- 02.5007 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM
- 02.5008 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM
- 02.5009 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM
- 02.5010 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM
- 02.5011 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM
- 02.5012 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM
- TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CoCr)
- 02.5040 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM
- 02.5041 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM
- 02.5042 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM
- 02.5043 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM
- 02.5044 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM
- 02.5045 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM
- 02.5046 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM
- 02.5047 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM
- 02.5048 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM
- 02.5049 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM
- 02.5050 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM

5



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

02.5051 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR  
45MM

TAPON ENDOMEDULAR

02.1001 TAPON ENDOMEDULAR 10MM

02.1002 TAPON ENDOMEDULAR 11MM

02.1003 TAPON ENDOMEDULAR 12MM

02.1004 TAPON ENDOMEDULAR 13MM

02.1005 TAPON ENDOMEDULAR 14MM

02.1006 TAPON ENDOMEDULAR 15MM

02.1071 TAPON ENDOMEDULAR 10MM

CENTRALIZADOR DISTAL CRP

02.7110 CENTRALIZADOR DISTAL CRP PEQUEÑO (10MM / 12MM)

02.7114 CENTRALIZADO DISTAL CRP GRANDE (14MM / 16MM)

CENTRALIZADOR DISTAL

02.7101 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 8MM

02.7102 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 9MM

02.7103 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 10MM

02.7104 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 11MM

5, 02.7105 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 12MM

02.7106 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 13MM

02.7107 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 14MM

TALLOS NO CEMENTADOS

TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT

02.1007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 7MM

02.1008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 8MM

02.1009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 9MM

02.1010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 10MM

02.1011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 11MM

02.1012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 12MM

02.1013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 13MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

**7931**

..//

- 02.1014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 14MM
- 02.1015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 15MM
- 02.1016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 16MM
- TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA
- 02.2007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 7MM
- 02.2008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 8MM
- 02.2009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 9MM
- 02.2010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 10MM
- 02.2011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 11MM
- 02.2012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 12MM
- 02.2013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 13MM
- 02.2014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 14MM
- 02.2015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 15MM
- 02.2016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 16MM
- TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS
- 02.7007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 7MM
- 02.7008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 8MM

5,





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

**7 9 3 11**

..//

02.7009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 9MM

02.7010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 10MM

02.7011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 11MM

02.7012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 12MM

02.7013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 13MM

02.7014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 14MM

02.7015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 15MM

02.7016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 16MM

TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS

02.4007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
7MM

02.4008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
8MM

02.4009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
9MM

02.4010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
10MM

02.4011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
11MM

02.4012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
12MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

**7931**

..11

02.4013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
13MM

02.4014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
14MM

02.4015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
15MM

02.4016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
16MM

TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS

02.4109 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 0- 9MM

02.4110 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 1-1.5MM

02.4111 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 2-12MM

02.4112 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 2.5-12.7MM

02.4113 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 3-13.5MM

02.4114 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 3.5-14.2MM

02.4115 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 4-15MM

02.4116 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 5-16.5MM-

02.4117 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 6-18MM

PROTESIS BIPOLAR

COTILO BIPOLAR (AC. INOX.)

02.8638 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 38MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

**7931**

02.8640 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 40MM  
02.8642 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 42MM  
02.8644 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 44MM  
02.8646 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 46MM  
02.8648 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 48MM  
02.8650 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 50MM  
02.8652 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 52MM  
02.8654 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 54MM  
02.8656 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 56MM  
02.8658 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 58MM

COTILO BIPOLAR (CR.CO)

02.8738 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 38MM  
02.8740 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 40MM  
02.8742 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 42MM  
02.8744 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 44MM  
02.8746 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 46MM  
02.8748 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 48MM  
02.8750 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 50MM  
02.8752 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 52MM  
02.8754 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 54MM  
02.8756 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 56MM  
02.8758 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 58MM

INSERTO BIPOLAR

02.8838 INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM  
02.8840 INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM  
02.8842 INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM  
02.8844 INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM  
02.8846 INSERTO BIPOLAR DIAM. 46MM  
02.8848 INSERTO BIPOLAR DIAM. 48MM  
02.8850 INSERTO BIPOLAR DIAM. 50MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

- 02.8852 INSERTO BIPOLAR DIAM. 52MM
- 02.8854 INSERTO BIPOLAR DIAM. 54MM
- 02.8856 INSERTO BIPOLAR DIAM. 56MM
- 02.8858 INSERTO BIPOLAR DIAM. 58MM
- COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) con inserto
- 02.8138 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 38MM
- 02.8140 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 40MM
- 02.8142 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 42MM
- 02.8144 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 44MM
- 02.8146 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 46MM
- 02.8148 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 48MM
- 02.8150 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 50MM
- 02.8152 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 52MM
- 02.8154 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 54MM
- 02.8156 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 56MM
- 02.8158 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 58MM
- COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO)
- 02.8438 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 38MM
- 02.8440 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 40MM
- 02.8442 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 42MM
- 02.8444 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 44MM
- 02.8446 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 46MM
- 02.8448 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 48MM
- 02.8450 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 50MM
- 02.8452 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 52MM
- 02.8454 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 54MM
- 02.8456 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 56MM
- 02.8458 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 58MM
- COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO
- COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 22MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. S. M. S. S.*

**7931**

..//

- 02.2242 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X42MM
- 02.2244 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X44MM
- 02.2246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X46MM
- 02.2248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X48MM
- 02.2250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X50MM
- 02.2252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X52MM
- 02.2254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X54MM
- 02.2256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X56MM
- 02.2258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X58MM
- 02.2260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X60MM
- COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 28MM
- 02.2842 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X42MM
- 02.2844 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X44MM
- 02.2846 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X46MM
- 02.2848 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X48MM
- 02.2850 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X50MM
- 02.2852 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X52MM
- 02.2854 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X54MM
- 02.2856 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X56MM
- 02.2858 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X58MM
- 02.2860 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X60MM
- COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 32MM
- 02.3246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X46MM
- 02.3248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X48MM
- 02.3250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X50MM
- 02.3252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X52MM
- 02.3254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X54MM
- 02.3256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X56MM
- 02.3258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X58MM
- 02.3260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X60MM

5



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.A.T.*

**7931**

..//

COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO

COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON PRESSFIT

02.6038 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
38MM

02.6040 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
40MM

02.6042 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
42MM

02.6044 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
44MM

02.6046 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
46MM

02.6048 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
48MM

02.6050 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
50MM

02.6052 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
52MM

5 02.6054 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
54MM

02.6056 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
56MM

02.6058 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
58MM

02.6060 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
60MM

02.6062 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
62MM

COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON COBERTURA HA



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.S.*

**7931**

..//

02.6238 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 38MM

02.6240 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 40MM

02.6242 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 42MM

02.6244 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 44MM

02.6246 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 46MM

02.6248 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 48MM

02.6250 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 50MM

02.6252 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 52MM

02.6254 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 54MM

02.6256 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 56MM

02.6258 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 58MM

02.6260 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 60MM

02.6262 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 62MM

COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA + HA

02.6442 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 42MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

02.6444 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 44MM

02.6446 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 46MM

02.6448 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 48MM

02.6450 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 50MM

02.6452 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 52MM

02.6454 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 54MM

02.6456 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 56MM

02.6458 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 58MM

02.6460 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 60MM

02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 62MM

COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA

02.6542 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 42MM

02.6544 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 44MM

02.6546 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 46MM

02.6548 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 48MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

02.6550	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 50MM					
02.6552	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 52MM					
02.6554	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 54MM					
02.6556	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 56MM					
02.6558	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 58MM					
02.6560	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 60MM					
02.6562	COMPONENTE	ACETABULAR	TITANIO	COBERTURA	PLASMA
DIAM. 62MM					
LINER ACETABULAR GRADO 0					
02.7142	LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X42MM				
02.7144	LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X44MM				
02.7046	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM				
02.7048	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X48MM				
02.7050	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X50MM				
02.7052	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM				
02.7054	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X54MM				
02.7056	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X56MM				
02.7058	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM				
02.7060	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X60MM				
02.7062	LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X62MM				
LINER ACETABULAR GRADO 10					
02.7342	LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM				
02.7344	LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X44MM				
02.7246	LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM				

5



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.M.S.T.*

93

..//

02.7248 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X48MM  
02.7250 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X50MM  
02.7252 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM  
02.7254 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X54MM  
02.7256 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X56MM  
02.7258 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM  
02.7260 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X60MM  
02.7262 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X62MM

LINER ACETABULAR GRADO 20

02.7642 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM  
02.7644 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X44MM  
02.7546 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM  
02.7548 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X48MM  
02.7550 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X50MM  
02.7552 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM  
02.7554 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X54MM  
02.7556 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X56MM  
02.7558 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM  
02.7560 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X60MM  
02.7562 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X62MM

LINER ACETABULAR GRADO 0

02.9404 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM  
(grupo 4.)  
02.9400 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)  
02.9401 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM -  
28X50MM (grupo 1.)  
02.9402 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM -  
28X56MM (grupo 2.)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

793

..//

02.9403 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR GRADO 10

02.9414 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)

02.9410 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)

02.9411 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9412 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)

02.9413 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR GRADO 20

02.9424 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)

02.9420 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)

02.9421 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9422 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)

02.9423 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0

02.9504 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)

02.9500 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulativas e Institucionales*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

02.9501 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM  
- 28X50MM (grupo 1.)

02.9502 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9503 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10

02.9514 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X38MM -  
22X40MM (grupo 4.)

02.9510 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9511 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X46MM -  
28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9512 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9513 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20

02.9524 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X38MM -  
22X40MM (grupo 4.)

02.9520 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9521 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X46MM -  
28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9522 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9523 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

TORNILLO ACETABULAR

02.9015 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X15MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

**7931**

..//

02.9020 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X20MM  
02.9025 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X25MM  
02.9030 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X30MM  
02.9035 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X35MM  
02.9040 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X40MM  
02.9045 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X45MM  
02.9050 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X50MM

CABEZAS

CABEZA DIAM. 22MM (AC.INOX)

02.8000 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 0MM  
02.8004 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 4MM  
02.8008 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 8MM

CABEZA DIAM. 28MM (AC.INOX)

02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM  
02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM  
02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM  
02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM  
02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM

5) CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)

02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM  
02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM  
02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM  
02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM  
02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM

CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)

02.8300 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 0MM  
02.8304 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 4MM  
02.8308 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 8MM

CABEZA DIAM. 28MM (CR.CO)

02.8400 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 0MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

**7931**

..//

- 02.8403 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM - 3MM
- 02.8404 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 4MM
- 02.8408 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 8MM
- 02.8412 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 12MM
- CABEZA DIAM. 32MM (CR.CO)
- 02.8500 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 0MM
- 02.8503 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM - 3MM
- 02.8504 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 4MM
- 02.8508 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 8MM
- 02.8512 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 12MM
- CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM
- 02.3000 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM -3MM
- 02.3004 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +0MM
- 02.3008 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +4MM
- CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM
- 02.3030 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM -3MM
- 02.3034 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +0MM
- 02.3038 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +4MM
- CABEZA UNIPOLAR SIN MANGA (AC. INOX)
- 03.9038 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 38MM
- 03.9039 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 39MM
- 03.9040 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 40MM
- 03.9041 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 41MM
- 03.9042 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 42MM
- 03.9043 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 43MM
- 03.9044 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 44MM
- 03.9045 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 45MM
- 03.9046 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 46MM
- 03.9047 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 47MM
- 03.9048 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 48MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

**7931**

..//

03.9049 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 49MM  
03.9050 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 50MM  
03.9051 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 51MM  
03.9052 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 52MM  
03.9053 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 53MM  
03.9054 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 54MM  
03.9055 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 55MM  
03.9056 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 56MM  
03.9057 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 57MM  
03.9058 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 58MM  
03.9059 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 59MM  
03.9060 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 60MM

CABEZA UNIPOLAR CON MANGA (AC.INOX)

02.8940 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 40MM  
02.8941 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 41MM  
02.8942 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 42MM  
02.8943 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 43MM  
02.8944 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 44MM  
02.8945 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 45MM  
02.8946 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 46MM  
02.8947 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 47MM  
02.8948 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 48MM  
02.8949 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 49MM  
02.8950 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 50MM  
02.8951 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 51MM  
02.8952 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 52MM  
02.8953 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 53MM  
02.8954 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 54MM  
02.8955 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 55MM  
02.8956 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 56MM

67



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

**7931**

..//

- 02.8957 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 57MM  
02.8958 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 58MM  
02.8959 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 59MM  
02.8960 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 60MM  
CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (Co.Cr.)  
03.1640 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 40MM  
03.1641 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 41MM  
03.1642 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 42MM  
03.1643 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 43MM  
03.1644 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 44MM  
03.1645 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 45MM  
03.1646 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 46MM  
03.1647 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 47MM  
03.1648 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 48MM  
03.1649 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 49MM  
03.1650 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 50MM  
03.1651 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 51MM  
03.1652 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 52MM  
03.1653 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 53MM  
03.1654 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 54MM  
03.1655 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 55MM  
03.1656 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 56MM  
03.1657 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 57MM  
03.1658 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 58MM  
03.1659 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 59MM  
03.1660 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 60MM  
MANGA UNIPOLAR (AC. INOX)  
02.8900 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) 0MM  
02.8903 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) -3MM  
02.8904 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +4MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

**7931**

..//

02.8908 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +8MM  
02.8912 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +12MM  
MANGA UNIPOLAR (TITANIO)  
03.1600 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 0MM  
03.1603 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) -3MM  
03.1604 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +4MM  
03.1608 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +8MM  
03.1612 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +12MM  
08.9001 SET INSTRUMENTAL PARA FEMUR TROY  
08.0550 CAJA INSTRUMENTOS PARA FEMUR TROY  
08.0540 ESCARIADOR TAMAÑO 7  
08.0541 ESCARIADOR TAMAÑO 8  
08.0542 ESCARIADOR TAMAÑO 9  
08.0543 ESCARIADOR TAMAÑO 10  
08.0544 ESCARIADOR TAMAÑO 11  
08.0545 ESCARIADOR TAMAÑO 12  
08.0546 ESCARIADOR TAMAÑO 13  
08.0547 ESCARIADOR TAMAÑO 14  
08.0548 ESCARIADOR TAMAÑO 15  
08.0549 ESCARIADOR TAMAÑO 16  
08.0502 MANIJA ESCARIADOR  
08.0564 CAJA OSTEOTOMO  
08.0501 BARRA TOMY PARA ESCOFINA  
08.5129 GUIA OSTEOTOMIA TROY  
08.0551 BANDEJA 1 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR  
08.0573 IMPACTOR DE CABEZA  
08.0504 EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL  
08.0565 IMPACTOR DE TALLO  
08.5122 EXTRACTOR DE TALLO  
08.5123 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +0 MM

✓



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*de N.M.S.J.*

**7931**

..//

- 08.5124 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +4 MM
- 08.5125 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +8 MM
- 08.0568 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 -3 MM
- 08.0569 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +0 MM
- 08.0570 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +4 MM
- 08.0571 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +8 MM
- 08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +12 MM
- 08.0552 BANDEJA 2 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR TROY
- 08.0427 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 7-8-9
- 08.0428 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 10-11-12
- 08.0429 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 13-14
- 08.0430 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 15-16
- 08.0431 MANIJA EN FORMA DE T DE RAPIDA LIBERACIÓN - LARGA
- 08.9051 SET INSTRUMENTAL BIPOLAR
- 08.0404 CAJA INSTRUMENTOS BIPOLAR
- 08.5133 LAPIZ DE EXTRACCIÓN
- 08.0534 HERRAMIENTA EXTRACCION DE MANGA
- 08.0598 MANGO DE CUBIERTA DE PRUEBA
- 08.0576 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 40 MM
- 08.0577 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 42 MM
- 08.0578 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 44 MM
- 08.0579 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 46 MM
- 08.0580 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 48 MM
- 08.0581 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 50 MM
- 08.0582 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 52 MM
- 08.0583 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 54 MM
- 08.0584 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 56 MM
- 08.0585 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 58 MM
- 08.0586 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 60 MM
- 08.0523 MANGA DE PRUEBA -3 MM

57



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

08.0524	MANGO DE PRUEBA 0 MM
08.0525	MANGO DE PRUEBA +4 MM
08.0526	MANGO DE PRUEBA +8 MM
08.0527	MANGO DE PRUEBA +12 MM
08.9002	SET INSTRUMENTOS ACETABULARES TROY
08.5126	CAJA DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
08.0301	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 42 MM
08.0302	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 44 MM
08.0303	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 46 MM
08.0304	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 48 MM
08.0305	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 50 MM
08.0306	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 52 MM
08.0307	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 54 MM
08.0308	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 56 MM
08.0309	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 58 MM
08.0310	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 60 MM
08.0311	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 62 MM
08.0454	FRESA ACETABULAR 38 MM
08.0455	FRESA ACETABULAR 40 MM
08.0433	FRESA ACETABULAR 42 MM
08.0434	FRESA ACETABULAR 44 MM
08.0435	FRESA ACETABULAR 46 MM
08.0436	FRESA ACETABULAR 48 MM
08.0437	FRESA ACETABULAR 50 MM
08.0438	FRESA ACETABULAR 52 MM
08.0439	FRESA ACETABULAR 54 MM
08.0440	FRESA ACETABULAR 56 MM
08.0441	FRESA ACETABULAR 58 MM
08.0442	FRESA ACETABULAR 60 MM
08.0443	FRESA ACETABULAR 62 MM

57





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. A. S. S. S. S.*

**7931**

..//

- 08.5108 EJE FRESA ACETABULAR
- 08.0598 MANIJA COTILO DE PRUEBA
- 08.5127 BANDEJA 1 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
- 08.5154 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 42-44 MM
- 08.5155 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 46-50 MM
- 08.5156 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 52-56 MM
- 08.5157 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 58-62 MM
- 08.0444 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 42-44 MM
- 08.0445 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 46-50 MM
- 08.0446 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 52-56 MM
- 08.0447 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 58-62 MM
- 08.0448 MANGO DE IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR
- 08.0449 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 22 MM
- 08.0450 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 22 MM
- 08.0451 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 28 MM
- 08.0452 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 28 MM
- 08.0195 IMPACTOR DE COTILO ACETABULAR
- 08.0196 CALIBRADOR DE POSICIONAMIENTO DE COTILO ACETABULAR
- 08.5128 BANDEJA 2 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
- 08.5116 PINZA CURVADA PARA TORNILLO
- 08.5118 DESTORNILLADOR RIGIDO
- 08.5117 DESTORNILLADOR UNIVERSAL
- 08.5119 EJE DE BROCA FLEXIBLE
- 08.5120 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM CORTA
- 08.5121 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM LARGA



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.S.T.*

**9931**

..//

- 08.5106 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA
- 08.5107 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA
- 08.5115 CALIBRADOR PROFUNDIDAD TORNILLO ACETABULAR
- 08.5109 GUIA BROCA TORNILLO ACETABULAR DIAMETRO 3.2 -  
DIAMETRO 4.0
- 08.0453 ATORNILLADOR PARA BLOQUEO DE FLEXIBLE
- 08.9022 SET DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.5250 CAJA DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.5268 MANGO TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA
- 08.5260 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 10 MM (TAMAÑO 8)
- 08.5261 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 11 MM (TAMAÑO 9)
- 08.5262 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 12 MM (TAMAÑO 10)
- 08.5263 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 13 MM (TAMAÑO 11)
- 08.5264 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 14 MM (TAMAÑO 12)
- 08.5265 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 15 MM (TAMAÑO 13)
- 08.5266 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 16 MM (TAMAÑO 14)
- 08.5267 INSERTADOR DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.9004 SET INSTRUMENTAL CRP
- 08.0320 CAJA CRP
- 08.0346 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 10
- 08.0347 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 12
- 08.0348 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 14
- 08.0349 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 16
- 08.0502 MANIJA ESCARIADOR
- 08.0501 PALANCA DE MANO PARA ESCOFINA (barra Tommy)
- 08.0353 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 SIMPLE
- 08.0354 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 DOBLE
- 08.0355 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 SIMPLE
- 08.0356 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 DOBLE
- 08.0357 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 SIMPLE



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**7931**

..//

- 08.0358 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 DOBLE
- 08.0359 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 SIMPLE
- 08.0360 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 DOBLE
- 08.0551 BANDEJA 1 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR
- 08.0573 IMPACTOR DE CABEZA
- 08.0565 IMPACTOR DE TALLO
- 08.5122 EXTRACTOR DE TALLO
- 08.0504 EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL
- 08.5123 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM
- 08.5124 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM
- 08.5125 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM
- 08.0568 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM -3 MM
- 08.0569 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +0 MM
- 08.0570 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +4 MM
- 08.0571 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +8 MM
- 08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +12 MM
- 08.9005 JUEGO FRESA RIGIDA
- 08.0351 CAJA FRESA RIGIDA
- 08.0322 FRESA RIGIDA TAMAÑO 8
- 08.0323 FRESA RIGIDA TAMAÑO 9
- 08.0324 FRESA RIGIDA TAMAÑO 10
- 5. 08.0325 FRESA RIGIDA TAMAÑO 11
- 08.0326 FRESA RIGIDA TAMAÑO 12
- 08.0327 FRESA RIGIDA TAMAÑO 13
- 08.0328 FRESA RIGIDA TAMAÑO 14
- 08.0329 FRESA RIGIDA TAMAÑO 15
- 08.0330 FRESA RIGIDA TAMAÑO 16
- 08.0331 FRESA RIGIDA TAMAÑO 17
- 08.0332 FRESA RIGIDA TAMAÑO 18
- 08.0431 MANIJA EN T DE LIBERACIÓN RAPIDA LARGA



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

..11

- 08.9052 JUEGO DE INSTRUMENTOS PARDUS
- 08.0840 CAJA DE INSTRUMENTOS PARDUS
- 08.0869 MANIJA ESCARIADOR PARDUS
- 08.0870 MANIJA ESCARIADOR PARDUS FINO
- 08.0891 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 0
- 08.0892 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 1
- 08.0893 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2
- 08.0894 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2.5
- 08.0895 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3
- 08.0896 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3.5
- 08.0897 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 4
- 08.0898 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 5
- 08.0899 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 6
- 08.0859 POSICIONADOR DE TALLO PARDUS
- 08.0843 BANDEJA DE INSTRUMENTOS GENERALES
- 08.0871 IMPACTOR CABEZA DE FEMORAL PARDUS
- 08.0881 IMPACTOR DE TALLO
- 08.0872 LIJADOR M DE CALCAR PARDUS
- 08.0874 LIJADOR S DE CALCAR PARDUS
- 08.0875 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
- 08.0876 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
- 08.0877 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6
- 08.0878 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
- 08.0879 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
- 08.0880 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6
- 08.5123 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM
- 08.5124 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM
- 08.5125 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM
- 08.0568 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.A.T.*

**7931**

..//

08.0569 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM  
08.0570 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM  
08.0571 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM  
08.0572 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM  
08.0841 CAJA DE FRESA PARDUS  
08.0850 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 0  
08.0851 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 1  
08.0852 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 2  
08.0853 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 2.5  
08.0854 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 3  
08.0855 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 3.5  
08.0856 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 4  
08.0857 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 5  
08.0858 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 6  
08.0861 MANIJA T  
08.0862 GUIA OSTEOTOMIA PARDUS  
08.0863 CAJA CINCEL  
08.0842 CAJA INSTRUMENTOS DE EXTRACCION  
08.0864 MARTILLO DESLIZANTE PARDUS  
08.0865 ANEXO EXTRACTOR ESCARIADOR  
08.0867 EXTRACTOR DE TALLO UNIVERSAL  
08.0868 GANCHO PARA EXTRACCION DE ESCARIADOR  
08.9007 SET DE INSTRUMENTOS PARA TALLO RECTO  
08.0400 CAJA DE INSTRUMENTOS PARA TALLO RECTO  
08.0504 EXTRACTOR CABEZA FEMORAL  
08.0565 IMPACTOR DE TALLO  
08.0566 MANGO EN T  
08.0567 LOCALIZADOR DE CANAL FEMORAL  
08.0573 IMPACTOR DE CABEZA  
08.5122 EXTRACTOR DE TALLO





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

..//

- 08.5123 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +0 MM
- 08.5124 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +4 MM
- 08.5125 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +8 MM
- 08.0568 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM
- 08.0569 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM
- 08.0570 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM
- 08.0571 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM
- 08.0572 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM
- 08.0401 BANDEJA DE INSTRUMENTOS DE TALLO RECTO 1
- 08.5148 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 7.5 MM
- 08.5149 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 10.0 MM
- 08.5150 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 11.25 MM
- 08.5151 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 12.5 MM
- 08.5152 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 13.75 MM
- 08.5153 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 15.0 MM
- 08.0502 MANGO DE ESCARIADOR
- 08.0501 RASPADOR BARRA TOMY

Período de vida útil: 3 años para Implantes estériles. Para el instrumental depende del adecuado tratamiento por parte del usuario. El tiempo de vida útil del dispositivo esta determinado por el desgaste y propiedades materiales.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ltd.

Lugar/es de elaboración: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido.

Expediente N° 1-47-14119-11-4

DISPOSICIÓN N°

**7931**

  
Dr. OTTO A. OBSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

**7931**.....

  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.

### ANEXO III.B

#### 2. ROTULOS - Implantes

##### Covision.

#### Sistema de Reemplazo de Articulación de Cadera.

2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde:

Fabricante: Covision Medical Technologies Ltd.  
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido.

Importador: Chema Implantes S.R.L.  
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6° B – C.A.B.A. - Argentina

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase:

El Sistema de Cadera está compuesto por:  
\_ Componente Acetabular y el Componente Femoral

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril":  
Estéril

2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda:  
Número de Lote:.....

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad:

Fecha de fabricación:.....  
Fecha de Vencimiento:.....

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso:  
Producto de un solo uso

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:  
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco alejado de otros productos cortopunzantes que contribuyan a la destrucción del envase y su consiguiente pérdida de la esterilidad. Evitar la exposición directa al sol.

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos:  
Destinado a proporcionar una mayor movilidad del paciente y reducir el dolor mediante la sustitución de la articulación dañada de la cadera.

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:  
No mezclar con productos de otros fabricantes.

2.10. Si corresponde, el método de esterilización:  
Radiación Gamma.

2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función:  
Dirección Técnica: Farmacéutico Daniel Carrio – M.N.: 12.269

2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente:

**AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM – 2000 - 1.**

Condición de Venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturo  
50618 Gerente

**Dr. Daniel L. Carrio**  
Farmacéutico  
M.N. 12269

## 2. ROTULOS - Instrumental

**Covision.****Sistema de Reemplazo de Articulación de Cadera.**

2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde:

Fabricante: Covision Medical Technologies Ltd.  
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido.

Importador: Chema Implantes S.R.L.  
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6° B – C.A.B.A. - Argentina

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase:

El Sistema de Cadera está compuesto por:  
\_ Instrumental necesario para la colocación de los implantes.

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril":

No estéril

2.4. El código del lote precedido por la palabra "lote" o el número de serie según proceda:

Número de Lote:.....

2.5. Si corresponde, fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad:

Fecha de fabricación:.....

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso:

Producto reutilizable  
Esterilizar por Vapor de Agua (ver instrucciones de uso)

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar la exposición directa al sol.

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos:

Los instrumentos de COVISION siempre son componentes de un sistema. Sólo se puede combinar con piezas originales que pertenecen al mismo sistema

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:

Con el uso de fresas, taladros y otros instrumentos de corte se puede generar calor por fricción lo que puede conducir a daño celular.

2.10. Si corresponde, el método de esterilización:

No corresponde.

2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función:

Dirección Técnica: Farmacéutico Daniel Carrio – M.N.: 12.269

2.12. Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente:

**AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 2000 - 1.**

Condición de Venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

  
**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturo  
Socio Gerente

  
**Dr. Daniel L. Carrio**  
Farmacéutico  
M.N. 12269

**Anexo III.B****Covision.****Sistema de Reemplazo de Articulación de Cadera.****Proyecto de Instrucciones de uso**

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítems 2.4 y 2.5:

2.1. La razón social y dirección del fabricante y del importador, si corresponde:

Fabricante: Covision Medical Technologies Ltd.  
Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido.

Importador: Chema Implantes S.R.L.  
Dirección completa: Av. Corrientes 2835, Cuerpo B, 6° B – C.A.B.A. - Argentina

2.2. La información estrictamente necesaria para que el usuario pueda identificar el producto médico y el contenido del envase:

El Sistema de Cadera está compuesto por:  
\_ Componente Acetabular y el Componente Femoral  
\_ Instrumental necesario para la colocación de los implantes.

2.3. Si corresponde, la palabra "estéril":

Implantes: Estéril  
Instrumental: No Estéril

2.6. La indicación, si corresponde que el producto médico, es de un solo uso:

Implantes: un solo uso  
Instrumental: producto médico reutilizable; Esterilizar por Vapor de Agua (ver instrucciones de uso)

2.7. Las condiciones específicas de almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto:

Implante: Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco alejado de otros productos cortopunzantes que contribuyan a la destrucción del envase y su consiguiente pérdida de la esterilidad. Evitar la exposición directa al sol  
Instrumental: Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco resguardado de la luz sola directa.

2.8. Las instrucciones especiales para operación y/o uso de productos médicos:

Implante: Destinado a proporcionar una mayor movilidad del paciente y reducir el dolor mediante la sustitución de la articulación dañada de la cadera.  
Instrumental: Los instrumentos de COVISION siempre son componentes de un sistema. Sólo se puede combinar con piezas originales que pertenecen al mismo sistema

2.9. Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse:


Implante: No mezclar con productos de otros fabricantes.  
Instrumental: Con el uso de fresas, taladros y otros instrumentos de corte se puede generar calor por fricción lo que puede conducir a daño celular.


2.10. Si corresponde, el método de esterilización:

Implantes: Radiación Gamma  
Instrumental: No estéril

2.11. Nombre del responsable técnico legalmente habilitado para la función:

Dirección Técnica: Daniel Carrio – M.N.: 12.269

  
**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturo  
Socia Gerente

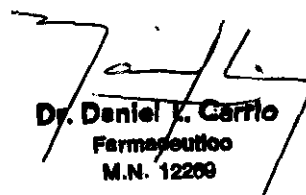  
**Dr. Daniel J. Carrio**  
Farmacéutico  
M.N. 12269

Chema Implants S.R.L.

Sistema de reemplazo de Articulación de Cadera

PM-2000-7

793



2.12. *Número de Registro del Producto Médico precedido de la sigla de identificación de la Autoridad Sanitaria competente:*

**AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T - PM - 2000 - 1.**

Condición de Venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturo  
Socia Gerente

**Dr. Daniel L. Carrio**  
Farmacéutico  
M.N. 12289

**INDICACIONES**

Las indicaciones de uso de la artroplastia total y parcial de cadera incluyen:

1. Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria incluyendo osteoartritis y necrosis avascular;
2. Artritis reumatoide;
3. Corrección de deformidades funcionales;
4. procedimientos de revisión donde otros tratamientos o prótesis han fracasado; y
5. tratamiento de falta de unión, fracturas del cuello femoral y fracturas trocantéricas del fémur proximal con inclusión de la cabeza, que no pueden resolverse por medio de otras técnicas.

**FORMAS DE USO:**

Resección del cuello femoral  
Apertura del trocanter femoral  
Preparación del canal medular femoral  
Raspado del trocanter femoral.  
Selección del tamaño apropiado del tallo femoral  
Exposición y preparación acetabular.  
Prueba de acetábulo.  
Selección de la copa cementada  
Prueba de copa.  
Introducción del cemento óseo en el interior del acetábulo (depende de la técnica seleccionada por el cirujano).  
Introducción de la copa en el interior del acetábulo.  
Alineado de la copa acetabular.  
Impactado de la copa acetabular.  
Prueba inicial de reducción (opcional).  
Si es requerido, el cirujano remueve el cuello femoral.  
Colocación del inserto óseo distal .  
Colocación del cemento óseo (depende de la técnica seleccionada por el cirujano).  
Implantación del tallo femoral.  
Implantación de la cabeza modular femoral.  
Reducción final de la cadera.  
Movilización post-operatoria.

**INSTRUMENTAL:**

Esterilización Recomendada:

Ciclo de Vacío previo: 4 pulsos (máxima y mínima de 2,8 bares de 339 milibares con un tiempo de permanencia mínimo de 4 minutos a 132 °C a 135 °C), seguido de 1 minuto de purga y al menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares mínimo

Ciclo: 132 °C a 135°C con un tiempo de permanencia mínimo de 15 minutos, seguido de 1 minuto de purga de al menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares mínimo

COVISION no recomienda el uso de los ciclos de baja gravedad o temperatura de esterilización.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**


El paciente debe ser advertido del riesgo quirúrgico, y conciente de los posibles efectos adversos.

El paciente debe ser advertido de que el dispositivo no sustituye el hueso sano normal, que el implante puede romperse o dañarse a consecuencia de la actividad vigorosa o trauma, y que tiene una vida finita.

Los posibles efectos biológicos a largo plazo de desechos de metal al desgaste y la producción de iones de metal no se conocen.

Preguntas sobre carcinogenicidad se han planteado en la literatura, no hay estudios que evidencia concluyente de que los iones de desechos de metal o de desgaste de metal son cancerígenos.

No mezclar componentes de diferentes fabricantes.

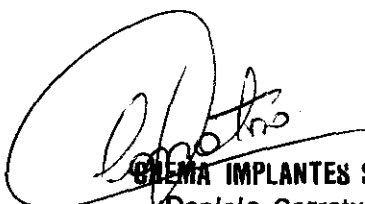  
**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturro  
Socio Gerente

  
**Dr. Daniel L. Carrlo**  
Farmacéutico  
M.N. 12289

**CONTRAINDICACIONES:**

Pacientes con cantidad o calidad ósea insuficiente, por ejemplo, pacientes con osteoporosis o trastornos metabólicos que pueden afectar la formación ósea.

Trastornos mentales o neurológicos que tienden a afectar la capacidad del paciente o la voluntad de restringir las actividades.

*3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;*

MACOPRESS Smart se utiliza con bolsas desechables conformes con el estándar internacional ISO 3826 y la Normativa 93/42MDD.

*3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.*

*En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos:*

MACOPRESS Smart no se utiliza estéril.

Operaciones de mantenimiento diarias

Sacar todas las bolsas y limpiar el panel frontal y la prensa con un paño suave y limpio, humedecido con un detergente o desinfectante, teniendo cuidado de no derramar el líquido en su interior y de no rayar la ventana transparente de los sensores ópticos.

Antes de encender de nuevo la máquina, secar bien todas las partes con un paño seco.

**NUNCA se deben emplear materiales abrasivos, acetona, tricloroetileno u otros solventes.**

**Recordar que el cloro también oxida el acero, por lo tanto, utilizarlo lo menos posible y enjuagar siempre con un paño humedecido con agua limpia o mejor aún, destilada.**

*3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico:*


Las ANOMALÍAS informan al operador que se ha detectado un posible fallo y que la máquina no está en condiciones de re realizar al Servicio de Asistencia.

*3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;*


**ADVERTENCIAS SOBRE LAS EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS**

Guía y declaraciones del fabricante – Emisiones Electromagnéticas

El fraccionador automático MACOPRESS Smart puede ser utilizado en los ambientes electromagnéticos especificados a continuación. El cliente o usuario del fraccionador MACOPRESS Smart debe asegurarse que el aparato sea utilizado en dicho ambiente.

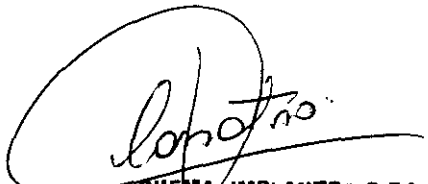

**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
**Daniela Carraturo**  
**Subid Gerente**

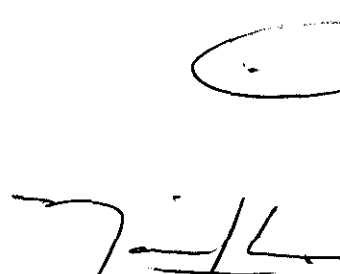

**Dr. Daniel L. Carrlo**  
**Farmacéutico**  
**M.N. 12209**



3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación:

**RIESGOS AMBIENTALES Y ELIMINACIÓN**

MACOPRESS Smart contiene materiales que al culminar el ciclo de vida del aparato deben ser eliminados en los centros de recuperación designados por los entes sanitarios locales, o en todo caso, según lo prescrito por las leyes vigentes.

En especial, el aparato contiene los siguientes materiales:

Hierro

Cobre

Aluminio

Materiales plásticos no biodegradables

Fibra de vidrio para circuitos impresos

Ferrita

Baterías de litio

MacoPharma no se hace cargo de la eliminación del aparato al culminar su propio ciclo de vida, así como tampoco puede asumir ningún gasto por la eliminación de la máquina.

Conforme a la Directiva UE 2002/96/EC para equipos eléctricos y electrónicos inútiles, este producto eléctrico no se debe desechar como basura municipal sin clasificar. Disponga por favor de este producto devolviéndolo al punto de venta o a su punto municipal local para su reciclaje.



**CHEMA IMPLANTES S.R.L.**  
Daniela Carraturo  
Gerente



**Dr. Daniel L. Gerlo**  
Farmacéutico  
M.N. 12269



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

ANEXO III  
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-14119-11-4

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **7.931**, y de acuerdo a lo solicitado por CHEMA IMPLANTES S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACIÓN DE CADERA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 – PRÓTESIS, DE ARTICULACIÓN, PARA CADERA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): COVISION.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Las indicaciones de uso de la artroplastía total y parcial de cadera incluyen:

- 1) Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria incluyendo osteoartritis y necrosis avascular.
- 2) Artritis reumatoide.
- 3) Corrección de deformidades funcionales.
- 4) Procedimientos de revisión donde otros tratamientos o prótesis han fracasado; y
- 5) tratamiento de falta de unión, fracturas del cuello femoral y fracturas trocántericas del fémur proximal con inclusión de la cabeza, que no pueden resolverse por medio de otras técnicas.

Modelo/s: IMPLANTES

TALLOS CEMENTADOS

TROY PULIDO

02.9001 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 8

02.9002 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 9

02.9003 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 10

..//

- 02.9004 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 11
- 02.9005 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 12
- 02.9006 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 13
- 02.9007 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 14

TALLO CON COLLAR TROY

- 02.9058 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 8
- 02.9059 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 9
- 02.9060 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 10
- 02.9061 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 11
- 02.9062 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 12
- 02.9063 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 13
- 02.9064 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 14

TALLOS RECTOS (ACERO INOXIDABLE)

- 02.0007 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 7.50 MM
- 02.0010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 10.0 MM
- 02.0011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 11.25 MM
- 02.0012 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 12.50 MM
- 02.0013 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 13.75 MM
- 02.0015 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 15.0 MM

TALLO RECTOS (CR.CO.)

- 02.9008 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 7.5 MM
- 02.9009 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 10 MM
- 02.9010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 11.25 MM
- 02.9011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 12.5 MM
- 02.9012 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 13.75 MM
- 02.9013 PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 15 MM

TALLO FEMORAL CRP (CR.CO)

- 02.5001 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM
- 02.5002 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM
- 02.5003 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM
- 02.5004 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

- 02.5005 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM
- 02.5006 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM
- 02.5007 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM
- 02.5008 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM
- 02.5009 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM
- 02.5010 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM
- 02.5011 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM
- 02.5012 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM
- TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CoCr)
- 02.5040 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM
- 02.5041 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM
- 02.5042 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM
- 02.5043 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM
- 02.5044 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM
- 02.5045 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM
- 02.5046 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM
- 02.5047 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM
- 02.5048 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM
- 02.5049 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM
- 02.5050 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM

..//

02.5051 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR  
45MM

TAPON ENDOMEDULAR

02.1001 TAPON ENDOMEDULAR 10MM

02.1002 TAPON ENDOMEDULAR 11MM

02.1003 TAPON ENDOMEDULAR 12MM

02.1004 TAPON ENDOMEDULAR 13MM

02.1005 TAPON ENDOMEDULAR 14MM

02.1006 TAPON ENDOMEDULAR 15MM

02.1071 TAPON ENDOMEDULAR 10MM

CENTRALIZADOR DISTAL CRP

02.7110 CENTRALIZADOR DISTAL CRP PEQUEÑO (10MM / 12MM)

02.7114 CENTRALIZADOR DISTAL CRP GRANDE (14MM / 16MM)

CENTRALIZADOR DISTAL

02.7101 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 8MM

02.7102 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 9MM

02.7103 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 10MM

02.7104 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 11MM

02.7105 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 12MM

02.7106 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 13MM

02.7107 CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 14MM

TALLOS NO CEMENTADOS

TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT

02.1007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 7MM

02.1008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 8MM

02.1009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 9MM

02.1010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 10MM

02.1011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 11MM

02.1012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 12MM

02.1013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 13MM

02.1014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 14MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. I.*

..//

- 02.1015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 15MM
- 02.1016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON PRESSFIT 16MM
- TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA
- 02.2007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 7MM
- 02.2008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 8MM
- 02.2009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 9MM
- 02.2010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 10MM
- 02.2011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 11MM
- 02.2012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 12MM
- 02.2013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 13MM
- 02.2014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 14MM
- 02.2015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 15MM
- 02.2016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 16MM
- TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS
- 02.7007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 7MM
- 02.7008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 8MM
- 02.7009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 9MM

..//

02.7010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 10MM

02.7011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 11MM

02.7012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 12MM

02.7013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 13MM

02.7014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 14MM

02.7015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 15MM

02.7016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS  
TAMAÑO 16MM

TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS

02.4007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
7MM

02.4008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
8MM

02.4009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
9MM


02.4010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
10MM

02.4011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
11MM

02.4012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
12MM

02.4013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
13MM

02.4014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
14MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

..//

02.4015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
15MM

02.4016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS  
16MM

TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS

02.4109 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 0- 9MM

02.4110 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 1-1.5MM

02.4111 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 2-12MM

02.4112 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 2.5-12.7MM

02.4113 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 3-13.5MM

02.4114 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 3.5-14.2MM

02.4115 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 4-15MM

02.4116 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 5-16.5MM-

02.4117 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA +  
POROUS TALLA 6-18MM

PROTESIS BIPOLAR

COTILO BIPOLAR (AC. INOX.)

02.8638 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 38MM

02.8640 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 40MM

02.8642 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 42MM

02.8644 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 44MM

02.8646 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 46MM

02.8648 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 48MM



..//

02.8650 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 50MM

02.8652 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 52MM

02.8654 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 54MM

02.8656 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 56MM

02.8658 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 58MM

COTILO BIPOLAR (CR.CO)

02.8738 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 38MM

02.8740 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 40MM

02.8742 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 42MM

02.8744 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 44MM

02.8746 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 46MM

02.8748 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 48MM

02.8750 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 50MM

02.8752 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 52MM

02.8754 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 54MM

02.8756 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 56MM

02.8758 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 58MM

INSERTO BIPOLAR

02.8838 INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM

02.8840 INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM

0 02.8842 INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM

02.8844 INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM

02.8846 INSERTO BIPOLAR DIAM. 46MM

02.8848 INSERTO BIPOLAR DIAM. 48MM

02.8850 INSERTO BIPOLAR DIAM. 50MM

02.8852 INSERTO BIPOLAR DIAM. 52MM

02.8854 INSERTO BIPOLAR DIAM. 54MM

02.8856 INSERTO BIPOLAR DIAM. 56MM

02.8858 INSERTO BIPOLAR DIAM. 58MM

COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) con inserto

02.8138 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 38MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S. S.A.S. S.A.S.*

..//

02.8140 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 40MM  
02.8142 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 42MM  
02.8144 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 44MM  
02.8146 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 46MM  
02.8148 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 48MM  
02.8150 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.) DIAM. 50MM  
02.8152 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 52MM  
02.8154 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 54MM  
02.8156 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 56MM  
02.8158 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 58MM

COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO)

02.8438 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 38MM  
02.8440 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 40MM  
02.8442 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 42MM  
02.8444 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 44MM  
02.8446 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 46MM  
02.8448 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 48MM  
02.8450 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 50MM  
02.8452 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 52MM  
02.8454 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 54MM  
02.8456 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 56MM  
02.8458 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 58MM

COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO

COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 22MM

02.2242 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X42MM  
02.2244 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X44MM  
02.2246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X46MM  
02.2248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X48MM  
02.2250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X50MM  
02.2252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X52MM  
02.2254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X54MM

..//

02.2256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X56MM

02.2258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X58MM

02.2260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X60MM

COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 28MM

02.2842 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X42MM

02.2844 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X44MM

02.2846 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X46MM

02.2848 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X48MM

02.2850 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X50MM

02.2852 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X52MM

02.2854 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X54MM

02.2856 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X56MM

02.2858 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X58MM

02.2860 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X60MM

COMPONENTE ACETABULAR DIAM. 32MM

02.3246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X46MM

02.3248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X48MM

02.3250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X50MM

02.3252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X52MM

02.3254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X54MM

02.3256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X56MM

02.3258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X58MM

02.3260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X60MM

COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO

COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON PRESSFIT

02.6038 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
38MM

02.6040 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
40MM

02.6042 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM.  
42MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

..//

- 02.6044 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 44MM
- 02.6046 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 46MM
- 02.6048 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 48MM
- 02.6050 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 50MM
- 02.6052 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 52MM
- 02.6054 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 54MM
- 02.6056 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 56MM
- 02.6058 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 58MM
- 02.6060 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 60MM
- 02.6062 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 62MM
- COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO CON COBERTURA HA
- 02.6238 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 38MM
- 02.6240 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 40MM
- 02.6242 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 42MM
- 02.6244 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 44MM
- 02.6246 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 46MM

..//

02.6248 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 48MM

02.6250 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 50MM

02.6252 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 52MM

02.6254 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 54MM

02.6256 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 56MM

02.6258 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 58MM

02.6260 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 60MM

02.6262 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA  
DIAM. 62MM

COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA + HA

02.6442 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 42MM

02.6444 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 44MM

02.6446 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 46MM

02.6448 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 48MM

02.6450 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 50MM

02.6452 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 52MM

02.6454 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 54MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. S. M. S. T.*

..//

02.6456 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 56MM

02.6458 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 58MM

02.6460 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 60MM

02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA  
DIAM. 62MM

COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA

02.6542 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 42MM

02.6544 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 44MM

02.6546 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 46MM

02.6548 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 48MM

02.6550 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 50MM

41 02.6552 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 52MM

02.6554 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 54MM

02.6556 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 56MM

02.6558 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 58MM

02.6560 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 60MM

02.6562 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA  
DIAM. 62MM

..//


LINER ACETABULAR GRADO 0

- 02.7142 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X42MM
- 02.7144 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X44MM
- 02.7046 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM
- 02.7048 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X48MM
- 02.7050 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X50MM
- 02.7052 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM
- 02.7054 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X54MM
- 02.7056 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X56MM
- 02.7058 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM
- 02.7060 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X60MM
- 02.7062 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X62MM

LINER ACETABULAR GRADO 10

- 02.7342 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM
- 02.7344 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X44MM
- 02.7246 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM
- 02.7248 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X48MM
- 02.7250 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X50MM
- 02.7252 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM
- 02.7254 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X54MM
- 02.7256 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X56MM
- 02.7258 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM
- 02.7260 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X60MM
- 02.7262 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X62MM

LINER ACETABULAR GRADO 20

- 02.7642 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM
  - 02.7644 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X44MM
  - 02.7546 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM
  - 02.7548 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X48MM
  - 02.7550 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X50MM
  - 02.7552 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM
- 



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

..//

- 02.7554 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X54MM  
02.7556 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X56MM  
02.7558 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM  
02.7560 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X60MM  
02.7562 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X62MM  
LINER ACETABULAR GRADO 0  
02.9404 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM  
(grupo 4.)  
02.9400 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)  
02.9401 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM -  
28X50MM (grupo 1.)  
02.9402 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM -  
28X56MM (grupo 2.)  
02.9403 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM -  
28X62MM (grupo 3.)  
LINER ACETABULAR GRADO 10  
02.9414 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM  
(grupo 4.)  
02.9410 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)  
02.9411 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM -  
28X50MM (grupo 1.)  
02.9412 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM -  
28X56MM (grupo 2.)  
02.9413 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM -  
28X62MM (grupo 3.)  
LINER ACETABULAR GRADO 20  
02.9424 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM  
(grupo 4.)



..//

02.9420 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9421 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM -  
28X50MM (grupo 1.)

02.9422 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM -  
28X56MM (grupo 2.)

02.9423 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM -  
28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0

02.9504 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM  
(grupo 4.)

02.9500 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9501 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM  
- 28X50MM (grupo 1.)

02.9502 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9503 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10

02.9514 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X38MM -  
22X40MM (grupo 4.)

02.9510 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9511 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X46MM -  
28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9512 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9513 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. S. J.*

..//

02.9524 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X38MM -  
22X40MM (grupo 4.)

02.9520 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM  
(grupo 0.)

02.9521 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X46MM -  
28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)

02.9522 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM  
- 28X56MM (grupo 2.)

02.9523 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM  
- 28X62MM (grupo 3.)

TORNILLO ACETABULAR

02.9015 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X15MM

02.9020 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X20MM

02.9025 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X25MM

02.9030 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X30MM

02.9035 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X35MM

02.9040 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X40MM

02.9045 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X45MM

02.9050 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X50MM

CABEZAS

CABEZA DIAM. 22MM (AC.INOX)

02.8000 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 0MM

02.8004 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 4MM

02.8008 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 8MM

CABEZA DIAM. 28MM (AC.INOX)

02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM

02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM

02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM

02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM

02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM

CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)

..//

02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM  
02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM  
02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM  
02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM  
02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM  
CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)  
02.8300 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 0MM  
02.8304 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 4MM  
02.8308 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 8MM  
CABEZA DIAM. 28MM (CR.CO)  
02.8400 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 0MM  
02.8403 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM - 3MM  
02.8404 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 4MM  
02.8408 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 8MM  
02.8412 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 12MM  
CABEZA DIAM. 32MM (CR.CO)  
02.8500 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 0MM  
02.8503 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM - 3MM  
02.8504 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 4MM  
02.8508 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 8MM  
02.8512 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 12MM  
CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM  
02.3000 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM -3MM  
02.3004 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +0MM  
02.3008 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +4MM  
CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM  
02.3030 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM -3MM  
02.3034 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +0MM  
02.3038 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +4MM  
CABEZA UNIPOLAR SIN MANGA (AC. INOX)  
03.9038 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 38MM






*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*


..//

03.9039	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 39MM
03.9040	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 40MM
03.9041	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 41MM
03.9042	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 42MM
03.9043	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 43MM
03.9044	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 44MM
03.9045	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 45MM
03.9046	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 46MM
03.9047	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 47MM
03.9048	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 48MM
03.9049	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 49MM
03.9050	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 50MM
03.9051	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 51MM
03.9052	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 52MM
03.9053	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 53MM
03.9054	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 54MM
03.9055	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 55MM
03.9056	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 56MM
03.9057	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 57MM
03.9058	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 58MM
03.9059	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 59MM
03.9060	CABEZA UNIPOLAR DIAM. 60MM
	CABEZA UNIPOLAR CON MANGA (AC.INOX)
02.8940	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 40MM
02.8941	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 41MM
02.8942	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 42MM
02.8943	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 43MM
02.8944	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 44MM
02.8945	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 45MM
02.8946	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 46MM
02.8947	CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 47MM



..//

02.8948 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 48MM  
02.8949 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 49MM  
02.8950 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 50MM  
02.8951 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 51MM  
02.8952 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 52MM  
02.8953 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 53MM  
02.8954 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 54MM  
02.8955 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 55MM  
02.8956 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 56MM  
02.8957 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 57MM  
02.8958 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 58MM  
02.8959 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 59MM  
02.8960 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 60MM  
CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (Co.Cr.)  
03.1640 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 40MM  
03.1641 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 41MM  
03.1642 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 42MM  
03.1643 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 43MM  
03.1644 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 44MM  
03.1645 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 45MM  
03.1646 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 46MM  
03.1647 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 47MM  
03.1648 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 48MM  
03.1649 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 49MM  
03.1650 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 50MM  
03.1651 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 51MM  
03.1652 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 52MM  
03.1653 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 53MM  
03.1654 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 54MM  
03.1655 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 55MM  
03.1656 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 56MM





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S.A.S.M.S.T.*

..//

- 03.1657 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 57MM
- 03.1658 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 58MM
- 03.1659 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 59MM
- 03.1660 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 60MM
- MANGA UNIPOLAR (AC. INOX)
- 02.8900 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) 0MM
- 02.8903 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) -3MM
- 02.8904 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +4MM
- 02.8908 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +8MM
- 02.8912 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +12MM
- MANGA UNIPOLAR (TITANIO)
- 03.1600 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 0MM
- 03.1603 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) -3MM
- 03.1604 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +4MM
- 03.1608 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +8MM
- 03.1612 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +12MM
- 08.9001 SET INSTRUMENTAL PARA FEMUR TROY
- 08.0550 CAJA INSTRUMENTOS PARA FEMUR TROY
- 08.0540 ESCARIADOR TAMAÑO 7
- 08.0541 ESCARIADOR TAMAÑO 8
- 08.0542 ESCARIADOR TAMAÑO 9
- 08.0543 ESCARIADOR TAMAÑO 10
- 08.0544 ESCARIADOR TAMAÑO 11
- 08.0545 ESCARIADOR TAMAÑO 12
- 08.0546 ESCARIADOR TAMAÑO 13
- 08.0547 ESCARIADOR TAMAÑO 14
- 08.0548 ESCARIADOR TAMAÑO 15
- 08.0549 ESCARIADOR TAMAÑO 16
- 08.0502 MANIJA ESCARIADOR
- 08.0564 CAJA OSTEOTOMO
- 08.0501 BARRA TOMY PARA ESCOFINA

5

..//

08.5129 GUIA OSTEOTOMIA TROY  
08.0551 BANDEJA 1 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR  
08.0573 IMPACTOR DE CABEZA  
08.0504 EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL  
08.0565 IMPACTOR DE TALLO  
08.5122 EXTRACTOR DE TALLO  
08.5123 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +0 MM  
08.5124 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +4 MM  
08.5125 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +8 MM  
08.0568 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 -3 MM  
08.0569 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +0 MM  
08.0570 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +4 MM  
08.0571 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +8 MM  
08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +12 MM  
08.0552 BANDEJA 2 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR TROY  
08.0427 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 7-8-9  
08.0428 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 10-11-12  
08.0429 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 13-14  
08.0430 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 15-16  
08.0431 MANIJA EN FORMA DE T DE RAPIDA LIBERACIÓN - LARGA  
08.9051 SET INSTRUMENTAL BIPOLAR  
08.0404 CAJA INSTRUMENTOS BIPOLAR  
08.5133 LAPIZ DE EXTRACCIÓN  
08.0534 HERRAMIENTA EXTRACCION DE MANGA  
08.0598 MANGO DE CUBIERTA DE PRUEBA  
08.0576 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 40 MM  
08.0577 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 42 MM  
08.0578 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 44 MM  
08.0579 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 46 MM  
08.0580 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 48 MM  
08.0581 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 50 MM



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

..//

08.0582	CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 52 MM
08.0583	CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 54 MM
08.0584	CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 56 MM
08.0585	CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 58 MM
08.0586	CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 60 MM
08.0523	MANGA DE PRUEBA -3 MM
08.0524	MANGO DE PRUEBA 0 MM
08.0525	MANGO DE PRUEBA +4 MM
08.0526	MANGO DE PRUEBA +8 MM
08.0527	MANGO DE PRUEBA +12 MM
08.9002	SET INSTRUMENTOS ACETABULARES TROY
08.5126	CAJA DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
08.0301	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 42 MM
08.0302	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 44 MM
08.0303	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 46 MM
08.0304	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 48 MM
08.0305	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 50 MM
08.0306	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 52 MM
08.0307	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 54 MM
08.0308	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 56 MM
08.0309	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 58 MM
08.0310	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 60 MM
08.0311	CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 62 MM
08.0454	FRESA ACETABULAR 38 MM
08.0455	FRESA ACETABULAR 40 MM
08.0433	FRESA ACETABULAR 42 MM
08.0434	FRESA ACETABULAR 44 MM
08.0435	FRESA ACETABULAR 46 MM
08.0436	FRESA ACETABULAR 48 MM
08.0437	FRESA ACETABULAR 50 MM
08.0438	FRESA ACETABULAR 52 MM

5



..//

08.0439 FRESA ACETABULAR 54 MM  
08.0440 FRESA ACETABULAR 56 MM  
08.0441 FRESA ACETABULAR 58 MM  
08.0442 FRESA ACETABULAR 60 MM  
08.0443 FRESA ACETABULAR 62 MM  
08.5108 EJE FRESA ACETABULAR  
08.0598 MANIJA COTILO DE PRUEBA  
08.5127 BANDEJA 1 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY  
08.5154 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 42-44 MM  
08.5155 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 46-50 MM  
08.5156 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 52-56 MM  
08.5157 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 58-62 MM  
08.0444 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 42-44 MM  
08.0445 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 46-50 MM  
08.0446 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 52-56 MM  
08.0447 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 58-62 MM  
08.0448 MANGO DE IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO  
ACETABULAR  
08.0449 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0  
GRADOS 22 MM  
08.0450 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10  
GRADOS 22 MM  
08.0451 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0  
GRADOS 28 MM  
08.0452 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10  
GRADOS 28 MM  
08.0195 IMPACTOR DE COTILO ACETABULAR  
08.0196 CALIBRADOR DE POSICIONAMIENTO DE COTILO ACETABULAR  
08.5128 BANDEJA 2 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY  
08.5116 PINZA CURVADA PARA TORNILLO  
08.5118 DESTORNILLADOR RIGIDO





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. J.*

..//

- 08.5117 DESTORNILLADOR UNIVERSAL
- 08.5119 EJE DE BROCA FLEXIBLE
- 08.5120 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM CORTA
- 08.5121 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM LARGA
- 08.5106 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA
- 08.5107 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA
- 08.5115 CALIBRADOR PROFUNDIDAD TORNILLO ACETABULAR
- 08.5109 GUIA BROCA TORNILLO ACETABULAR DIAMETRO 3.2 -  
DIAMETRO 4.0
- 08.0453 ATORNILLADOR PARA BLOQUEO DE FLEXIBLE
- 08.9022 SET DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.5250 CAJA DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.5268 MANGO TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA
- 08.5260 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 10 MM (TAMAÑO 8)
- 08.5261 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 11 MM (TAMAÑO 9)
- 08.5262 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 12 MM (TAMAÑO 10)
- 08.5263 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 13 MM (TAMAÑO 11)
- 08.5264 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 14 MM (TAMAÑO 12)
- 08.5265 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 15 MM (TAMAÑO 13)
- 08.5266 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 16 MM (TAMAÑO 14)
- 08.5267 INSERTADOR DE TAPON ENDOMEDULAR
- 08.9004 SET INSTRUMENTAL CRP
- 08.0320 CAJA CRP
- 08.0346 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 10
- 08.0347 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 12
- 08.0348 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 14
- 08.0349 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 16
- 08.0502 MANIJA ESCARIADOR
- 08.0501 PALANCA DE MANO PARA ESCOFINA (barra Tommy)
- 08.0353 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 SIMPLE
- 08.0354 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 DOBLE

..//

08.0355 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 SIMPLE  
08.0356 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 DOBLE  
08.0357 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 SIMPLE  
08.0358 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 DOBLE  
08.0359 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 SIMPLE  
08.0360 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 DOBLE  
08.0551 BANDEJA 1 INSTRUMENTOS CADERA FEMUR  
08.0573 IMPACTOR DE CABEZA  
08.0565 IMPACTOR DE TALLO  
08.5122 EXTRACTOR DE TALLO  
08.0504 EXTRACTOR DE CABEZA FEMORAL  
08.5123 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM  
08.5124 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM  
08.5125 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM  
08.0568 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM -3 MM  
08.0569 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +0 MM  
08.0570 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +4 MM  
08.0571 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +8 MM  
08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAMETRO 28 MM +12 MM  
08.9005 JUEGO FRESA RIGIDA  
08.0351 CAJA FRESA RIGIDA  
08.0322 FRESA RIGIDA TAMAÑO 8  
08.0323 FRESA RIGIDA TAMAÑO 9  
08.0324 FRESA RIGIDA TAMAÑO 10  
08.0325 FRESA RIGIDA TAMAÑO 11  
08.0326 FRESA RIGIDA TAMAÑO 12  
08.0327 FRESA RIGIDA TAMAÑO 13  
08.0328 FRESA RIGIDA TAMAÑO 14  
08.0329 FRESA RIGIDA TAMAÑO 15  
08.0330 FRESA RIGIDA TAMAÑO 16  
08.0331 FRESA RIGIDA TAMAÑO 17



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

..//

- 08.0332 FRESA RIGIDA TAMAÑO 18
- 08.0431 MANIJA EN T DE LIBERACIÓN RAPIDA LARGA
- 08.9052 JUEGO DE INSTRUMENTOS PARDUS
- 08.0840 CAJA DE INSTRUMENTOS PARDUS
- 08.0869 MANIJA ESCARIADOR PARDUS
- 08.0870 MANIJA ESCARIADOR PARDUS FINO
- 08.0891 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 0
- 08.0892 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 1
- 08.0893 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2
- 08.0894 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2.5
- 08.0895 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3
- 08.0896 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3.5
- 08.0897 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 4
- 08.0898 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 5
- 08.0899 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 6
- 08.0859 POSICIONADOR DE TALLO PARDUS
- 08.0843 BANDEJA DE INSTRUMENTOS GENERALES
- 08.0871 IMPACTOR CABEZA DE FEMORAL PARDUS
- 08.0881 IMPACTOR DE TALLO
- 08.0872 LIJADOR M DE CALCAR PARDUS
- 08.0874 LIJADOR S DE CALCAR PARDUS
- 08.0875 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
- 5 08.0876 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
- 08.0877 CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6
- 08.0878 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
- 08.0879 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
- 08.0880 CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 -  
6
- 08.5123 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM
- 08.5124 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM
- 08.5125 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM

..//

08.0568 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM  
08.0569 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM  
08.0570 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM  
08.0571 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM  
08.0572 CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM  
08.0841 CAJA DE FRESA PARDUS  
08.0850 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 0  
08.0851 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 1  
08.0852 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 2  
08.0853 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 2.5  
08.0854 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 3  
08.0855 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 3.5  
08.0856 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 4  
08.0857 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 5  
08.0858 FRESA CONICA PARDUS TAMAÑO 6  
08.0861 MANIJA T  
08.0862 GUIA OSTEOTOMIA PARDUS  
08.0863 CAJA CINCEL  
08.0842 CAJA INSTRUMENTOS DE EXTRACCION  
08.0864 MARTILLO DESLIZANTE PARDUS  
08.0865 ANEXO EXTRACTOR ESCARIADOR  
08.0867 EXTRACTOR DE TALLO UNIVERSAL  
08.0868 GANCHO PARA EXTRACCION DE ESCARIADOR  
08.9007 SET DE INSTRUMENTOS PARA TALLO RECTO  
08.0400 CAJA DE INSTRUMENTOS PARA TALLO RECTO  
08.0504 EXTRACTOR CABEZA FEMORAL  
08.0565 IMPACTOR DE TALLO  
08.0566 MANGO EN T  
08.0567 LOCALIZADOR DE CANAL FEMORAL  
08.0573 IMPACTOR DE CABEZA  
08.5122 EXTRACTOR DE TALLO





*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. A. T.*

..//

- 08.5123 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +0 MM
- 08.5124 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +4 MM
- 08.5125 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 +8 MM
- 08.0568 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM
- 08.0569 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM
- 08.0570 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM
- 08.0571 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM
- 08.0572 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM
- 08.0401 BANDEJA DE INSTRUMENTOS DE TALLO RECTO 1
- 08.5148 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 7.5 MM
- 08.5149 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 10.0 MM
- 08.5150 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 11.25 MM
- 08.5151 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 12.5 MM
- 08.5152 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 13.75 MM
- 08.5153 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 15.0 MM
- 08.0502 MANGO DE ESCARIADOR
- 08.0501 RASPADOR BARRA TOMY

Período de vida útil: 3 años para Implantes estériles. Para el instrumental depende del adecuado tratamiento por parte del usuario. El tiempo de vida útil del dispositivo esta determinado por el desgaste y propiedades materiales.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Covision Medical Technologies Ltd.

Lugar/es de elaboración: Lawn Road, Carlton In Lindrick, Worksop, S81 9LB, Reino Unido.

Se extiende a CHEMA IMPLANTES S.R.L. el Certificado PM-2000-1, en la Ciudad de Buenos Aires, a .....23.NOV.2011....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **7 9 3 1**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.